

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM
FORTIM/CE

PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2701.01/2023 - SMS/SRP/PE

ABERTURA: 13/02/2023

HORÁRIO: 08:30

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Pregão Eletrônico, que integram o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

Declaramos:

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens **Declaramos**, ainda, que estamos enquadrados no Regime de Tributação de Empresa de Pequeno Porte conforme estabelece Artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 25

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa nº	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
01	30	UND	MANOMETRO C/ VALVULA P/ CILINDRO DE OXIGÊNIO C/200 LIBRAS	JG MORIYA/ JG MORIYA REP. IMP. EXP. COM. LTDA/ 200.410/ 10349590139	400,00	12.000,00
02	20	UND	KIT LARINGOSCOPIO COMPLETO COM 6 LÂMINAS CURVA, CABO PARA LARINGOSCOPIO MÉDIO, TAMPAS DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS DE PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO, SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPAS DE CARREGAMENTO ABERTA, ACABAMENTO ESTRIADO, TAMANHO MÉDIO, COM LÂMINA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL CURVA, TAMANHOS DE 0 ATÉ 5, LÂMINA DE LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL, AS ARESTAS ARREDONDADAS DA LÂMINA - AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134°C. ACOMPANHA LÂMPADA.	HAYMED/ HAY MED INST. - PAQUISTÃO/ CONVENCIONAL/ 10349590155	2.000,00	40.000,00

[Handwritten signatures and marks]

03	15	UND	MACA DOBRAVEL PORTÁTIL SEM ORIFÍCIO	BÁSICO/ BÁSICO DESIGNER/ BÁSICO/ ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA	1.000,00	15.000,00
04	35	UND	MACA SEM RODAS PARA AMBULATÓRIO	METALIC/ Metalic Medical Prod. Hosp. Ltda. - EPP/ MT300/ 80883970003	900,00	31.500,00
05	18	UND	OTOSCÓPIO EQUIPAMENTO PARA EXAME VISUAL DO OUVIDO. OTOSCÓPIO EM FIBRA ÓPTICA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. LÂMPADA ALÓGENA, LENTE DE AUMENTO DE 2.5X E 05 ESPÉCULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO COM DIÂMETROS APROXIMADOS: 2,5MM- 3,0MM-3,5MM-4,0MM-8,0MM. POSSUIR REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE. POSSUIR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL. POSSUIR VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL. ACOMPANHAR LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE.	DNS/ DAD&SONS SURGICAL IND. - PAQUISTÃO/ DNS-1003/ 81965540001	800,00	14.400,00
			APRESENTAR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL DE TAMANHO MÉDIO PARA PILHAS. POSSUIR LUPA REDONDA. POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ DESEJÁVEL. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS MÉDIAS COMUNS. ACOMPANHA ESTOJO REFORÇADO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, CONTENDO: LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE E 5 (CINCO) ESPÉCULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO. GARANTIA DE 1 ANO. APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA, MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. (COM REGISTRO NA ANVISA)			

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

[Handwritten Signature]
Rubrica

06	60	UND	VÁLVULA REDUTORA COM FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO CABO LONGO, ESCALA DE MANÔMETRO - VÁLVULA DE PRESSÃO FIXA: 0 A 315 KGF/CM2. VÁLVULA DE PRESSÃO VARIÁVEL: ENTRADA - 0 A 315 KGF/CM2 E SAÍDA A 8KGF/CM2. PRESSÃO DE TRABALHO - CILINDRO: PRESSÃO DO CILINDRO CHEIO: 150 OU 200 KGF/CM2. VÁLVULA DE PRESSÃO FIXA DE: DENTRO DA FAIXA DE 3,5 +/- 0,3 KGF/CM2. VÁLVULA DE ALIVIO (SEGURANÇA): 6,5 +/- 0,3 KGF/CM2. VÁLVULA DE PRESSÃO VARIÁVEL: FAIXA DE TRABALHO 0 - 8 KGF/CM2. VÁLVULA DE ALIVIO (SEGURANÇA): 9,5 +/- 0,4 KGF/CM2	JG MORIYA/ JG MORIYA REP. IMP.EXP. COM. LTDA/ 200.413/ 10349590139	400,00	24.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE POR EXTENSO: cento e trinta e seis mil e novecentos reais					TOTAL	136.900,00

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Faturamento Mínimo R\$1.000,00 (mil reais)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO:
cento e trinta e seis mil e novecentos reais

TOTAL

136.900,00

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital

DECLARA, que:

- cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possuo 08 (oito) funcionários em minha empresa.

Pinhais, 13 de fevereiro de 2023.

[Handwritten signatures and initials]



Buscar no portal

 (https://correio.anvisa.gov.br/owa)

Perguntas (perguntas-frequentes) | Legislação (legislacao) | Contato (contato) | Serviços (servicos) | Imprensa (area-de-impressao)

MENU

Regularização de Produtos - Produtos para a Saúde

Produtos Não Regulados pela GGTPS/Anvisa

Atualizado em 01/10/2020

CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório
16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
17. Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
 - 23.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
24. Centrífuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)
 - 24.1 Centrífuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue



25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para uso em saúde
30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).
32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
36. Digestor
37. Diluidor de amostras
38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
41. Equipamento para gerenciamento de amostras
42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
45. Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
46. Evaporador centrífugo a vácuo
47. Fermentador de culturas
48. Filtro para soluções
49. Forno mufla
50. Fotômetro de chama
51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
55. Indicador físico, químico ou biológico
56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.
 - 56.1 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)
57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
58. Lenço para assepsia da pele
59. Liofilizador
60. Luxímetro
61. Medidor de O₂ dissolvido em amostras
62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
63. Medidor do ponto de fusão
64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
66. Mobiliário para laboratório
67. Moinho de amostras sólidas
68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
69. Montadores automáticos de lâminas e laminulas
70. Navalhas para micrôtomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (fixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Almofadas para cadeiras de rodas, exceto para prevenção de úlceras
2. Almotolia
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - 3.1. Condicionadores de ar

3. 2. Purificador de ar
3. 3. Esterilizador de ar
3. 4. Umidificador de ar
4. Babador de uso odontológico
5. Balde
6. Bandejas / Caixas / Estojos, inclusive para esterilização (Etiquetas para identificação de caixas/racks)
7. Barreira para separação de ambientes
 7. 1. Biombo
8. Bomba a vácuo
9. Caldeira
10. Caneta para marcação cirúrgica
11. Capa para colchão, poltronas e travesseiros
12. Capa para Equipamentos
13. Central de ar comprimido
14. Central de gases medicinais
15. Central de vácuo
16. Comadre/ cuba rim/ papagaio/ escarradeira
17. Compressor de ar
18. Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
19. Cortador de isopor para confecção de moldes
20. Dispositivo destruidor e inutilizador de produto médico / contador (agulhas, bisturis entre outros)
21. Dispositivo para abertura de frasco ampola
22. Dispositivo para abertura de produtos médicos
23. Embalagem para esterilização de produtos médicos
24. Embalagens para transporte e armazenamento de órgãos
25. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
 25. 1. Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
26. Equipamentos para Lavanderia
27. Escada para paciente, exceto indicada para terapia
28. Escova para limpeza de produtos em geral
29. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
30. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
31. Fogão para preparação de alimentos
32. Gel para absorção de resíduos orgânicos
33. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
34. Gerador de vapor
35. Gesso para confecção de modelo odontológico
36. Hamper (recipiente para acondicionamento de roupa hospitalar) e saco para hamper
37. Incinerador de resíduos hospitalares
38. Indicador físico, químico ou biológico
39. Lacres, tapetes, suportes, escovas para limpeza de instrumentais
40. Lona /dispositivo/campo para transferência de paciente
41. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
 41. 1. Mocho Odontológico ou cirúrgico.
 41. 2. Cadeiras de espera
 41. 3. Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
 41. 4. Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
 41. 5. Mesa de cabeceira Mesa para
 41. 6. Necrópsia
42. Negatoscópio
43. Papel higiênico / papel toalha
44. Pia hospitalar
45. Produto para coleta ou inutilização de materiais perfurocortantes
46. Protetor auricular de ruídos
47. Pulseiras de identificação de pacientes (incluindo pulseiras mãe-filho) e de classificação de risco, placas e outros produtos para tal finalidade
48. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
49. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
50. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
51. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
52. Régua endodôntica para medição de limas
53. Restritores utilizados na contenção do paciente
54. Roupa de cama, incluindo de uso hospitalar descartável
55. Saco para coleta de resíduos hospitalares
56. Sacos para óbito/ sacos para cadáver
57. Saltos ortopédicos
58. Secador de ar medicinal
59. Seladora de embalagens de produtos médicos
60. Sistema de comunicação hospitalar
61. Sistema de sinalização hospitalar
62. Dispensário Eletrônico utilizados para acondicionamento de medicamentos e materiais hospitalares



**CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO**

1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação
2. Bomba para dedetização
3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
4. Cronômetro
 - 4.1 Relógio para treinamento
5. Dardo
6. Dilatador nasal adesivo
7. Disco
8. Equipamentos passivos para condicionamento físico
 - 8.1 Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
 - 8.2 Halteres
 - 8.3 Estações de Musculação
 - 8.4 Remadores
 - 8.5 Aparelho para abdominais
 - 8.6 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
9. Mesa ou cadeira para massagem
10. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzamento)
11. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
12. Protetor não ortopédico de partes do corpo
13. Tablado (exceto para fisioterapia)
14. Vara para salto

CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

1. Absorvente higiênico
2. Alicata e tesoura para cortar unhas
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 3. 1. Condicionadores de ar
 3. 2. Purificador de ar
 3. 3. Esterilizador de ar
 3. 4. Umidificador de ar
4. Balanças
5. Barbeador
6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
7. Brincos para perfuração
8. Chupeta
9. Coletor menstrual
10. Escova odontológica
11. Escova para cabelos
12. Esponja para limpeza de pele
13. Fio dental
14. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
15. Lente para ampliar escalas
16. Limpador de língua
17. Luvas sem indicação de uso em saúde
18. Mamadeira e bico
19. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
20. Massageador de gengiva
21. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
22. Mordedor para lactentes

23. Óculos para presbiopia
24. Papel higiênico/papel toalha
25. Passador de fio dental
26. Piercing
27. Pipetas e frascos de vidro para coleta, armazenamento e pasteurização de leite humano
28. Produto destinado à limpeza de lentes de óculos
29. Produto para estimulação sexual
30. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
31. Prótese mamária externa e sutiã para suporte da prótese
32. Protetor de mamilo
33. Purificador de água
34. Sauna
35. Secador e escova de cabelos
36. Top maternal, Sling

CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens, exceto os indicados para registro de sinais ou imagens médicas
6. Impressora, exceto as indicadas para registro de sinais ou imagens médicas
7. Monitor de vídeo, exceto as indicadas para exibição de imagens médicas
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, incluindo indicado para registro de sinais ou imagens médicas

CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE

CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteyras, provetas, tubos de ensaio, lâminulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcalinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnóstico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia
17. Fixadores celulares

Voltar para o topo!

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 885V
Rúbrica



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Amo
 Rubrica

71.2646.U15 Regulador de pressão com Fluxômetro 0 a 15 L/min Uruguay
71.2646.U3 Regulador de pressão com Fluxômetro 0 a 3 L/min Uruguay
71.2646.U5 Regulador de pressão com Fluxômetro 0 a 5 L/min Uruguay
71.5217 Regulador de Pressão com 2 saídas para Oxigênio Air Liquide
71.7146 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 A 30 L/Min para Gás Carbônico Air Liquide
71.7147 Regulador de Pressão Ajustável para Ar Comprimido Air Liquide
71.7149 Regulador de Pressão Ajustável para Hélio Air Liquide
71.7150 Regulador de Pressão Ajustável para Hidrogênio Air Liquide
71.7151 Regulador de Pressão Ajustável para Mistura
71.7153 Regulador de Pressão Ajustável para Nitrogênio Air Liquide
71.7154 Regulador de Pressão Fixa para Ar Comprimido Air Liquide
71.7155 Regulador de Pressão Fixa para Oxigênio Air Liquide
71.7160 Regulador de Pressão Ajustável para Oxigênio Air Liquide
8970028020 Regulador de Pressão Fixa EC para Oxigênio Atlas Copco
8970028021 Regulador de Pressão Fixa para Oxigênio Atlas Copco
8970028022 Regulador de Pressão EC com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Oxigênio Atlas Copco
8970028023 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Oxigênio Atlas Copco
8970028076 Regulador de Pressão Ajustável para Ar Comprimido Atlas Copco
8970028078 Regulador de Pressão Ajustável para Oxigênio Atlas Copco
900.100 Regulador de Pressão Duplo Estágio para Oxigênio Moriya
900.100-N Regulador de Pressão Duplo Estágio para Ar Comprimido Moriya
900.102 Regulador de Pressão Duplo Estágio para Oxigênio Moriya
900.103 Regulador de Pressão Duplo Estágio para Nitrogênio Moriya
900.104 Regulador de Pressão Duplo Estágio para Argônio Moriya
900.105 Regulador de Pressão Duplo Estágio para Hélio Moriya
900.106 Regulador de Pressão Duplo Estágio para Hidrogênio Moriya
900.107 Regulador de Pressão Duplo Estágio para Ar Comprimido Moriya
900.110 Regulador de Pressão Duplo Estágio para Acetileno Moriya
922.652 Regulador de Pressão Fixa para Ar Comprimido Praxair
922.653 Regulador de Pressão Fixa para Oxigênio Praxair
924.571 Regulador de Pressão EC com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Oxigênio Air Liquide
924.610 Regulador de Pressão EC com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Ar Comprimido ABNT 204-1 Air Liquide
925.537 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Ar Comprimido Lumiar
925.538 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Oxigênio Lumiar
925.539 Regulador de Pressão EC com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Ar Comprimido Lumiar
925.540 Regulador de Pressão EC com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Oxigênio Lumiar
925.547 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 15 l/min BL para Ar Comprimido Lumiar
925.548 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 15 l/min BA para Oxigênio Lumiar

Amo

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	JG MORIYA REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA COMERCIAL LTDA
CNPJ	67.882.621/0001-17
Autorização	1.03.495-9
Produto	REGULADOR DE PRESSÃO DE GASES MEDICINAIS

Modelo Produto Médico

700.729 Regulador de Pressão Fixa para Ar Comprimido Linde
700.730 Regulador de Pressão Fixa para Óxido Nitroso Linde
700.750 FIXED PRESSURE REGULATOR FOR OXYGEN
700.800 Regulador de Pressão Ajustável para Oxigênio Moriya
700.801 Regulador de Pressão Ajustável para Ar Comprimido Moriya
700.803 Regulador de Pressão Ajustável para Hélio Moriya
700.805 Regulador de Pressão Ajustável para Nitrogênio Moriya
700.806 Regulador de Pressão Ajustável para Hidrogênio Moriya
700.807 Regulador de Pressão Ajustável para Acetileno Moriya
700.808 Regulador de Pressão Ajustável para Ar Comprimido ABNT 204-1 Moriya
700.810 Regulador de Pressão com Fluxômetro Aneróide para O2 Moriya
700.813 Regulador de Pressão Ajustável para Hidrogênio Linde
700.814 Regulador de Pressão Ajustável para Hélio/ Nitrogênio/ Argônio Linde
700.815 Regulador de Pressão Ajustável para Oxigênio Linde
700.816 Regulador de Pressão Ajustável para Ar Comprimido Linde
700.819 Regulador de Pressão Ajustável para Acetileno Linde
71.1675 Regulador de Pressão Ajustável para Ar Comprimido ABNT 204-1 Air Liquide
71.1676 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 A 15 L/Min para Ar Medicinal Air Liquide
71.1679 Regulador de Pressão Fixa para Ar Comprimido ABNT 204- 1 Air Liquide
71.2645 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 A 15 L/Min para Ar Comprimido Air Liquide
71.2646 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 15 l/min BC para Oxigênio Air Liquide
71.2646 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 A 15 L/Min para Oxigênio Air Liquide
71.2646.C15 Regulador de pressão com Fluxômetro 0 a 15 L/min Chile DIN477
71.2646.C3 Regulador de pressão com Fluxômetro 0 a 3 L/min Chile DIN477
71.2646.C5 Regulador de pressão com Fluxômetro 0 a 5 L/min Chile DIN477
71.2646D Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 15 l/min Conexão Direta para Oxigênio Air Liquide
71.2646P Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 15 l/min BL para Oxigênio Air Liquide

[Assinatura]
Rubrica

120.360 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Oxigênio Messer
120.361 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Ar Comprimido Messer
200.413 Regulador de Pressão EC com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Oxigênio Moriya
700.728 Regulador de Pressão Fixa para Oxigênio Linde
200.414 Regulador de Pressão EC com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Ar Comprimido Moriya
200.415 Regulador De Pressão Fixa EC Para Oxigênio Air Liquide
200.416 Regulador De Pressão Fixa EC Com Fluxometro 0 A 15 L/Min Para Oxigênio Air Liquide
200.417 Regulador De Pressão Fixa EC Para Oxigênio White Martins
200.418 Regulador De Pressão Fixa EC Com Fluxometro 0 A 15 L/Min Para Oxigênio White Martins
200.419 Regulador De Pressão Fixa EC Para Oxigênio Lumiar
200.420 Regulador De Pressão Fixa EC Com Fluxometro 0 A 15 L/Min Para Oxigênio Lumiar
40105780 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Oxigênio White Martins
40115738 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Ar Comprimido ABNT 204-1 White Martins
40121113 Regulador de Pressão Fixa para Oxigênio White Martins
40121352 Regulador de Pressão Fixa para Ar Comprimido White Martins
40121353 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 15 l/min para ar ABNT 218-1 White Martins
40121356 Regulador de Pressão com 2 saídas para Oxigênio White Martins
40121357 Regulador de Pressão com 2 saídas para Ar Comprimido White Martins
40121359 Regulador de Pressão com 2 saídas para Ar Comprimido ABNT 204-1 White Martins
40121443 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 3 l/min para Oxigênio White Martins
40125138 Regulador RNX – AR
40125143 Regulador RNX – OX
40125410 Regulador RNF – AR
40125414 Regulador RNF – OX
700.700 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Oxigênio Moriya
700.701 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Ar Comprimido Moriya
700.703 Regulador De Pressão Com Fluxômetro 0 a 15 L/Min P/ Oxigênio Linde
700.704 Regulador De Pressão Com Fluxômetro 0 a 15 L/Min P/ Ar Comprimido Linde
700.709 Regulador de Pressão Fixa para Ar Comprimido Haste Curta ABNT 204-1 Moriya
700.710 Regulador de Pressão Fixa para Oxigênio Moriya
700.711 Regulador de Pressão Fixa para Ar Comprimido Moriya
700.712 Regulador de Pressão Fixa para Oxigênio Haste Curta Moriya
700.713 Regulador de Pressão Fixa para Ar Comprimido Haste Curta Moriya
700.716 Regulador de Pressão EC com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Ar Comprimido ABNT 204-1 Moriya
700.723 Regulador de Pressão Fixa para Ar Comprimido ABNT 204- 1 Moriya
700.724 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Ar Comprimido ABNT 204-1 Moriya
120.363 Regulador de Pressão Ajustável para Oxigênio Messer
120.364 Regulador de Pressão Ajustável para Ar Comprimido Messer

[Assinatura]

Assinatura
 Rubrica

925.592	Regulador de Pressão com Fluxômetro Aneróide para Ar Comprimido Moriya
925.593	Regulador de Pressão com Fluxômetro Aneróide para Ar Comprimido Moriya
925.594	Regulador de Pressão com Fluxômetro Aneróide para O2 Praxair
925.595	Regulador de Pressão com Fluxômetro Aneróide para Ar Comprimido Praxair
925.596	Regulador de Pressão com Fluxômetro Aneróide para O2 CGA 540 Moriya
925.597	Regulador de Pressão com Fluxômetro Aneróide para O2 DIN477 Moriya
928.138	Regulador de Pressão com Fluxômetro para Oxigênio - Furo calibrado e Fluxo contínuo
928.139	Regulador de Pressão com Fluxômetro para Oxigênio - Furo calibrado e Fluxo contínuo e intermitente
930.058	Regulador de pressão EC com Fluxômetro 0 a 15 l/min para oxigênio WM sem logo
930.059	Regulador de pressão EC com Fluxômetro 0 a 15 l/min Ar Comprimido WM sem logo
930.060	Regulador de Pressão Fixa EC de Oxigênio Moriya conector curto
931.258	Regulador de Pressão Fixa EC de Oxigênio (conexão invertida) Moriya
931.740	Regulador de Pressão Fixa EC para Ar Comprimido
931.741	Regulador de Pressão Fixa EC para Oxigênio
933.396	Regulador De Pressão Fixa EC De Oxigênio Com Sensor De Pressão
933.397	Regulador De Pressão Fixa HT De Oxigênio Com Sensor De Pressão
CNX0862	Regulador de pressão fixa conta litros 0 a 15 l/min DISS Ar Comprimido
CNX0863	Regulador de pressão fixa conta litros 0 a 15 l/min DISS Oxigênio
CNX0953P	Regulador Fijo Cilíndrico c/ctalt esc med gir O2
M176000	Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 15 l/min DIN 477
M60235	Regulador de Pressão Ajustável para Oxigênio DIN 477 Air Liquide
M61315	Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 3 l/min DIN 477
M62411	Regulador sin Flujometro DIN 477
M62625	Regulador de Pressão Fixa para Oxigênio DIN 477 Air Liquide
RO5000	Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Oxigênio Romed
RO5001	Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Ar Comprimido Romed
RO5002	Regulador de Pressão com 1 saída para Oxigênio Romed
RO5003	Regulador de Pressão com 1 saída para Ar Comprimido Romed
RO5004	Regulador de pressão com 2 saídas para Oxigênio Romed
RO5005	Regulador de Pressão com 2 saídas para Ar Comprimido Romed
VC5829	Regulador de Pressão Ajustável para Oxigênio Haoxi
VC5830	Regulador de Pressão Ajustável para Ar Comprimido Haoxi
VC5833	Regulador de Pressão Ajustável para Nitrogênio Haoxi
VC5850	Regulador de Pressão Duplo Estágio para Oxigênio Haoxi
VC5851	Regulador de Pressão Duplo Estágio para Ar Comprimido Haoxi
VC5854	Regulador de Pressão Duplo Estágio para Nitrogênio Haoxi
100.142	Regulador de Pressão com Fluxômetro Aneróide para O2 Moriya
120.226	Regulador de Pressão Ajustável para Hidrogênio Messer
120.227	Regulador de Pressão Ajustável para Nitrogênio/Argônio/Hélio Messer

Assinatura

Assinatura

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	JG MORIYA REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA COMERCIAL LTDA
CNPJ	67.882.621/0001-17
Autorização	1.03.495-9
Produto	Laringoscópio Convencional Haymed

Modelo Produto Médico	
FMC-001-3130-02 Lâmina convencional Led Foregger/Wisconsin tamanho 2	ray C
FMC-001-3130-03 Lâmina convencional Led Foregger/Wisconsin tamanho 3	ray C
FMC-001-3130-04 Lâmina convencional Led Foregger/Wisconsin tamanho 4	ray C
FMC-001-3130-05 Lâmina convencional Led Foregger/Wisconsin tamanho 5	ray C
FMC-003-3010-00 Lâmina convencional Warmray C Macintosh tamanho 0	
FMC-003-3010-01 Lâmina convencional Warmray C Macintosh tamanho 1	
FMC-003-3010-02 Lâmina convencional Warmray C Macintosh tamanho 2	
FMC-003-3010-04 Lâmina convencional Warmray C Macintosh tamanho 4	
FMC-003-3010-05 Lâmina convencional Warmray C Macintosh tamanho 5	
FMC-003-3020-00 Lâmina convencional Warmray C Miller tamanho 0	
FMC-003-3010-03 Lâmina convencional Warmray C Macintosh tamanho 3	
FMC-003-3020-000 Lâmina convencional Warmray C Miller tamanho 00	
FMC-003-3020-01 Lâmina convencional Warmray C Miller tamanho 1	
FMC-003-3020-02 Lâmina convencional Warmray C Miller tamanho 2	
FMC-003-3020-03 Lâmina convencional Warmray C Miller tamanho 3	
FMC-003-3020-04 Lâmina convencional Warmray C Miller tamanho 4	
FMC-003-3030-00 Lâmina convencional Warmray C Foregger/Wisconsin tamanho 0	
FMC-003-3030-01 Lâmina convencional Warmray C Foregger/Wisconsin tamanho 1	
FMC-003-3030-02 Lâmina convencional Warmray C Foregger/Wisconsin tamanho 2	
FMC-003-3030-03 Lâmina convencional Warmray C Foregger/Wisconsin tamanho 3	
FMC-003-3030-04 Lâmina convencional Warmray C Foregger/Wisconsin tamanho 4	
FMC-003-3030-05 Lâmina convencional Warmray C Foregger/Wisconsin tamanho 5	
FMC-003-3040-02 Lâmina convencional Warmflex C Flexible Macintosh tamanho 2	
FMC-003-3040-03 Lâmina convencional Warmflex C Flexible Macintosh tamanho 3	
FMC-003-3040-04 Lâmina convencional Warmflex C Flexible Macintosh tamanho 4	
FMC-003-3050-02 Lâmina convencional Warmray C IV Macintosh tamanho 2	

120.369 Regulador de Pressão Fixa para Oxigênio Messer
120.370 Regulador de Pressão Fixa para Ar Comprimido Messer
120.371 Regulador de Pressão Fixa para Óxido Nitroso Messer
200.410 Regulador de Pressão Fixa EC para Oxigênio Moriya
200.412 Regulador de Pressão Fixa EC para Ar Comprimido Moriya

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	01.273 IFU - REGULADORES DE PRESSÃO DE GASES MEDICINAIS DE AÇO INOX rev05.pdf	4620615218 - 22/11/2021 12:12:37
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	06.358 - IFU - REGULADOR DE PRESSAO COM FLUXOMETRO PARA OXIGENIO MORIYA - FURO CALIBRADO E FLUXO CONTINUO rev00.pdf	4620615218 - 22/11/2021 12:12:37

Nome Técnico	Reguladores de Pressao de Gases Medicinais
Registro	10349590139
Processo	25351606886201430
Fabricante Legal	JG MORIYA REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA COMERCIAL LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]


[Handwritten mark]

FMC-003-3120-01 Lâmina convencional Led tamanho 1	ray C Miller
FMC-003-3120-02 Lâmina convencional Led tamanho 2	ray C Miller
FMC-003-3120-03 Lâmina convencional Led tamanho 3	ray C Miller
FMC-003-3120-04 Lâmina convencional Led tamanho 4	ray C Miller
FMC-003-3140-02 Lâmina convencional Led Macintosh tamanho 2	ray C Flexible
FMC-003-3140-03 Lâmina convencional Led Macintosh tamanho 3	ray C Flexible
FMC-003-3140-04 Lâmina convencional Led Macintosh tamanho 4	ray C Flexible
FMC-003-3150-02 Lâmina convencional Led Macintosh tamanho 2	ray C IV
FMC-003-3150-03 Lâmina convencional Led Macintosh tamanho 3	ray C IV
FMC-003-3150-04 Lâmina convencional Led Macintosh tamanho 4	ray C IV
FMC-003-3160-01 Lâmina convencional Led tamanho 1	ray C Polio
FMC-003-3160-02 Lâmina convencional Led tamanho 2	ray C Polio
FMC-003-3160-03 Lâmina convencional Led tamanho 3	ray C Polio
FMC-003-3160-04 Lâmina convencional Led tamanho 4	ray C Polio
FMC-003-3170-00 Lâmina convencional Led Macintosh tamanho 0	ray C American
FMC-003-3170-01 Lâmina convencional Led Macintosh tamanho 1	ray C American
FMC-003-3170-02 Lâmina convencional Led Macintosh tamanho 2	ray C American
FMC-003-3170-03 Lâmina convencional Led Macintosh tamanho 3	ray C American
FMC-003-3170-035 Lâmina convencional Led American Macintosh tamanho 3.5	ray C
FMC-003-3170-04 Lâmina convencional Led Macintosh tamanho 4	ray C American
FMC-003-3180-00 Lâmina convencional Led Miller tamanho 0	ray C American
FMC-003-3180-000 Lâmina convencional Led American Miller tamanho 00	ray C
FMC-003-3180-01 Lâmina convencional Led Miller tamanho 1	ray C American
FMC-003-3180-02 Lâmina convencional Led Miller tamanho 2	ray C American
FMC-003-3180-03 Lâmina convencional Led Miller tamanho 3	ray C American
FMC-003-3180-04 Lâmina convencional Led Miller tamanho 4	ray C American
FMC-003-3190-00 Lâmina convencional Led Robertshaw Balde tamanho 0	ray C
FMC-003-3190-01 Lâmina convencional Led Robertshaw Balde tamanho 1	ray C
FMC-003-3192-01 Lâmina convencional Led tamanho 1	ray C Seward
FMC-003-3192-02 Lâmina convencional Led tamanho 2	ray C Seward
FMC-003-3194-01 Lâmina convencional Led tamanho 1	ray C Oxford
FMC-003-3196-01 Lâmina convencional Led tamanho 1	ray C Soper

[Handwritten signature]

FMC-003-3050-03 Lâmina convencional Warmray C IV Macintosh tamanho 3
FMC-003-3050-04 Lâmina convencional Warmray C IV Macintosh tamanho 4
FMC-003-3060-01 Lâmina convencional Warmray C Polio tamanho 1
FMC-003-3060-02 Lâmina convencional Warmray C Polio tamanho 2
FMC-003-3060-03 Lâmina convencional Warmray C Polio tamanho 3
FMC-003-3060-04 Lâmina convencional Warmray C Polio tamanho 4
FMC-003-3070-00 Lâmina convencional Warmray C American Macintosh tamanho 0
FMC-003-3070-01 Lâmina convencional Warmray C American Macintosh tamanho 1
FMC-003-3070-02 Lâmina convencional Warmray C American Macintosh tamanho 2
FMC-003-3070-03 Lâmina convencional Warmray C American Macintosh tamanho 3
FMC-003-3070-035 Lâmina convencional Warmray C American Macintosh tamanho 3,5
FMC-003-3070-04 Lâmina convencional Warmray C American Macintosh tamanho 4
FMC-003-3080-00 Lâmina convencional Warmray C American Miller tamanho 0
FMC-003-3080-000 Lâmina convencional Warmray C American Miller tamanho 00
FMC-003-3080-01 Lâmina convencional Warmray C American Miller tamanho 1
FMC-003-3080-02 Lâmina convencional Warmray C American Miller tamanho 2
FMC-003-3080-03 Lâmina convencional Warmray C American Miller tamanho 3
FMC-003-3080-04 Lâmina convencional Warmray C American Miller tamanho 4
FMC-003-3090-00 Lâmina convencional Warmray C Robertshaw tamanho 0
FMC-003-3090-01 Lâmina convencional Warmray C Robertshaw tamanho 1
FMC-003-3092-01 Lâmina convencional Warmray C Seward tamanho 1
FMC-003-3092-02 Lâmina convencional Warmray C Seward tamanho 2
FMC-003-3094-01 Lâmina convencional Warmray C Oxford tamanho 1
FMC-003-3096-01 Lâmina convencional Warmray C Soper tamanho 1
FMC-003-3100-00 Lâmina convencional Warmray C Wishipple tamanho 0
FMC-003-3100-000 Lâmina convencional Warmray C Wishipple tamanho 00
FMC-003-3100-01 Lâmina convencional Warmray C Wishipple tamanho 1
FMC-003-3100-015 Lâmina convencional Warmray C Wishipple tamanho 1,5
FMC-003-3110-00 Lâmina convencional Led.....ray C Macintosh tamanho 0
FMC-003-3110-01 Lâmina convencional Led.....ray C Macintosh tamanho 1
FMC-003-3110-02 Lâmina convencional Led.....ray C Macintosh tamanho 2
FMC-003-3110-03 Lâmina convencional Led.....ray C Macintosh tamanho 3
FMC-003-3110-04 Lâmina convencional Led.....ray C Macintosh tamanho 4
FMC-003-3110-05 Lâmina convencional Led.....ray C Macintosh tamanho 5
FMC-003-3120-00 Lâmina convencional Led.....ray C Miller tamanho 0
FMC-003-3120-000 Lâmina convencional Led.....ray C Miller tamanho 00

[Handwritten signatures and marks]

Nome Técnico	Laringoscópio	 Rubrica
Registro	10349590155	
Processo	25351616759202010	
Fabricante Legal	HAY MED INSTRUMENTS	
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO	
Vencimento do Registro	VIGENTE	
Situação	[sem dados cadastrados]	
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]	








FMC-003-3200-00 Lâmina convencional Led.....ray C Wishipple tamanho 0
FMC-003-3200-000 Lâmina convencional Led.....ray C Wishipple tamanho 00
FMC-003-3200-01 Lâmina convencional Led.....ray C Wishipple tamanho 1
FMC-003-3200-015 Lâmina convencional Led.....ray C Wishipple tamanho 1.5
FMC-003-3600-E Cabo laringoscópio tamanho Econômico
FMC-003-3600-L Cabo laringoscópio tamanho Grande
FMC-003-3600-M Cabo laringoscópio tamanho Médio
FMC-003-3600-MI Cabo laringoscópio tamanho Micro
FMC-003-3600-S Cabo laringoscópio tamanho Pequeno
FMC-003-3600-ST Cabo laringoscópio tamanho Stubby
FMC-005-5530-02 Lâmina convencional Led'ray ǀ
FMC-005-5530-03 Lâmina convencional Led'ray ǀ
FMC-005-5530-04 Lâmina convencional Led'ray ǀ
FMD-005-5510-00 Lâmina convencional Led.....ray C Single Use Macintosh tamanho 0
FMD-005-5510-01 Lâmina convencional Led.....ray C Single Use Macintosh tamanho 1
FMD-005-5510-02 Lâmina convencional Led.....ray C Single Use Macintosh tamanho 2
FMD-005-5510-03 Lâmina convencional Led.....ray C Single Use Macintosh tamanho 3
FMD-005-5510-04 Lâmina convencional Led.....ray C Single Use Macintosh tamanho 4
FMD-005-5510-05 Lâmina convencional Led.....ray C Single Use Macintosh tamanho 5
FMD-005-5520-00 Lâmina convencional Led.....ray C Single Use Miller tamanho 0
FMD-005-5520-000 Lâmina convencional Led.....ray C Single Use Miller tamanho 00
FMD-005-5520-01 Lâmina convencional Led.....ray C Single Use Miller tamanho 1
FMD-005-5520-02 Lâmina convencional Led.....ray C Single Use Miller tamanho 2
FMD-005-5520-03 Lâmina convencional Led.....ray C Single Use Miller tamanho 3
FMD-005-5520-04 Lâmina convencional Led.....ray C Single Use Miller tamanho 4
FMC-003-3010-02I Lâmina convencional Warmray C Macintosh tamanho 2
FMC-001-3130-01 Lâmina convencional Led.....ray C Foregger/Wisconsin tamanho 1
Flexível Descartável tamanho 2
Flexível Descartável tamanho 3
Flexível Descartável tamanho 4
FMC-001-3130-00 Lâmina convencional Led.....ray C Foregger/Wisconsin tamanho 0

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	01.473 INSTRUÇÕES DE USO LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL REUTILIZÁVEL REV02.pdf	2297764219 - 14/06/2021 11:35:38

[Handwritten signatures and marks]

Nome Técnico	Mesa para exame	 Rubrica
Registro	80883970003	
Processo	25351288643201696	
Fabricante Legal	Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO	
Vencimento do Registro	VIGENTE	
Situação	[sem dados cadastrados]	
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]	



Consultas
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda. - EPP
CNPJ	05.788.117/0001-03
Autorização	8.08.839-7
Produto	MESA PARA EXAMES

Modelo Produto Médico
MT1761i
MT300
MT306
MT300E
MT301i
MT301
MT301PC
MT302i
MT302
MT308
MT2428
MT304i
MT302F
MT304
MT309
MT2461
MT310
MT312
MT313P
MT312E
MT315B
MT314B.
MT300i
MT1761

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
[sem dados cadastrados]		

Consultas


ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 892
Rúbrica

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	JG MORIYA REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA COMERCIAL LTDA
CNPJ	67.882.621/0001-17
Autorização	1.03.495-9
Produto	REGULADOR DE PRESSÃO DE GASES MEDICINAIS

Modelo Produto Médico
700.729 Regulador de Pressão Fixa para Ar Comprimido Linde
700.730 Regulador de Pressão Fixa para Óxido Nitroso Linde
700.750 FIXED PRESSURE REGULATOR FOR OXYGEN
700.800 Regulador de Pressão Ajustável para Oxigênio Moriya
700.801 Regulador de Pressão Ajustável para Ar Comprimido Moriya
700.803 Regulador de Pressão Ajustável para Hélio Moriya
700.805 Regulador de Pressão Ajustável para Nitrogênio Moriya
700.806 Regulador de Pressão Ajustável para Hidrogênio Moriya
700.807 Regulador de Pressão Ajustável para Acetileno Moriya
700.808 Regulador de Pressão Ajustável para Ar Comprimido ABNT 204-1 Moriya
700.810 Regulador de Pressão com Fluxômetro Aneróide para O2 Moriya
700.813 Regulador de Pressão Ajustável para Hidrogênio Linde
700.814 Regulador de Pressão Ajustável para Hélio/ Nitrogênio/ Argônio Linde
700.815 Regulador de Pressão Ajustável para Oxigênio Linde
700.816 Regulador de Pressão Ajustável para Ar Comprimido Linde
700.819 Regulador de Pressão Ajustável para Acetileno Linde
71.1675 Regulador de Pressão Ajustável para Ar Comprimido ABNT 204-1 Air Liquide
71.1676 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 A 15 L/Min para Ar Medicinal Air Liquide
71.1679 Regulador de Pressão Fixa para Ar Comprimido ABNT 204- 1 Air Liquide
71.2645 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 A 15 L/Min para Ar Comprimido Air Liquide
71.2646 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 15 l/min BC para Oxigênio Air Liquide
71.2646 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 A 15 L/Min para Oxigênio Air Liquide
71.2646.C15 Regulador de pressão com Fluxômetro 0 a 15 L/min Chile DIN477
71.2646.C3 Regulador de pressão com Fluxômetro 0 a 3 L/min Chile DIN477
71.2646.C5 Regulador de pressão com Fluxômetro 0 a 5 L/min Chile DIN477
71.2646D Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 15 l/min Conexão Direta para Oxigênio Air Liquide
71.2646P Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 15 l/min BL para Oxigênio Air Liquide

[Handwritten signature]



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa UDILIFE com Importação e Exportação EIRELI

CNPJ 34.061.908/0001-27 **Autorização** 8.19.655-4

Produto Otoscópio

Modelo Produto Médico

DNS-100N

DNS-1003

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instrução de Uso DSN-100N - DNS-1003.pdf	4567076/22-2 - 17/08/2022 - 05:06

Nome Técnico Otoscópio

Registro 81965540001

Processo 25351.215225/2021-42

Fabricante Legal

- FABRICANTE: DAD&SONS SURGICAL INDUSTRY - PAQUISTÃO

Classificação de Risco I - BAIXO RISCO

Vencimento do Registro VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar

925.592 Regulador de Pressão com Fluxômetro Aneróide para Ar Comprimido Moriya
925.593 Regulador de Pressão com Fluxômetro Aneróide para Ar Comprimido Moriya
925.594 Regulador de Pressão com Fluxômetro Aneróide para O2 Praxair
925.595 Regulador de Pressão com Fluxômetro Aneróide para Ar Comprimido Praxair
925.596 Regulador de Pressão com Fluxômetro Aneróide para O2 CGA 540 Moriya
925.597 Regulador de Pressão com Fluxômetro Aneróide para O2 DIN477 Moriya
928.138 Regulador de Pressão com Fluxômetro para Oxigênio - Furo calibrado e Fluxo contínuo
928.139 Regulador de Pressão com Fluxômetro para Oxigênio - Furo calibrado e Fluxo contínuo e intermitente
930.058 Regulador de pressão EC com Fluxômetro 0 a 15 l/min para oxigênio WM sem logo
930.059 Regulador de pressão EC com Fluxômetro 0 a 15 l/min Ar Comprimido WM sem logo
930.060 Regulador de Pressão Fixa EC de Oxigênio Moriya conector curto
931.258 Regulador de Pressão Fixa EC de Oxigênio (conexão invertida) Moriya
931.740 Regulador de Pressão Fixa EC para Ar Comprimido
931.741 Regulador de Pressão Fixa EC para Oxigênio
933.396 Regulador De Pressão Fixa EC De Oxigênio Com Sensor De Pressão
933.397 Regulador De Pressão Fixa HT De Oxigênio Com Sensor De Pressão
CNX0862 Regulador de pressão fixa conta litros 0 a 15 l/min DISS Ar Comprimido
CNX0863 Regulador de pressão fixa conta litros 0 a 15 l/min DISS Oxigênio
CNX0953P Regulador Fijo Cilíndrico c/ctalt esc med gir O2
M176000 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 15 l/min DIN 477
M60235 Regulador de Pressão Ajustável para Oxigênio DIN 477 Air Liquide
M61315 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 3 l/min DIN 477
M62411 Regulador sin Flujometro DIN 477
M62625 Regulador de Pressão Fixa para Oxigênio DIN 477 Air Liquide
RO5000 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Oxigênio Romed
RO5001 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Ar Comprimido Romed
RO5002 Regulador de Pressão com 1 saída para Oxigênio Romed
RO5003 Regulador de Pressão com 1 saída para Ar Comprimido Romed
RO5004 Regulador de pressão com 2 saídas para Oxigênio Romed
RO5005 Regulador de Pressão com 2 saídas para Ar Comprimido Romed
VC5829 Regulador de Pressão Ajustável para Oxigênio Haoxi
VC5830 Regulador de Pressão Ajustável para Ar Comprimido Haoxi
VC5833 Regulador de Pressão Ajustável para Nitrogênio Haoxi
VC5850 Regulador de Pressão Duplo Estágio para Oxigênio Haoxi
VC5851 Regulador de Pressão Duplo Estágio para Ar Comprimido Haoxi
VC5854 Regulador de Pressão Duplo Estágio para Nitrogênio Haoxi
100.142 Regulador de Pressão com Fluxômetro Aneróide para O2 Moriya
120.226 Regulador de Pressão Ajustável para Hidrogênio Messer
120.227 Regulador de Pressão Ajustável para Nitrogênio/Argônio/Hélio Messer

Handwritten signature or mark.

Fis. 71.2646.U15 Regulador de pressão com Fluxômetro 0 a 15 L/min Uruguay

71.2646.U3 Regulador de pressão com Fluxômetro 0 a 3 L/min Uruguay

71.2646.U5 Regulador de pressão com Fluxômetro 0 a 5 L/min Uruguay

71.5217 Regulador de Pressão com 2 saídas para Oxigênio Air Liquide

71.7146 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 A 30 L/Min para Gás Carbônico Air Liquide

71.7147 Regulador de Pressão Ajustável para Ar Comprimido Air Liquide

71.7149 Regulador de Pressão Ajustável para Hélio Air Liquide

71.7150 Regulador de Pressão Ajustável para Hidrogênio Air Liquide

71.7151 Regulador de Pressão Ajustável para Mistura

71.7153 Regulador de Pressão Ajustável para Nitrogênio Air Liquide

71.7154 Regulador de Pressão Fixa para Ar Comprimido Air Liquide

71.7155 Regulador de Pressão Fixa para Oxigênio Air Liquide

71.7160 Regulador de Pressão Ajustável para Oxigênio Air Liquide

8970028020 Regulador de Pressão Fixa EC para Oxigênio Atlas Copco

8970028021 Regulador de Pressão Fixa para Oxigênio Atlas Copco

8970028022 Regulador de Pressão EC com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Oxigênio Atlas Copco

8970028023 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Oxigênio Atlas Copco

8970028076 Regulador de Pressão Ajustável para Ar Comprimido Atlas Copco

8970028078 Regulador de Pressão Ajustável para Oxigênio Atlas Copco

900.100 Regulador de Pressão Duplo Estágio para Oxigênio Moriya

900.100-N Regulador de Pressão Duplo Estágio para Ar Comprimido Moriya

900.102 Regulador de Pressão Duplo Estágio para Oxigênio Moriya

900.103 Regulador de Pressão Duplo Estágio para Nitrogênio Moriya

900.104 Regulador de Pressão Duplo Estágio para Argônio Moriya

900.105 Regulador de Pressão Duplo Estágio para Hélio Moriya

900.106 Regulador de Pressão Duplo Estágio para Hidrogênio Moriya

900.107 Regulador de Pressão Duplo Estágio para Ar Comprimido Moriya

900.110 Regulador de Pressão Duplo Estágio para Acetileno Moriya

922.652 Regulador de Pressão Fixa para Ar Comprimido Praxair

922.653 Regulador de Pressão Fixa para Oxigênio Praxair

924.571 Regulador de Pressão EC com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Oxigênio Air Liquide

924.610 Regulador de Pressão EC com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Ar Comprimido ABNT 204-1 Air Liquide

925.537 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Ar Comprimido Lumiar

925.538 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Oxigênio Lumiar

925.539 Regulador de Pressão EC com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Ar Comprimido Lumiar

925.540 Regulador de Pressão EC com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Oxigênio Lumiar

925.547 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 15 l/min BL para Ar Comprimido Lumiar

925.548 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 15 l/min BL para Oxigênio Lumiar

[Handwritten signature]
Fabrica

120.369 Regulador de Pressão Fixa para Oxigênio Messer
120.370 Regulador de Pressão Fixa para Ar Comprimido Messer
120.371 Regulador de Pressão Fixa para Óxido Nitroso Messer
200.410 Regulador de Pressão Fixa EC para Oxigênio Moriya
200.412 Regulador de Pressão Fixa EC para Ar Comprimido Moriya

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	01.273 IFU - REGULADORES DE PRESSÃO DE GASES MEDICINAIS DE AÇO INOX rev05.pdf	4620615218 - 22/11/2021 12:12:37
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	06.358 - IFU - REGULADOR DE PRESSAO COM FLUXOMETRO PARA OXIGENIO MORIYA - FURO CALIBRADO E FLUXO CONTINUO rev00.pdf	4620615218 - 22/11/2021 12:12:37

Nome Técnico	Reguladores de Pressao de Gases Medicinais
Registro	10349590139
Processo	25351606886201430
Fabricante Legal	JG MORIYA REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA COMERCIAL LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

100
 10/01/2023

120.360 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Oxigênio Messer
120.361 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Ar Comprimido Messer
200.413 Regulador de Pressão EC com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Oxigênio Moriya
700.728 Regulador de Pressão Fixa para Oxigênio Linde
200.414 Regulador de Pressão EC com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Ar Comprimido Moriya
200.415 Regulador De Pressão Fixa EC Para Oxigênio Air Liquide
200.416 Regulador De Pressão Fixa EC Com Fluxometro 0 A 15 L/Min Para Oxigênio Air Liquide
200.417 Regulador De Pressão Fixa EC Para Oxigênio White Martins
200.418 Regulador De Pressão Fixa EC Com Fluxometro 0 A 15 L/Min Para Oxigênio White Martins
200.419 Regulador De Pressão Fixa EC Para Oxigênio Lumiar
200.420 Regulador De Pressão Fixa EC Com Fluxometro 0 A 15 L/Min Para Oxigênio Lumiar
40105780 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Oxigênio White Martins
40115738 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Ar Comprimido ABNT 204-1 White Martins
40121113 Regulador de Pressão Fixa para Oxigênio White Martins
40121352 Regulador de Pressão Fixa para Ar Comprimido White Martins
40121353 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 15 l/min para ar ABNT 218-1 White Martins
40121356 Regulador de Pressão com 2 saídas para Oxigênio White Martins
40121357 Regulador de Pressão com 2 saídas para Ar Comprimido White Martins
40121359 Regulador de Pressão com 2 saídas para Ar Comprimido ABNT 204-1 White Martins
40121443 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 3 l/min para Oxigênio White Martins
40125138 Regulador RNX – AR
40125143 Regulador RNX – OX
40125410 Regulador RNF – AR
40125414 Regulador RNF – OX
700.700 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Oxigênio Moriya
700.701 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Ar Comprimido Moriya
700.703 Regulador De Pressão Com Fluxômetro 0 a 15 L/Min P/ Oxigênio Linde
700.704 Regulador De Pressão Com Fluxômetro 0 a 15 L/Min P/ Ar Comprimido Linde
700.709 Regulador de Pressão Fixa para Ar Comprimido Haste Curta ABNT 204-1 Moriya
700.710 Regulador de Pressão Fixa para Oxigênio Moriya
700.711 Regulador de Pressão Fixa para Ar Comprimido Moriya
700.712 Regulador de Pressão Fixa para Oxigênio Haste Curta Moriya
700.713 Regulador de Pressão Fixa para Ar Comprimido Haste Curta Moriya
700.716 Regulador de Pressão EC com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Ar Comprimido ABNT 204-1 Moriya
700.723 Regulador de Pressão Fixa para Ar Comprimido ABNT 204- 1 Moriya
700.724 Regulador de Pressão com Fluxômetro 0 a 15 l/min para Ar Comprimido ABNT 204-1 Moriya
120.363 Regulador de Pressão Ajustável para Oxigênio Messer
120.364 Regulador de Pressão Ajustável para Ar Comprimido Messer

[Handwritten signatures and marks]

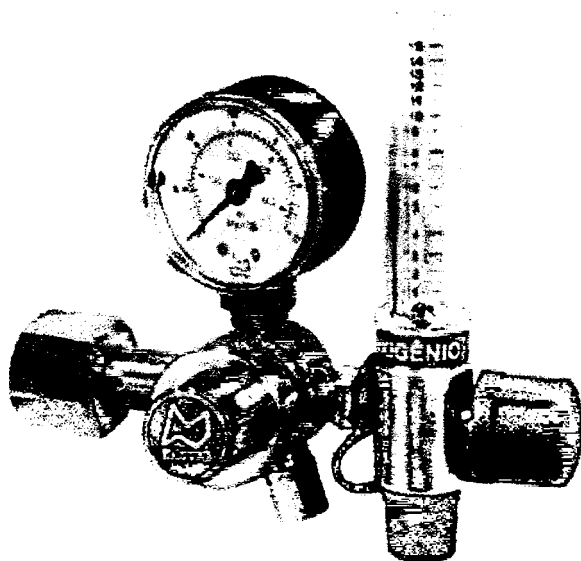

REGULADOR ECONÔMICO COM FLUXÔMETRO 0-15L/MIN OXIGÊNIO

Os Reguladores de Pressão com Fluxômetro -
Linha Econômica tem como função reduzir
uma pressão de entrada, variável e alta, para
uma pressão de saída baixa e constante, o
fluxômetro controla e indica o fluxo dos
gases. Há um Regulador de Pressão com
Fluxômetro específico para cada tipo de gás.

REF: 200.413

DESCRIÇÃO

Os Reguladores de Pressão com Fluxômetro - Linha Econômica tem como função reduzir uma pressão de entrada, variável e alta, para uma pressão de saída baixa e constante, o fluxômetro controla e indica o fluxo dos gases. Há um Regulador de Pressão com Fluxômetro específico para cada tipo de gás.

Código do Produto (SKU/REF): 200.413

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Publicada

Microscópio DNS-1003 Instrumento de diagnóstico de bolso
Iluminação LED por Fibra Óptica



Distribuidor oficial
UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
Rua Itália 60, Tibery, Uberlândia-MG, 38405-056, Brasil



T: +55 34 3199-9880
contato@udilife.com.br

Otoscópio DNS-1003 Instrumento de diagnóstico de bolso
Iluminação LED por Fibra Óptica



OTOSCÓPIO DNS-1003 LED F.O.

- Feito de ABS resistente a impactos e material de aço inoxidável altamente resistente à corrosão.
- Janela giratória com lente de ampliação 3X para imagem nítida e reflexão mínima.
- Porta de insuflação para teste pneumático de mobilidade timpânica.
- Lâmpada LED com vida útil de 50.000 horas
- Transmissão de luz por fibra óptica
- Cabo ergonômico alimentado por 2 pilhas do tipo AA.
- Clip de bolso com interruptor integrado com desligamento automático ao ser fixado no bolso.
- LED de alto brilho na cor branca, proporcionando melhor visibilidade e sem distorção na cor do tecido para melhor diagnóstico.
- Acompanha estojo macio para melhor acomodação.
- Incluso 5 espéculos auriculares de 2,5mm e 5 espéculos de 4,0mm.
- Certificado pelo INMETRO.
- Registro na ANVISA: 81965540001
- Disponível nas cores: Preto, Azul e Rosa.

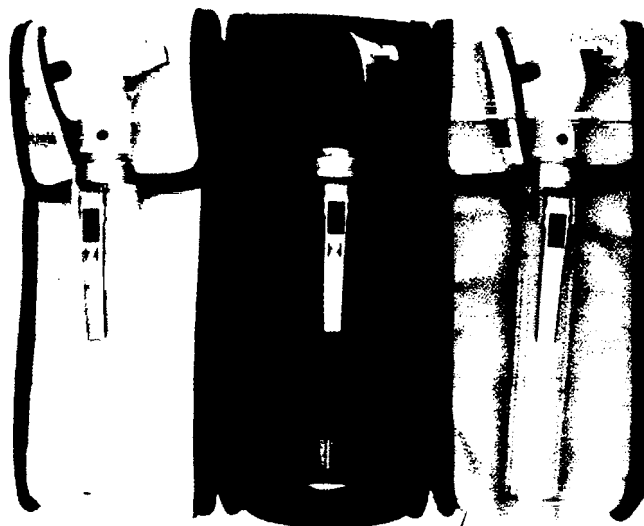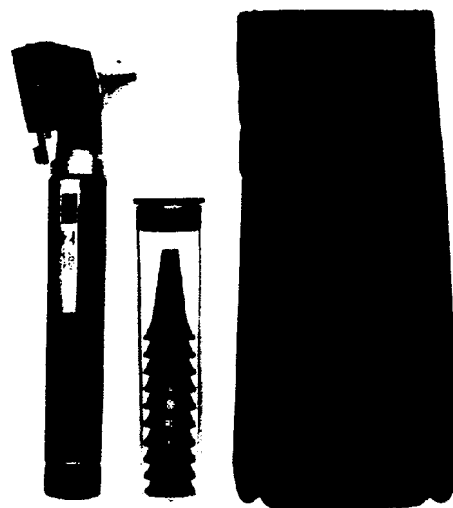


COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 896V
AAR
Rubrica

Otoscópio DNS-1003

Instrumento de diagnóstico de bolso

Iluminação LED por Fibra Óptica

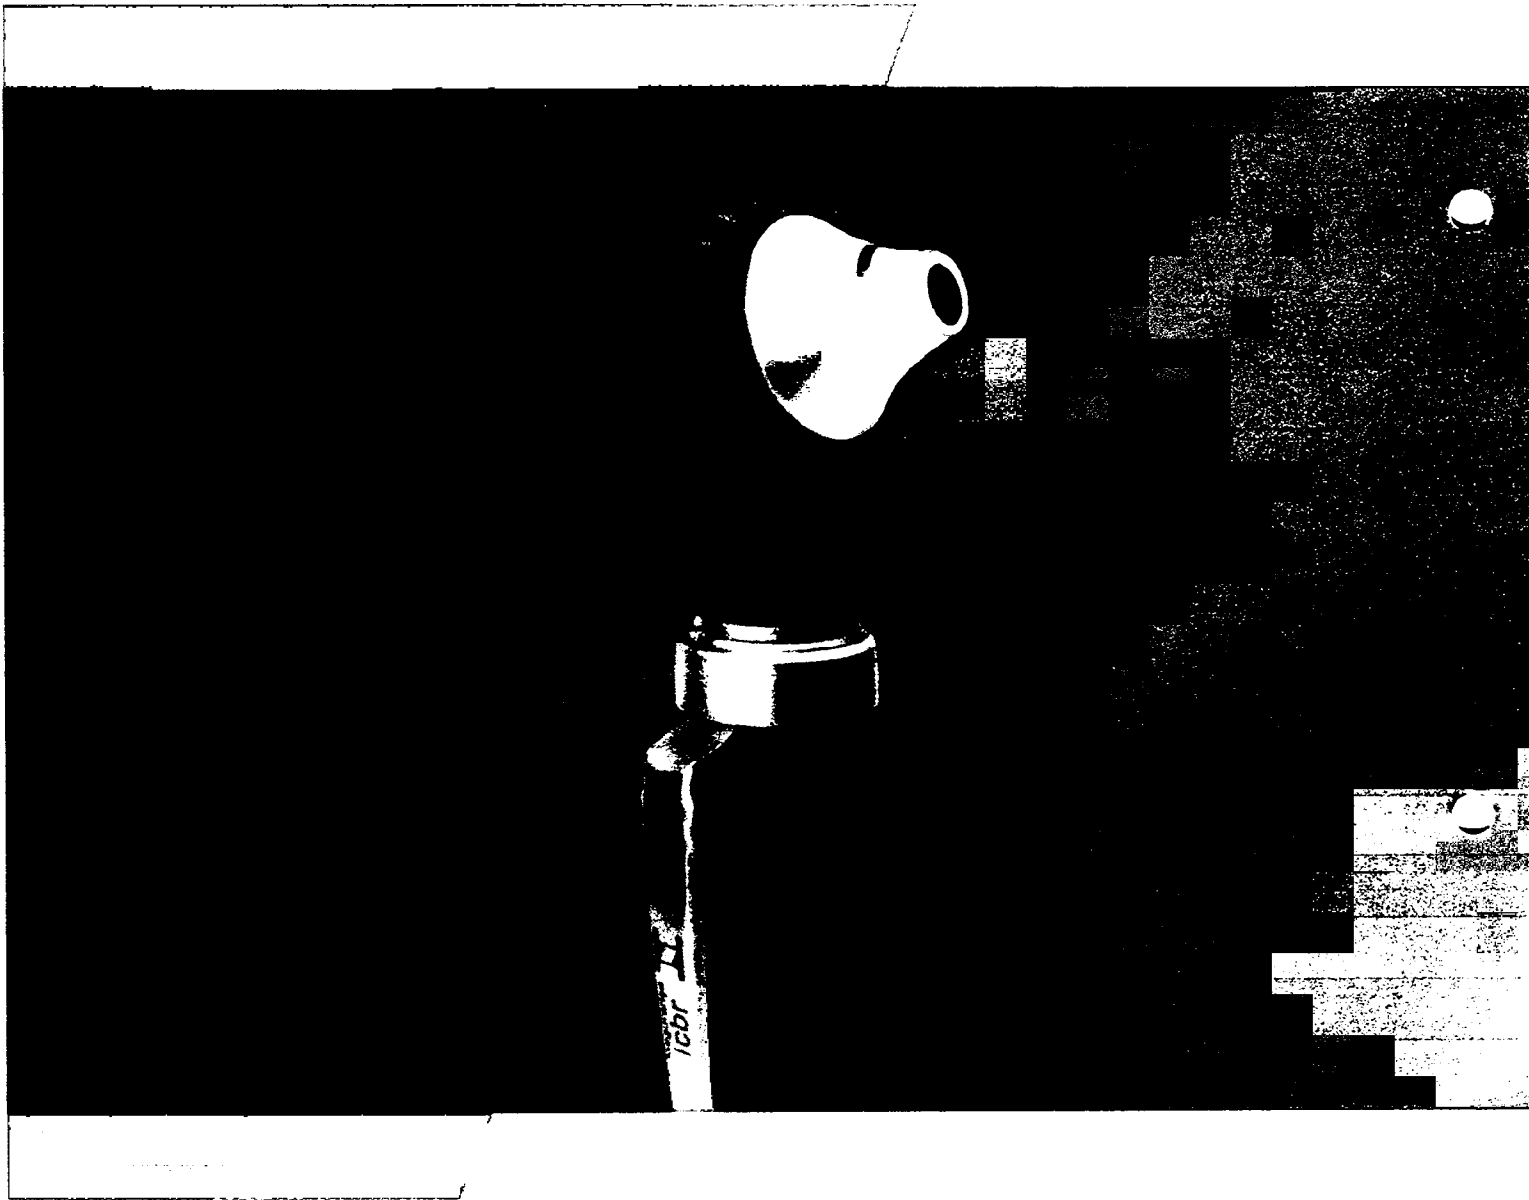

Handwritten signature

Handwritten signature

D&S
DAD & SONS



MT 300 - Divã clínico adulto - Pintado - 1,85x0,55x0,80 - Estofado preto



Descrição

Descrição do Produto

- Produto confeccionado em aço redondo;
- Pintura epóxi branca, garantindo melhor qualidade e durabilidade da superfície;
- Pés com ponteiros plásticos na cor preta;
- Leito estofado com espuma revestimento em courvim;
- Cabeceira reclinável por meio de cremalheira em até 4 posições;
- Fácil higienização;
- Produto montado;

Indicações

- Pode ser usado em clínicas, hospitais, consultórios, etc.

Itens inclusos

- 01 Diva clínico adulto - Pintado - Estofado preto

Especificações técnicas


- Modelo: MT300;
- Estrutura: Aço redondo;
- Pintura: Branca - Epóxi;
- Peso máximo suportado: 120Kg;
- Pés com ponteiros plásticos;
- Dimensões: 185x70x80cm (Profundidade x Largura x Altura);

✓

[Handwritten signature]

Ass
 Rubrica

Lâmina Reta Fibra Óptica Exray Miller

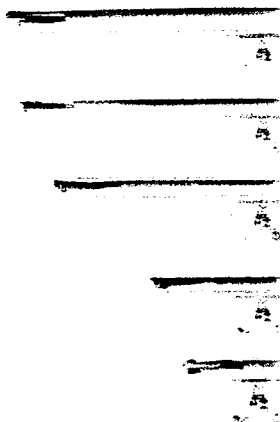

FMG-001-2340-00
 Lâmina Reta Fibra Óptica Exray Miller nº 00 - Prematuro

FMG-001-2340-00
 Lâmina Reta Fibra Óptica Exray Miller nº 0- Neonato


FMG-001-2340-01
 Lâmina Reta Fibra Óptica Exray Miller nº 1- Infantil

FMG-001-2340-02
 Lâmina Reta Fibra Óptica Exray Miller nº 2- Criança

FMG-001-2340-03
 Lâmina Reta Fibra Óptica Exray Miller nº 3- Adulto médio

FMG-001-2340-04
 Lâmina Reta Fibra Óptica Exray Miller nº 4- Adulto grande

Lâmina Curva Fibra Óptica Exray Macintosh

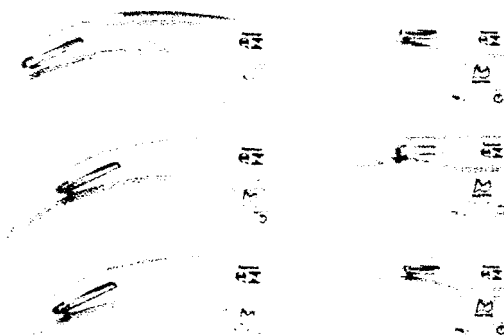

FMG-001-2330-000
 Lâmina Curva Fibra Óptica Exray Mac 00 - Prematuro

FMG-001-2330-00
 Lâmina Curva Fibra Óptica Exray Mac 0- Neonato

FMG-001-2330-01
 Lâmina Curva Fibra Óptica Exray Mac 1- Infantil


FMG-001-2330-02
 Lâmina Curva Fibra Óptica Exray Mac 2- Criança

FMG-001-2330-03
 Lâmina Curva Fibra Óptica Exray Mac 3- Adulto médio

FMG-001-2330-04
 Lâmina Curva Fibra Óptica Exray Mac 4- Adulto grande


FMG-001-2330-05
 Lâmina Curva Fibra Óptica Exray Mac 5- Adulto extra grande

Cabo de Laringoscópio Xenon - Fibra Óptica

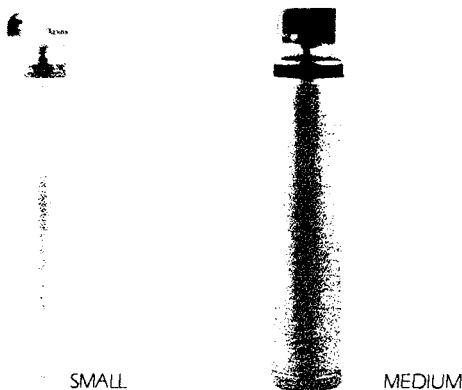

FMG-001-2660-S Cabo de Laringoscópio Xenon - SMALL
 FMG-001-2660-M Cabo de Laringoscópio Xenon - MEDIUM

Cabo de Laringoscópio Convencional

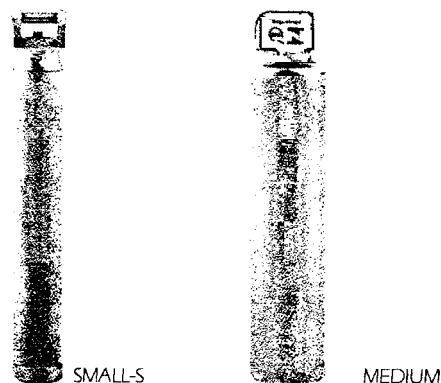

FMC-003-3600-S Cabo de Laringoscópio Convencional - SMALL
 FMC-003-3600-M Cabo de Laringoscópio Convencional - MEDIUM




J.G.Moriya Repres. Import. e Export. Comercial Ltda.
 Unidade I - Rua Colorado, 279 - CEP 04225-050
 Vila Carioca - Ipiranga - São Paulo/SP
 Tel.: 55 11 2914-9716 - Fax: 5511 2914-1943
 Email: jgmoriya@jgmoriya.com.br

J.G.Moriya Repres. Import. e Export. Comercial Ltda.
 Unidade II - Rua da União, 377
 CEP 04107-011 Acimação - São Paulo/SP
 Tel.: 55 11 5573-9773 - Fax: 55 11 5549-9302
 www.jgmoriya.com.br

Ass


LARINGOSCÓPIOS MORIYA

M. A. P.
Moriya

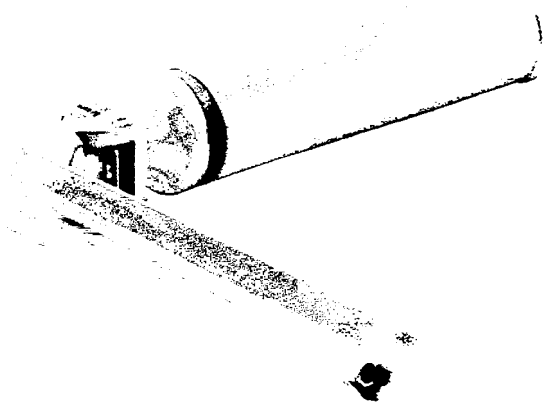


Os laringoscópios Moriya possuem características exclusivas, possibilitando assim uma perfeita entubação traqueal com visão total da laringe, em casos de difícil exposição. Leves, de fino acabamento, cabo rosqueado com rosca em passo grande, pino de aço substituível para pilhas pequenas e médias. Composto de lâminas curvas e retas de aço inoxidável em peça única e lâmpada de alta luminosidade. O laringoscópio de fibra óptica reutilizável é utilizado para examinar e visualizar o trato respiratório superior do paciente para colocar o tubo traqueal durante intubações.

Lâmina Reta Convencional Warm Ray Miller

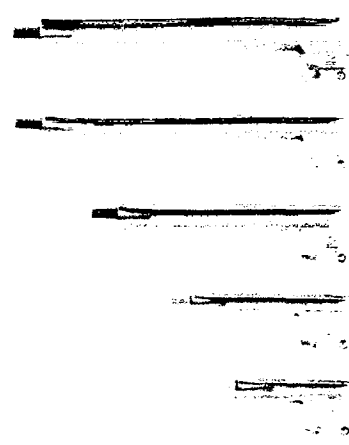

- FMC-003-3020-000
Lâmina Reta Convencional Warm Ray Miller nº 00- Prematuro
- FMC-003-3020-00
Lâmina Reta Convencional Warm Ray Miller nº 0- Neonato
- FMC-003-3020-01
Lâmina Reta Convencional Warm Ray Miller nº 1- Infantil
- FMC-003-3020-02
Lâmina Reta Convencional Warm Ray Miller nº 2- Criança
- FMC-003-3020-03
Lâmina Reta Convencional Warm Ray Miller nº 3- Adulto médio
- FMC-003-3020-04
Lâmina Reta Convencional Warm Ray Miller nº 4- Adulto grande
- FMC-003-3020-05
Lâmina Reta Convencional Warm Ray Miller nº 5- Adulto extra grande

Lâmina Curva Convencional Warm Ray Macintosh

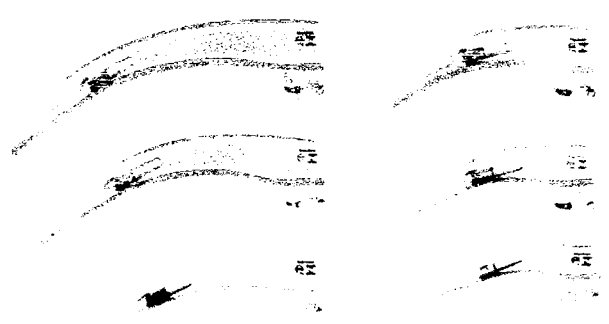

- FMC-003-3010-00
Lâmina Curva Convencional Warm Ray Mac 0- Neonato
- FMC-003-3010-01
Lâmina Curva Convencional Warm Ray Mac 1- Infantil
- FMC-003-3010-02
Lâmina Curva Convencional Warm Ray Mac 2- Criança
- FMC-003-3010-03
Lâmina Curva Convencional Warm Ray Mac 3- Adulto médio
- FMC-003-3010-04
Lâmina Curva Convencional Warm Ray Mac 4- Adulto grande
- FMC-003-3010-05
Lâmina Curva Convencional Warm Ray Mac 5- Adulto extra grande




M. A. P.

J. P.

Instruções de operação

Para utilizar o otoscópio acople a cabeça com o cabo de energia, alinhe a rosca da cabeça (G) com a rosca do cabo (A) e gire a cabeça no sentido horário até a cabeça e o cabo ficar firmemente unida. Coloque o espéculo no otoscópio de forma que a projeção dentro da ponta da orelha se encaixe na fenda e aperte a ponta do espéculo girando-o ligeiramente para a direita conforme imagem (E). Ao mover o interruptor (B) para baixo o dispositivo estará ligado acendendo a lâmpada. Para desligar, basta mover o interruptor (B) para cima.

Fig.1

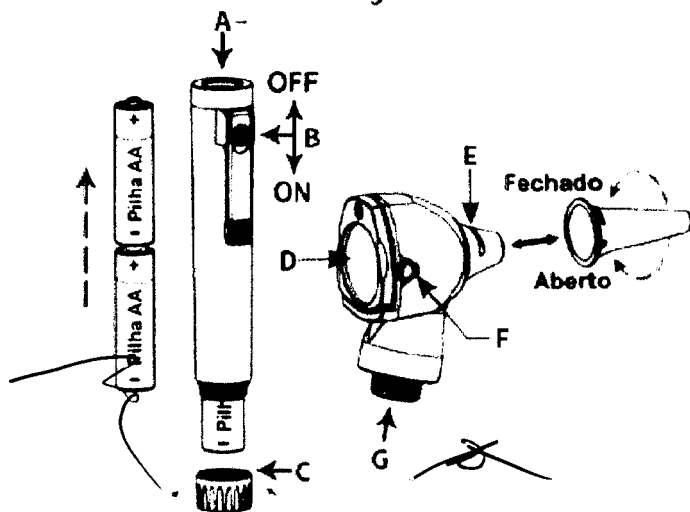

Substituição das baterias

Providencie duas pilhas de tamanho AA alcalinas de boa qualidade para alimentação. Gire a tampa da extremidade inferior do cabo no sentido anti-horário para abrir a tampa (C) Fig. 1. Insira duas pilhas no cabo com terminal positivo (+) em direção à cabeça e feche a tampa girando no sentido horário.

Nota: As pilhas não estão incluídas nos conjuntos.

Substituição da lâmpada

Gire a cabeça do otoscópio no sentido anti-horário para separá-la do cabo. Puxe a lâmpada para baixo e insira a nova lâmpada no soquete e gire a cabeça no sentido horário até que a cabeça e o cabo estejam

firmemente encaixados. Antes de substituir lâmpada, leia as instruções abaixo com atenção. Deixe o aparelho esfriar antes de trocar a lâmpada. Verifique a tensão / especificação da lâmpada antes de mudar.

Espéculo

A ponta auricular é usada em otoscópio como passagem de visualização para exame direto do conduto auditivo externo e membrana timpânica. Escolha o tamanho da ponta auricular adequado para o exame do conduto auditivo. O uso do espéculo evita lesão auditiva e/ou contaminação cruzada. Não reutilize uma ponta auricular descartável que pode resultar na contaminação de um paciente para outro.

Lentes de Aumento

A lente giratória possui uma ampliação de 3x sem distorção do objeto examinado (D) Fig. 1. A janela está fixada na cabeça e pode ser girada para o lado para instrumentação. Para facilitar a instrumentação gire a janela de visualização no sentido horário tanto quanto necessário.

Limpeza / Desinfecção e Manutenção

Para a limpeza da parte externa da cabeça utilize um macio e seco, na parte interna utilize um cotonete seco ou umedecido com água ou álcool. O cabo deve ser limpo com pano embebido de água ou álcool.

NÃO AUTOCLAVAR, Não imergir em banho ultrassônico, não utilize spray de desinfecção ou tratamento por imersão em líquidos.

Transporte e Armazenamento

Antes de transportar o aparelho, certifique-se de que está corretamente embalado garantindo também que não haja riscos de choques, batidas ou quedas durante o próprio transporte. Os danos causados no aparelho durante o transporte e manuseio não são cobertos pela garantia. O dispositivo deve ser armazenado em uma área seca e fresca, longe da luz solar direta. Não deve ser colocado em contato com quaisquer substâncias ou agentes químicos que

possam causar danos e reduzir as características de segurança.

Parâmetros	Especificação
Temperatura Operacional	5 a 40°C
Armazenamento	-20 a 60°C
Umidade relativa	Humidificação: 5 a 95% condensação Armazenamento: 5 a 95% condensação
Pressão	Operação: 62 ± 0,06 kPa Armazenamento: 0 ~ 106 kPa

Especificações Elétricas

Parâmetros	Especificação
Potência de entrada	Voltagem: 3.0 VCC Corrente: 810 mA
Classificação	Classe II, equipamento energizado internamente Parte aplicada tipo B Proteção contra respingos: IPX0 Não esterilizado Modo de operação não contínuo
Baterias	Número: 2 Tipo: Alcalina Volltagem: 3.0 VCC

Conformidade

Norma IEC	Descrição
IEC 60601-1	Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial
IEC 60601-1-2	Compatibilidade eletromagnética


Declaração

















NOTA:



• Conforme norma IEC 60601-1-2.

Símbolos

Os seguintes símbolos podem aparecer no dispositivo, embalagem ou rótulos:



Simbolo	Definição
	Fabricante
	Data de Fabricação
	Número do lote
	Alimentação DC
	Limitações de temperatura no transporte e armazenamento.
	limitações de umidade no transporte e armazenamento.
	Pressão atmosférica no transporte e armazenamento.
	Siga as instruções de uso. Esta etiqueta no dispositivo indica ao usuário para verificar o manual para obter informações completas. No manual do usuário, este símbolo faz referências cruzadas a etiqueta.
	Descarte de acordo com a Diretiva 2012/19 / UE ou WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Grau de proteção contra umidade e partículas
	Parte aplicada tipo B (classificação de equipamento eletro médico, conforme especificado pela norma IEC 60601-1).
	O dispositivo não é adequado para utilização no ambiente de ressonância magnética.
	Frágil, manusear com cuidado.
	Manter seco no transporte e armazenamento.
	materiais recicláveis.
	Atenção, consulte a seção no manual do operador que o acompanha.

Simbolo	Definição
	Interruptor de alimentação – Verde (On) / Vermelho (Off)
	Bateria

Garantia

O otoscópio possui garantia de 1 ano a contar a partir da data de emissão da nota fiscal de venda. Já seus acessórios possuem garantia de 3 meses.

A garantia cobre defeitos de materiais construtivos e de fabricação.


A garantia será perdida caso ocorra uso indevido ou desacordo com as instruções presente neste manual, ou utilização de acessórios, partes ou peças não autorizadas.

Assistência Técnica:

Para qualquer esclarecimento de dúvidas sobre o funcionamento e operação do otoscópio entre em contato com a assistência técnica autorizada.

UDILIFE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
 Avenida Itália 60 – Tibery – Uberlândia-MG – 38405-056
 CNPJ: 34.061.908/0001-27
 Email: sac@udilife.com.br
 (34)3199-9880

OTOSCÓPIO DNS-100N / DNS-1003 Manual do Usuário

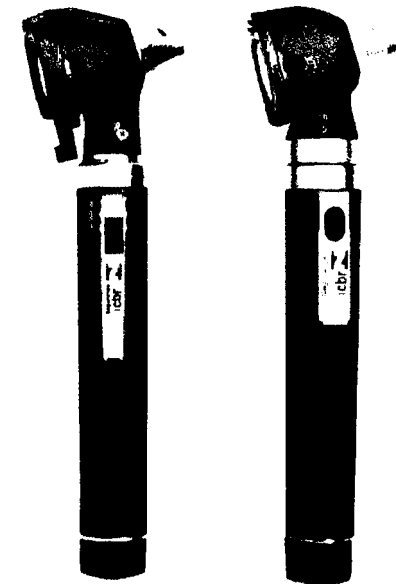

Indicação de Uso

Os otoscópios DNS-100N / DNS 1003 e acessórios associados destinam-se ao exame do ouvido, audição externa do canal e do tímpano.

Este instrumento possui uma lente de aumento óptica e cabo de iluminação alimentada por pilhas alcalinas tamanho AA, e é recomendado para uso por profissionais treinados e familiarizado com as técnicas implicadas e após serem lidas as instruções de uso deste manual para avaliar a saúde do ouvido através da transmissão de luz no canal do ouvido.

Características

- Feito de ABS resistente a impactos e material de aço inoxidável altamente resistente à corrosão.
- Janela giratória com lente de ampliação 3X para imagem nítida e reflexão mínima.
- Porta de insuflação para teste pneumático de mobilidade timpânica.
- Lâmpada LED com vida útil de 50.000 horas
- Transmissão de luz por fibra óptica

COMISSÃO LICITAC
 Nº 899/20
 Fabrica

Arle
Rubrica

FORTALEZA-CE, 13 DE FEVEREIRO 2023.

AO GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM/CE
ATT.: AO PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: PROPOSTA DE PREÇO

PREZADOS SENHORES;
APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2701.01/2023, REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CEARÁ.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2701.01/2023 DATA DE ABERTURA 13 DE FEVEREIRO AS 10:30HRS.

PREZADOS SENHORES,

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 24 - MATERIAL DE URGÊNCIA E IMOBILIZAÇÃO I										
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD. HOSPITAL	QTD. ATENÇÃO BÁSICA	QTD TOTAL	MARCA	V. UNITÁRIO	-	V. TOTAL	-
1	COLAR DE RESGATE CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE ESPESURA ENTRE 1,5MM E 1,8MM REVESTIDO EM EVA BRANCO DE 4 MM, VELCRO COSTURADO EM AMBOS OS LADOS NAS CORES SEGUINDO PADRÃO DE CADA TAMANHO, MONTADO ATRAVÉS DE BOTÃO COM TRAVAMENTO NA COR NATURAL INJETADO EM NYLON, SUPORTE MENTONIANO, ABERTURA FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. TAMANHO INFANTIL. EMBALADOR INDIVIDUALMENTE CONTER NA EMBALAGEM NFORMAÇÕES SOBRE LOTE, VALIDADE, FABRICANTE.	Unidade	10	15	25	RESGATE	R\$ 20,10	vingte reais e dez centavos	R\$ 502,50	quinhentos e dois reais e cinquenta centavos
2	COLAR DE RESGATE CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE ESPESURA ENTRE 1,5MM E 1,8MM REVESTIDO EM EVA BRANCO DE 4 MM, VELCRO COSTURADO EM AMBOS OS LADOS NAS CORES SEGUINDO PADRÃO DE CADA TAMANHO, MONTADO ATRAVÉS DE BOTÃO COM TRAVAMENTO NA COR NATURAL INJETADO EM NYLON, SUPORTE MENTONIANO, ABERTURA FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. TAMANHO PP. EMBALADOR INDIVIDUALMENTE CONTER NA EMBALAGEM NFORMAÇÕES SOBRE LOTE, VALIDADE, FABRICANTE	Unidade	10	15	25	RESGATE	R\$ 20,10	vingte reais e dez centavos	R\$ 502,50	quinhentos e dois reais e cinquenta centavos
3	TALA DE IMOBILIZAÇÃO P	Unidade	10	5	15	RESGATE	R\$ 15,20	quinze reais e vinte centavos	R\$ 228,00	duzentos e vinte e oito reais
4	TALA DE IMOBILIZAÇÃO M	Unidade	10	5	15	RESGATE	R\$ 17,90	dezessete reais e noventa centavos	R\$ 268,50	duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos
5	TALA DE IMOBILIZAÇÃO G	Unidade	10	5	15	RESGATE	R\$ 22,10	vingte e dois reais e dez centavos	R\$ 331,50	trezentos e trinta e um reais e cinquenta centavos
6	FIO GUIA PARA ENTUBAÇÃO, MADRIL TIPO VARETA EM COBRE FLEXÍVEL CROMADO - INFANTIL	Unidade	20		20	PROTEC	R\$ 87,00	oitenta e sete reais	R\$ 1.740,00	mil setecentos e quarenta reais
7	FIO GUIA PARA ENTUBAÇÃO, MADRIL TIPO VARETA EM COBRE FLEXÍVEL CROMADO - ADULTO	Unidade	40		40	PROTEC	R\$ 87,00	oitenta e sete reais	R\$ 3.480,00	três mil, quatrocentos e oitenta reais
8	CÂNULA OROFARINGEA DE GUEDEL CARACTERÍSTICAS • FABRICADA EM POLIETILENO, LIVRE DE LÁTEX • FORMATO ANATÔMICO, MAIOR CONFORTO AO PACIENTE • EXTREMIDADES MACIAS E ARREDONDADAS PARA EVITAR LESÕES NO TECIDO • DISPONÍVEL EM 8 TAMANHOS CODIFICADOS POR CORES • PERMITE O ACESSO AO CATETER DE SUCCÃO • PREVINE	Unidade	5		5	PROTEC	R\$ 11,12	onze reais e doze centavos	R\$ 55,60	cinquenta e cinco reais e sessenta centavos
9	KIT VENTURI. (MÁSCARA VENTURI + 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA 2 + TRAQUEIA + CONECTOR COM OXIGÊNIO). ATÓXICO. MÁSCARA FLEXÍVEL, COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL	KIT	15		15	NORMED	R\$ 57,80	cinquenta e sete reais e oitenta centavos	R\$ 867,00	oitocentos e sessenta e sete reais
10	MÁSCARA PARA REANIMADOR DE SILICONE - ADULTO	Unidade	2	3	5	PROTEC	R\$ 52,00	cinquenta e dois reais	R\$ 260,00	duzentos e sessenta reais
11	MÁSCARA PARA REANIMAR DOR DE SILICONE - PEDIÁTRICO	Unidade	2	3	5	PROTEC	R\$ 75,76	setenta e cinco reais e setenta e seis centavos	R\$ 378,80	trezentos e setenta e oito reais e oitenta centavos
12	MÁSCARA PARA REANIMADOR MANUAL VERDE N.03- ADULTO	Unidade	1	4	5	PROTEC	R\$ 75,76	setenta e cinco reais e setenta e seis centavos	R\$ 378,80	trezentos e setenta e oito reais e oitenta centavos
13	MÁSCARA PARA REANIMADOR VERDE N.01- PEDIÁTRICO	Unidade	1	4	5	PROTEC	R\$ 75,76	setenta e cinco reais e setenta e seis centavos	R\$ 378,80	trezentos e setenta e oito reais e oitenta centavos
14	REANIMADOR DE SILICONE COM RESERVATORIO- ADULTO	Unidade	5		5	PROTEC	R\$ 75,76	setenta e cinco reais e setenta e seis centavos	R\$ 378,80	trezentos e setenta e oito reais e oitenta centavos

15	REANIMADOR DE SILICONE COM RESERVATORIO - PEDIATRICO	Unidade	5		5	PROTEC	R\$ 75,76	setenta e cinco reais e setenta e seis centavos	R\$ 378,80	trezentos e setenta e oito reais e oitenta centavos
16	REANIMADOR MANUAL (AMBUR) VERDE - ADULTO	Unidade	5	2	7	PROTEC	R\$ 272,00	duzentos e setenta e dois reais	R\$ 1.904,00	mil novecentos e quatro reais
17	REANIMADOR MANUAL (AMBUR) VERDE PEDIÁTRICO	Unidade	5	2	7	PROTEC	R\$ 272,00	duzentos e setenta e dois reais	R\$ 1.904,00	mil novecentos e quatro reais
18	UMIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA	Unidade	20	60	80	PROTEC	R\$ 24,90	vinte e quatro reais e noventa centavos	R\$ 1.992,00	mil novecentos e noventa e dois reais
19	MASCARA DE VENTURI INFANTIL-KIT	KIT	10		10	MD	R\$ 58,00	cinquenta e oito reais	R\$ 580,00	quinhentos e oitenta reais
20	MÁSCARA DE VENTURI ADULTO-KIT	KIT	10		10	MD	R\$ 58,00	cinquenta e oito reais	R\$ 580,00	quinhentos e oitenta reais
21	KIT PARA DRENAGEM DE TORAX COMPOSTO DE FRASCO, CONECTOR, EXTENSÃO, DRENO, SUPORTE PARA BASE, ALÇA PARA TRANSPORTE, FRASCO C/TAMPA ROSQUEADA, C/FILTRO, CAPACIDADE 500ML, COM GRADUAÇÃO INDELEVEL, A CADA 50ML, PINÇA TIPO CLAMP C/TRAVA DE SEGURANÇA, CONECTOR UNIVERSAL; EXTENSÃO EM MATERIAL TRANSLUCIDO, M	KIT	5		5	CLINMED	R\$ 52,00	cinquenta e dois reais	R\$ 260,00	duzentos e sessenta reais

Rubrica

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten Signature]
Rubrica

22	KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX COMPOSTO DE FRASCO, CONECTOR, EXTENSÃO, DRENO, SUPORTE PARA BASE, ALÇA PARA TRANSPORTE, C/TAMPA ROSQUEADA, C/FILTRO, CAPACIDADE 1000ML, C/GRADUAÇÃO INDELEVEL, PINÇA TIPO CLAMP, C/TRAVA DE SEGURANÇA UNIVERSAL, EXTENSÃO EM MATERIAL TRANSLUCIDO, MEDIN, MEDINDO APROXIMADAMENTE	KIT	5	5	CLINMED	R\$ 58,00	cinquenta e oito reais	R\$ 290,00	duzentos e noventa reais
LOTE 24								R\$	17.639,60
dezesete mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta centavos									

VALOR TOTAL DOS LOTES	R\$	17.639,60
dezesete mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta centavos		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NOS PREÇOS OFERECIDOS ESTAO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO, TRIBUTOS, DESLOCAMENTO DE PESSOAL E DEMAIS ONUS PERTINENTES A CONTRATAÇÃO.

DECLARAMOS AINDA QUE, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA ENTREGA DOS PRODUTOS, E QUE SERAO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICIA E CONTRATUAL, E QUE SERAO INCIADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À EPECIFICAÇÃO E CARACTERISTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXO

DECLARAMOS QUE NOS VALORES APRESENTADOS EM NOSSA PROPOSTA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, SEGUROS, DESLOCAMENTO DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

FORTALEZA/CE, 13 DE FEVEREIRO DE 2023.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Assinatura]

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2701.01/2023-SMS/SRP

DISPUTA DE LANCES: 13/02/2023 ÀS 10H30

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CEARÁ.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 24 - MATERIAL DE URGENCIA E IMOBILIZAÇÃO I							
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTDE	VL UNIT.	VL TOTAL
24	1	COLAR DE RESGATE CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE ESPESURA ENTRE 1,5MM E 1,8MM REVESTIDO EM EVA BRANCO DE 4 MM, VELCRO COSTURADO EM AMBOS OS LADOS NAS CORES SEGUINDO PADRÃO DE CADA TAMANHO, MONTADO ATRAVÉS DE BOTÃO COM TRAVAMENTO NA COR NATURAL INJETADO EM NYLON, SUPORTE MENTONIANO, ABERTURA FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. TAMANHO INFANTIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CONTER NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE LOTE, VALIDADE, FABRICANTE	UND	ORTOCENTER	25	R\$ 59,70	R\$ 1.492,50
24	2	COLAR DE RESGATE CONFECCIONADO EM POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE ESPESURA ENTRE 1,5MM E 1,8MM REVESTIDO EM EVA BRANCO DE 4 MM, VELCRO COSTURADO EM AMBOS OS LADOS NAS CORES SEGUINDO PADRÃO DE CADA TAMANHO. MONTADO ATRAVÉS DE BOTÃO COM TRAVAMENTO NA COR NATURAL INJETADO EM NYLON, SUPORTE MENTONIANO, ABERTURA FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. TAMANHO PP. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CONTER NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE LOTE, VALIDADE, FABRICANTE.	UND	ORTOCENTER	25	R\$ 59,70	R\$ 1.492,50
24	3	TALA DE IMOBILIZAÇÃO P	UND	ORTOCENTER	15	R\$ 53,13	R\$ 796,95
24	4	TALA DE IMOBILIZAÇÃO M	UND	ORTOCENTER	15	R\$ 62,79	R\$ 941,85
24	5	TALA DE IMOBILIZAÇÃO G	UND	ORTOCENTER	15	R\$ 77,28	R\$ 1.159,20
24	6	FIO GUIA PARA ENTUBAÇÃO, MADRIL TIPO VARETA EM COBRE FLEXÍVEL CROMADO - INFANTIL	UND	HAOXI	20	R\$ 144,90	R\$ 2.898,00
24	7	FIO GUIA PARA ENTUBAÇÃO, MADRIL TIPO VARETA EM COBRE FLEXÍVEL CROMADO - ADULTO	UND	HAOXI	40	R\$ 144,90	R\$ 5.796,00
24	8	CANULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL CARACTERÍSTICAS • FABRICADA EM POLIETILENO, LIVRE DE LÁTEX • FORMATO ANATÔMICO, MAIOR CONFORTO AO PACIENTE • EXTREMIDADES MACIAS E ARREDONDADAS PARA EVITAR LESÕES NO TECIDO • DISPONÍVEL EM 8 TAMANHOS CODIFICADOS POR CORES • PERMITE O ACESSO AO CATETER DE SUÇÃO • PREVIENE A MORDEDURA DA LÍNGUA E A OBSTRUÇÃO DO TRATO RESPIRATÓRIO TAMANHOS: 00 - 40MM - ROSA CLARO 0 - 50MM - AZUL 1 - 60MM - PRETA 2 - 70MM - BRANCA 3 - 80MM - VERDE 4 - 90 MM - AMARELO	UND	MD	5	R\$ 142,23	R\$ 711,15
24	9	KIT VENTURI. (MASCARA VENTURI + 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA 2 + TRAQUEIA + CONECTOR COM OXIGENIO). ATÓXICO. MASCARA FLEXIVEL, COM ELASTICO PARA AJUSTE FACIAL.	KIT	MD	15	R\$ 66,33	R\$ 994,95
24	10	MASCARA PARA REANIMADOR DE SILICONE - ADULTO	UND	HAOXI	5	R\$ 228,00	R\$ 1.140,00
24	11	MASCARA PARA REANIMAR DOR DE SILICONE - PEDIATRICO	UND	HAOXI	5	R\$ 228,00	R\$ 1.140,00
24	12	MASCARA PARA REANIMADOR MANUAL VERDE N.03- ADULTO	UND	OXIGEL	5	R\$ 180,00	R\$ 900,00
24	13	MASCARA PARA REANIMADOR VERDE N.01- PEDIATRICO	UND	OXIGEL	5	R\$ 180,00	R\$ 900,00
24	14	REANIMADOR DE SILICONE COM RESERVATORIO- ADULTO	UND	HAOXI	5	R\$ 912,00	R\$ 4.560,00
24	15	REANIMADOR DE SILICONE COM RESERVATORIO - PEDIATRICO	UND	HAOXI	5	R\$ 723,00	R\$ 3.615,00
24	16	REANIMADOR MANUAL (AMBUR) VERDE - ADULTO	UND	OXIGEL	7	R\$ 900,00	R\$ 6.300,00
24	17	REANIMADOR MANUAL (AMBUR) VERDE PEDIÁTRICO	UND	OXIGEL	7	R\$ 900,00	R\$ 6.300,00
24	18	UNIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA	UND	OXIGEL	80	R\$ 46,29	R\$ 3.703,20
24	19	MASCARA DE VENTURI INFANTIL-KIT	KIT	MD	10	R\$ 66,33	R\$ 663,30
24	20	MÁSCARA DE VENTURI ADULTO-KIT	KIT	MD	10	R\$ 66,33	R\$ 663,30
24	21	KIT PARA DRENAGEM DE TORAX COMPOSTO DE FRASCO, CONECTOR,EXTENSAO, DRENO, SUPORTE PARA BASE, ALCA PARA TRANSPORTE, C/TAMPA ROSQUEADA,C/FILTRO,CAPACIDADE 500ML,COM GRADUACAO INDELEVELA CADA 50ML, PINÇA TIPO CLAMP C/TRAVA DE SEGURANCA, CONECTOR UNIVERSAL;EXTENSAO EM MATERIAL TRANSLUCIDO,MEDINDO 1,20CM, DRENO EM PVC, CAL.22FR, FLEXIVEL,RADIOPACO, MULTIPERFURADO, MEDINDO 40CM DE COMP.(+/- 1,0CM), ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	KIT	CLIMED	5	R\$ 112,50	R\$ 562,50
24	22	KIT PARA DRENAGEM DE TORAX COMPOSTO DE FRASCO, CONECTOR, EXTENSAO,DRENO, SUPORTE PARA BASE, ALCA PARA TRANSPORTE, C/TAMPA ROSQUEADA ,C/FILTRO,CAPACIDADE 1000ML, C/GRADUACAO INDELEVEL, PINÇA TIPO CLAMP, C/TRAVA DE SEGURANCA UNIVERSAL,EXTENSAO EM MATERIAL TRANSLUCIDO, MEDIN, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M, DRENO EM SILICONE CALIBRE 26F, FLEXIVEL, RADIOPACO, MULTIPERFURADO, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO,COM DATA DE VALIDADE SUPERIOR A 2 ANOS, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	KIT	CLIMED	5	R\$ 125,49	R\$ 627,45
						VALOR TOTAL DO LOTE	R\$ 47.357,85
						quarenta e sete mil, trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos	
						VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$ 47.357,85
						quarenta e sete mil, trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos	

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: 05 (cinco) dias corridos

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

[Assinaturas e rubricas]

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). Rubrica

[Handwritten signature]

13/02/2023

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Assinatura]
Rubrica

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM/CE.
A/C DA PREGOEIRA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, MARIA VANESSA LOURENÇO MENESES.
REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2701.01/2023-SMS/SRP/PE
DATA E HORA DA ABERTURA: 13 DE FEVEREIRO DE 2023 ÀS 08:30H.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CEARÁ.

PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 26 - MATERIAL DE URGÊNCIA E IMOBILIZAÇÃO I (PERMANENTE)											
ITEM	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	REGISTRO ANVISA	HOSPITAL	AT. BÁSICA	QUANT.	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
1	UNID	MANOMETRO C/ VALVULA P/ CILINDRO DE OXIGENIO C/200 LIBRAS	ROMED	81284390014	20	10	30	R\$ 322,00	trezentos e vinte e dois reais	R\$ 9.660,00	nove mil, seiscentos e sessenta reais
2	KIT	KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO COM 6 LÂMINAS CURVA, CABO PARA LARINGOSCÓPIO MÉDIO, TAMPAS DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS DE PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO. SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPAS DE CARREGAMENTO ABERTA, ACABAMENTO ESTRIADO, TAMANHO MÉDIO, COM LÂMINA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL CURVA, TAMANHOS DE 0 ATÉ 5, LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL, AS ARESTAS ARREDONDADAS DALÂMINA - AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134°C. ACOMPANHA LÂMPADA.	MD	80070210014	10	10	20	R\$ 886,76	oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos	R\$ 17.735,20	dezessete mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte centavos
3	UNID	MACA DOBRÁVEL PORTÁTIL SEM ORIFÍCIO	QUALITY	RDC 185/2001	1	14	15	R\$ 740,88	setecentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos	R\$ 11.113,20	onze mil, cento e treze reais e vinte centavos
4	UNID	MACA SEM RODAS PARA AMBULATÓRIO	MODELO MOVEIS	RDC 185/2001	5	30	35	R\$ 654,78	seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos	R\$ 22.917,30	vinete e dois mil, novecentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos
5	KIT	OTOSCÓPIO EQUIPAMENTO PARA EXAME VISUAL DO OUVIDO. OTOSCÓPIO EM FIBRA ÓPTICA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. LÂMPADA ALÓGENA, LENTE DE AUMENTO DE 2.5X E 05 ESPÉCULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO COM DIÂMETROS APROXIMADOS: 2,5MM- 3,0MM- 3,5MM- 4,0MM- 6,0MM. POSSUIR REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE. POSSUIR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL. POSSUIR VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL. ACOMPANHAR LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE. APRESENTAR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL DE TAMANHO MÉDIO PARA PILHAS. POSSUIR LUPA REDONDA. POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ DESEJÁVEL. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS MÉDIAS COMUNS. ACOMPANHA ESTOJO REFORÇADO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, CONTENDO: LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE E 5 (CINCO) ESPÉCULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO. GARANTIA DE 1 ANO. APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA, MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ. SE NÃO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. (COM REGISTRO NA ANVISA)	MD	80070210012	5	13	18	R\$ 462,98	quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos	R\$ 8.333,64	oito mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos
	UNID	VALVULA REDUTORA COM FLUXOMETRO DE OXIGENIO CABO LONGO, ESCALA DE MANOMETRO - VALVULA DE PRESSAO FIXA: 0 A 315 KGf/cm2. VALVULA DE PRESSAO VARIÁVEL: ENTRADA - 0 A 315 KGf/cm2 E SAIDA A 8KGf/cm2. PRESSAO DE TRABALHO - CILINDRO: PRESSAO DO CILINDRO CHEIO: 150 OU 200 KGf/cm2. VALVULA DE PRESSAO FIXA DE: DENTRO DA FAIXA DE 3,5 +/- 0,3 KGf/cm2. VALVULA DE ALVIO (SEGURANCA): 6,5 +/- 0,3 KGf/cm2. VALVULA DE PRESSAO VARIÁVEL: FAIXA DE TRABALHO 0 - 8 KGf/cm2. VALVULA DE ALVIO (SEGURANCA): 9,5 +/- 0,4 K Gf/cm2	ROMED	81284390014	50	10	60	R\$ 364,00	trezentos e sessenta e quatro reais	R\$ 21.840,00	vinete e um mil, oitocentos e quarenta reais
VALOR TOTAL DO LOTE				R\$ 91.599,34		noventa e um mil, quinhentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos					

PRAZO DE ENTREGA: 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DATA DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.
PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAÇÃO QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

DECLARAMOS QUE SOMOS MICROEMPRESA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO 4º DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06.

FORTALEZA/CE, 13 DE FEVEREIRO DE 2023.

[Assinatura]

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM/CE.
 A/C DA PREGOEIRA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, MARIA VANESSA LOURENÇO MENESES.
 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2701.01/2023-SMS/SRP/PE
 DATA E HORA DA ABERTURA: 13 DE FEVEREIRO DE 2023 ÀS 08:30H.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CEARÁ.

LOTE 25 - MATERIAL DE URGÊNCIA E IMOBILIZAÇÃO I (PERMANENTE)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	ANVISA	MARCA	HOSPITAL	AT. BÁSICA	QUANT.	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
1	MANOMETRO C/ VALVULA P/ CILINDRO DE OXIGENIO C/200 LIBRAS	UNID	81284390014	ROMED	20	10	30	R\$ 333,50	trezentos e trinta e três reais e cinquenta centavos	R\$ 10.005,00	dez mil e cinco reais
2	KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO COM 6 LÂMINAS CURVA, CABO PARA LARINGOSCÓPIO MÉDIO, TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS DE PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO. SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA, ACABAMENTO ESTRIADO. TAMANHO MÉDIO, COM LÂMINA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL CURVA, TAMANHOS DE 0 ATÉ 5, LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL, AS ARESTAS ARREDONDADAS DALÂMINA - AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134°C. ACOMPANHA LÂMPADA.	KIT	80070210014	MD	10	10	20	R\$ 918,43	novecentos e dezoito reais e quarenta e três centavos	R\$ 18.368,60	dezoito mil, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos
3	MACA DOBRÁVEL PORTÁTIL SEM ORIFÍCIO	UNID	RDC 185/2001	QUALITY	1	14	15	R\$ 767,34	setecentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos	R\$ 11.510,10	onze mil, quinhentos e dez reais e dez centavos
4	MACA SEM RODAS PARA AMBULATÓRIO	UNID	RDC 185/2001	MODELO MOVEIS	5	30	35	R\$ 678,17	seiscentos e setenta e oito reais e dezessete centavos	R\$ 23.735,95	virte e três mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Rubrica
 906
 1

5	OTOSCÓPIO EQUIPAMENTO PARA EXAME VISUAL DO OUVIDO. OTOSCÓPIO EM FIBRA ÓPTICA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. LÂMPADA ALÓGENA, LENTE DE AUMENTO DE 2.5X E 05 ESPÉCULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO COM DIÂMETROS APROXIMADOS: 2,5MM- 3,0MM-3,5MM-4,0MM- 8,0MM. POSSUIR REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE. POSSUIR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL. POSSUIR VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL. ACOMPANHAR LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE. APRESENTAR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL DE TAMANHO MÉDIO PARA PILHAS. POSSUIR LUPA REDONDA. POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ DESEJÁVEL. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS MÉDIAS COMUNS. ACOMPANHA ESTOJO REFORÇADO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, CONTENDO: LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE E 5 (CINCO) ESPÉCULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO. GARANTIA DE 1 ANO. APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA, MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO HOVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. (COM REGISTRO NA ANVISA)	KIT	80070210012	MD	5	13	18	R\$ 479,52	quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 8.631,36	oito mil, seiscentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos
6	VALVULA REDUTORA COM FLUXOMETRO DE OXIGENIO CABO LONGO, ESCALA DE MANOMETRO - VALVULA DE PRESSAO FIXA: 0 A 315 KGF/CM2. VALVULA DE PRESSAO VARIÁVEL: ENTRADA - 0 A 315 KGF/CM2 E SAIDA A 8KGF/CM2. PRESSAO DE TRABALHO - CILINDRO: PRESSAO DO CILINDRO CHEIO: 150 OU 200 KGF/CM2. VALVULA DE PRESSAO FIXA DE: DENTRO DA FAIXA DE 3,5 +/- 0,3 KGF/CM2. VALVULA DE ALIVIO (SEGURANCA): 6,5 +/- 0,3 KGF/CM2. VALVULA DE PRESSAO VARIÁVEL: FAIXA DE TRABALHO 0 - 8 KGF/CM2. VALVULA DE ALIVIO (SEGURANCA): 9,5 +/- 0,4 K GF/CM2	UNID	81284390014	ROMED	50	10	60	R\$ 377,00	trezentos e setenta e sete reais	R\$ 22.620,00	vinte e dois mil, seiscentos e vinte reais
VALOR TOTAL DO LOTE		R\$ 94.871,01									
		noventa e quatro mil, oitocentos e setenta e um reais e um centavo									

PRAZO DE ENTREGA: 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DATA DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.
 PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).
 DECLARAÇÃO QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

FORTALEZA/CE, 13 DE FEVEREIRO DE 2023.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 008
 2
 RUDINEIA

[Handwritten signatures and marks]

Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM
FORTIM/CE

PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2701.01/2023 - SMS/SRP/PE

ABERTURA: 13/02/2023

HORÁRIO: 08:30

Prezados Senhores,
Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Pregão Eletrônico, que integram o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.
Declaramos:
Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens
Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de Tributação de Empresa de Pequeno Porte conforme estabelece Artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 25

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa nº	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
01	30	UND	MANOMETRO C/ VALVULA P/ CILINDRO DE OXIGÊNIO C/200 LIBRAS	JG MORIYA/ JG MORIYA REP. IMP. EXP. COM. LTDA/ 200.410/ 10349590139	400,00	12.000,00
02	20	UND	KIT LARINGOSCOPIO COMPLETO COM 6 LÂMINAS CURVA, CABO PARA LARINGOSCOPIO MÉDIO, TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS DE PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO, SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA, ACABAMENTO ESTRIADO, TAMANHO MÉDIO, COM LÂMINA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL CURVA, TAMANHOS DE 0 ATÉ 5, LÂMINA DE LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL, AS ARESTAS ARREDONDADAS DA LÂMINA - AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134°C. ACOMPANHA LÂMPADA.	HAYMED/ HAY MED INST. - PAQUISTÃO/ CONVENCIONAL/ 10349590155	2.000,00	40.000,00

me

X

Exp

[Handwritten Signature]
 Rubrica

03	15	UND	MACA DOBRAVEL PORTÁTIL SEM ORIFÍCIO	BÁSICO/ BÁSICO DESIGNER/ BÁSICO/ ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA	1.000,00	15.000,00
04	35	UND	MACA SEM RODAS PARA AMBULATÓRIO	METALIC/ Metalic Medical Prod. Hosp. Ltda. - EPP/ MT300/ 8088397003	900,00	31.500,00
05	18	UND	OTOSCÓPIO EQUIPAMENTO PARA EXAME VISUAL DO OUVIDO. OTOSCÓPIO EM FIBRA ÓPTICA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. LÂMPADA ALÓGENA, LENTE DE AUMENTO DE 2.5X E 05 ESPÉCULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO COM DIÂMETROS APROXIMADOS: 2,5MM- 3,0MM-3,5MM-4,0MM-8,0MM. POSSUIR REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE. POSSUIR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL. POSSUIR VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL. ACOMPANHAR LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE.	DNS/ DAD&SONS SURGICAL IND. - PAQUISTÃO/ DNS-1003/ 8196554001	800,00	14.400,00
			APRESENTAR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL DE TAMANHO MÉDIO PARA PILHAS. POSSUIR LUPA REDONDA. POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ DESEJÁVEL. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS MÉDIAS COMUNS. ACOMPANHA ESTOJO REFORÇADO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, CONTENDO: LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE E 5 (CINCO) ESPÉCULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO. GARANTIA DE 1 ANO. APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA, MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. (COM REGISTRO NA ANVISA)			

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
 Rubrica

06	60	UND	VÁLVULA REDUTORA COM FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO CABO LONGO, ESCALA DE MANÔMETRO - VÁLVULA DE PRESSÃO FIXA: 0 A 315 KGF/CM2. VÁLVULA DE PRESSÃO VARIÁVEL: ENTRADA - 0 A 315 KGF/CM2 E SAÍDA A 8KGF/CM2. PRESSÃO DE TRABALHO - CILINDRO: PRESSÃO DO CILINDRO CHEIO: 150 OU 200 KGF/CM2. VÁLVULA DE PRESSÃO FIXA DE: DENTRO DA FAIXA DE 3,5 +/- 0,3 KGF/CM2. VÁLVULA DE ALIVIO (SEGURANÇA): 6,5 +/- 0,3 KGF/CM2. VÁLVULA DE PRESSÃO VARIÁVEL: FAIXA DE TRABALHO 0 - 8 KGF/CM2. VÁLVULA DE ALIVIO (SEGURANÇA): 9,5 +/- 0,4 KGF/CM2	JG MORIYA/ JG MORIYA REP. IMP.EXP. COM. LTDA/ 200.413/ 10349590139	400,00	24.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE POR EXTENSO: cento e trinta e seis mil e novecentos reais					TOTAL	136.900,00

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Faturamento Mínimo R\$1.000,00 (mil reais)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: cento e trinta e seis mil e novecentos reais	TOTAL	136.900,00
--	-------	------------

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital

DECLARA, que:

- cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possuo 08 (oito) funcionários em minha empresa.

Pinhais, 13 de fevereiro de 2023.

Me
Rúbrica

FORTALEZA-CE, 13 DE FEVEREIRO 2023.

AO GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM/CE
ATT.: AO PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: PROPOSTA DE PREÇO

PREZADOS SENHORES;

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2701.01/2023, REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CEARÁ.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2701.01/2023 DATA DE ABERTURA 13 DE FEVEREIRO AS 10:30HRS.

PREZADOS SENHORES,

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 25 - MATERIAL DE URGÊNCIA E IMOBILIZAÇÃO I (PERMANENTE)											
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD. HOSPITAL	QTD. ATENÇÃO BÁSICA	QTD TOTAL	MARCA	V. UNITÁRIO	-	V. TOTAL		
1	MANOMETRO C/ VALVULA P/ CILINDRO DE OXIGENIO C/200 LIBRAS	Unidade	20	10	30	PROTEC	R\$ 634,20	seiscentos e trinta e quatro reais e vinte centavos	R\$ 19.026,00	dezenove mil e vinte e seis reais	
2	KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO COM 6 LÂMINAS CURVA, CABO PARA LARINGOSCÓPIO MÉDIO, TAMPAS DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS DE PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO, SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPAS DE CARREGAMENTO ABERTA, ACABAMENTO ESTRIBADO.	KIT	10	10	20	MISSOURI	R\$ 1.233,33	mil duzentos e trinta e três reais e trinta e três centavos	R\$ 24.666,60	vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos	
3	MACA DOBRÁVEL PORTÁTIL SEM ORIFÍCIO	Unidade	1	14	15	MODELO MOVEIS	R\$ 2.040,00	dois mil e quarenta reais	R\$ 30.600,00	trinta mil e seiscentos reais	
4	MACA SEM RODAS PARA AMBULATÓRIO	Unidade	5	30	35	MODELO MOVEIS	R\$ 1.560,00	mil quinhentos e sessenta reais	R\$ 54.600,00	quatro mil e seiscentos reais	
5	OTOSCÓPIO EQUIPAMENTO PARA EXAME VISUAL DO OUVIDO. OTOSCÓPIO EM FIBRA ÓPTICA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. LÂMPADA ALÓGENA, LENTE DE AUMENTO DE 2.5X E OS ESPÉCULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO COM DIÂMETROS APROXIMADOS: 2,5MM- 3,0MM-3,5MM-4,0MM- 8,0MM. POSSUIR REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E	Unidade	5	13	18	MD	R\$ 767,34	setecentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos	R\$ 13.812,12	treze mil, oitocentos e doze reais e doze centavos	
6	VÁLVULA REDUTORA COM FLUXOMETRO DE OXIGENIO CABO LONGO, ESCALA DE MANÔMETRO - VÁLVULA DE PRESSÃO FIXA: 0 A 315 KGf/CM2. VÁLVULA DE PRESSÃO VARIÁVEL: ENTRADA - 0 A 315 KGf/CM2 E SAÍDA A 8KGf/CM2. PRESSÃO DE TRABALHO - CILINDRO: PRESSÃO DO CILINDRO CHEIO: 150 OU 200 KGf/CM2. VÁLVULA DE PRESSÃO FIXA DE	Unidade	50	10	60	PROTEC	R\$ 634,20	seiscentos e trinta e quatro reais e vinte centavos	R\$ 38.052,00	trinta e oito mil e cinquenta e dois reais	
LOTE 25									R\$	180.756,72	
cento e oitenta mil, setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos											

VALOR TOTAL DOS LOTES	R\$	180.756,72
cento e oitenta mil, setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NOS PREÇOS OFERECIDOS ESTAO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO, TRIBUTOS, DESLOCAMENTO DE PESSOAL E DEMAIS ONUS PERTINENTES A CONTRATAÇÃO.

DECLARAMOS AINDA QUE, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA ENTREGA DOS PRODUTOS, E QUE SERAO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICIA E CONTRATUAL, E QUE SERAO INICIADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À EPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXO

DECLARAMOS QUE NOS VALORES APRESENTADOS EM NOSSA PROPOSTA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, SEGUROS, DESLOCAMENTO DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

FORTALEZA/CE, 13 DE FEVEREIRO DE 2023.

Me

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Assinatura]
Rubrica

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2701.01/2023-SMS/SRP

DISPUTA DE LANCES: 13/02/2023 ÀS 10H30

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CEARÁ.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 26 - INSUMOS I							
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTDE	VL.UNIT.	VL.TOTAL
26	1	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X4,5MM -UND	UND	SR	46000	R\$ 0,27	R\$ 12.420,00
26	2	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X0,55MM -UND	UND	SR	6000	R\$ 0,27	R\$ 1.620,00
26	3	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,7MM-UND	UND	SR	44000	R\$ 0,27	R\$ 11.880,00
26	4	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,8MM -UNID	UND	SR	50000	R\$ 0,27	R\$ 13.500,00
26	5	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X 0,7MM - UNID	UND	SR	50000	R\$ 0,27	R\$ 13.500,00
26	6	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,8MM-UNID	UND	SR	50000	R\$ 0,27	R\$ 13.500,00
26	7	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12MM-UND	UND	SR	56000	R\$ 0,30	R\$ 16.800,00
26	8	SERINGA DESCARTAVEL 01ML C/AGULHA 13X4,5 MM - UND	UND	DESCARPACK	30000	R\$ 0,87	R\$ 26.100,00
26	9	SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/AGULHA - UNID	UND	SR	28000	R\$ 0,51	R\$ 14.280,00
26	10	SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/AGULHA - UNID	UND	SR	38000	R\$ 0,54	R\$ 20.520,00
26	11	SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/AGULHA - UNID	UND	SR	38000	R\$ 1,11	R\$ 42.180,00
26	12	SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/AGULHA - UNID	UND	DESCARPACK	46000	R\$ 1,86	R\$ 85.560,00
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$ 271.860,00
duzentos e setenta e um mil, oitocentos e sessenta reais							
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							R\$ 271.860,00
duzentos e setenta e um mil, oitocentos e sessenta reais							

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: 05 (cinco) dias corridos

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

13/02/2023

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]
Rubrica

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM/CE.
A/C DA PREGOEIRA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, MARIA VANESSA LOURENÇO MENESES.
REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2701.01/2023-SMS/SRP/PE
DATA E HORA DA ABERTURA: 13 DE FEVEREIRO DE 2023 ÀS 08:30H.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CEARÁ.

PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 26 - INSUMOS I											
ITEM	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	REGISTRO ANVISA	HOSPITAL	AT. BÁSICA	QUANT.	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
1	UNID	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X4,5MM-UND	DESCARPACK	10330669063	20000	26000	46000	R\$ 0,10	dez centavos de real	R\$ 4.600,00	quatro mil e seiscentos reais
2	UNID	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X0,55MM-UND	DESCARPACK	10330669063	0	6000	6000	R\$ 0,10	dez centavos de real	R\$ 600,00	seiscentos reais
3	UNID	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,7MM-UND	DESCARPACK	10330669063	24000	20000	44000	R\$ 0,10	dez centavos de real	R\$ 4.400,00	quatro mil e quatrocentos reais
4	UNID	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,8MM-UND	DESCARPACK	10330669063	30000	20000	50000	R\$ 0,10	dez centavos de real	R\$ 5.000,00	cinco mil reais
5	UNID	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X 0,7MM-UND	DESCARPACK	10330669063	30000	20000	50000	R\$ 0,10	dez centavos de real	R\$ 5.000,00	cinco mil reais
6	UNID	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,8MM-UND	DESCARPACK	10330669063	30000	20000	50000	R\$ 0,10	dez centavos de real	R\$ 5.000,00	cinco mil reais
7	UNID	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12MM-UND	DESCARPACK	10330669063	36000	20000	56000	R\$ 0,11	onze centavos de real	R\$ 6.160,00	seis mil, cento e sessenta reais
8	UNID	SERINGA DESCARTAVEL 01ML C/AGULHA 13X4,5MM-UND	DESCARPACK	10330660046	12000	18000	30000	R\$ 0,27	vinete e sete centavos de real	R\$ 8.100,00	oito mil e cem reais
	UNID	SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA-UND	DESCARPACK	10330660103	20000	8000	28000	R\$ 0,18	dezoito centavos de real	R\$ 5.040,00	cinco mil e quarenta reais
10	UNID	SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/AGULHA-UND	DESCARPACK	10330660103	30000	8000	38000	R\$ 0,21	vinete e um centavos de real	R\$ 7.980,00	sete mil, novecentos e oitenta reais
11	UNID	SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA-UND	DESCARPACK	10330660103	30000	8000	38000	R\$ 0,38	trinta e oito centavos de real	R\$ 14.440,00	quatorze mil, quatrocentos e quarenta reais
12	UNID	SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/AGULHA-UND	DESCARPACK	10330660103	36000	10000	46000	R\$ 0,62	sessenta e dois centavos de real	R\$ 28.520,00	vinete e oito mil, quinhentos e vinte reais
VALOR TOTAL DO LOTE				R\$ 94.840,00		noventa e quatro mil, oitocentos e quarenta reais					

PRAZO DE ENTREGA: 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DATA DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.
PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAÇÃO QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

DECLARAMOS QUE SOMOS MICROEMPRESA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO 4º DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06.

FORTALEZA/CE, 13 DE FEVEREIRO DE 2023.

[Assinaturas manuscritas]

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM/CE.

A/C DA PREGOEIRA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, MARIA VANESSA LOURENÇO MENESES.

REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2701.01/2023-SMS/SRP/PE

DATA E HORA DA ABERTURA: 13 DE FEVEREIRO DE 2023 ÀS 08:30H.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CEARÁ.

LOTE 28 - INSUMOS I											
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	ANVISA	MARCA	HOSPITAL	AT. BÁSICA	QUANT.	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
1	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X4,5MM-UND	UNID	10330669063	DESCARPACK	20000	26000	46000	R\$ 0,10	dez centavos de real	R\$ 4.600,00	quatro mil e seiscentos reais
2	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X0,55MM-UND	UNID	10330669063	DESCARPACK	0	6000	6000	R\$ 0,10	dez centavos de real	R\$ 600,00	seiscentos reais
3	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,7MM-UND	UNID	10330669063	DESCARPACK	24000	20000	44000	R\$ 0,10	dez centavos de real	R\$ 4.400,00	quatro mil e quatrocentos reais
4	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,8MM-UND	UNID	10330669063	DESCARPACK	30000	20000	50000	R\$ 0,10	dez centavos de real	R\$ 5.000,00	cinco mil reais
5	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X 0,7MM-UND	UNID	10330669063	DESCARPACK	30000	20000	50000	R\$ 0,10	dez centavos de real	R\$ 5.000,00	cinco mil reais
6	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,8MM-UND	UNID	10330669063	DESCARPACK	30000	20000	50000	R\$ 0,10	dez centavos de real	R\$ 5.000,00	cinco mil reais
7	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12MM-UND	UNID	10330669063	DESCARPACK	36000	20000	56000	R\$ 0,12	doze centavos de real	R\$ 6.720,00	seis mil, setecentos e vinte reais
8	SERINGA DESCARTAVEL 01ML C/AGULHA 13X4,5MM-UND	UNID	10330660046	DESCARPACK	12000	18000	30000	R\$ 0,28	vinte e oito centavos de real	R\$ 8.400,00	oito mil e quatrocentos reais
9	SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA-UND	UNID	10330660103	DESCARPACK	20000	8000	28000	R\$ 0,19	dezenove centavos de real	R\$ 5.320,00	cinco mil, trezentos e vinte reais
10	SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/AGULHA-UND	UNID	10330660103	DESCARPACK	30000	8000	38000	R\$ 0,22	vinte e dois centavos de real	R\$ 8.360,00	oito mil, trezentos e sessenta reais
11	SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA-UND	UNID	10330660103	DESCARPACK	30000	8000	38000	R\$ 0,39	trinta e nove centavos de real	R\$ 14.820,00	quatorze mil, oitocentos e vinte reais
12	SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/AGULHA-UND	UNID	10330660103	DESCARPACK	36000	10000	46000	R\$ 0,64	sessenta e quatro centavos de real	R\$ 29.440,00	vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta reais
VALOR TOTAL DO LOTE									R\$ 97.660,00		
									noventa e sete mil, seiscentos e sessenta reais		

PRAZO DE ENTREGA: 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DATA DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAÇÃO QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

FORTALEZA/CE, 13 DE FEVEREIRO DE 2023.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FIG. 915
 Rúbrica

Amel
Rúbrica

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM
À CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTIM
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 2701.01/2023
DIA E HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13 DE FEVEREIRO DE 2023 ÀS 08:30H
DIA E HORÁRIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 13 DE FEVEREIRO DE 2023 ÀS 10H30

At. Sr.(a) Pregoeiro (a)

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta de Escrita, relativa ao objeto do referido pregão, bem como as informações especificações e as condições abaixo discriminadas

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CEARÁ.

PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 28								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUAND	MARCA	V. UNITÁRIO	EXTENSO UNITÁRIO	V. TOTAL	EXTENSO TOTAL
1	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X4,5MM -UND	UNIDADE	46.000	DESCARPACK	R\$ 0,12	doze centavos de real	R\$ 5.520,00	cinco mil, quinhentos e vinte reais
2	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X0,55MM -UND	UNIDADE	6.000	SOLIDOR	R\$ 0,11	onze centavos de real	R\$ 660,00	seiscentos e sessenta reais
3	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,7MM-UND	UNIDADE	44.000	SOLIDOR	R\$ 0,12	doze centavos de real	R\$ 5.280,00	cinco mil, duzentos e oitenta reais
4	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,8MM -UNID	UNIDADE	50.000	SOLIDOR	R\$ 0,12	doze centavos de real	R\$ 6.000,00	seis mil reais
5	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X 0,7MM - UNID	UNIDADE	50.000	SOLIDOR	R\$ 0,12	doze centavos de real	R\$ 6.000,00	seis mil reais
6	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,8MM-UNID	UNIDADE	50.000	DESCARPACK	R\$ 0,12	doze centavos de real	R\$ 6.000,00	seis mil reais
7	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12MM-UND	UNIDADE	56.000	DESCARPACK	R\$ 0,14	quatorze centavos de real	R\$ 7.840,00	sete mil, oitocentos e quarenta reais
8	SERINGA DESCARTÁVEL 01ML C/AGULHA 13X4,5 MM - UNID	UNIDADE	30.000	SR	R\$ 0,36	trinta e seis centavos de real	R\$ 10.800,00	dez mil e oitocentos reais
9	SERINGA DESCARTÁVEL 03ML S/AGULHA - UNID	UNIDADE	28.000	SR	R\$ 0,26	vinte e seis centavos de real	R\$ 7.280,00	sete mil, duzentos e oitenta reais
10	SERINGA DESCARTÁVEL 05ML S/AGULHA - UNID	UNIDADE	38.000	SR	R\$ 0,26	vinte e seis centavos de real	R\$ 9.880,00	nove mil, oitocentos e oitenta reais
11	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML S/AGULHA - UNID	UNIDADE	38.000	SR	R\$ 0,48	quarenta e oito centavos de real	R\$ 18.240,00	dezoito mil, duzentos e quarenta reais
12	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML S/AGULHA - UNID	UNIDADE	46.000	SR	R\$ 0,74	setenta e quatro centavos de real	R\$ 34.040,00	trinta e quatro mil e quarenta reais
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$ 117.540,00	
cento e dezessete mil, quinhentos e quarenta reais								

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação que nosso Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do Edital, supracitado e seus anexos.

Declaramos que objeto cotado atende todas as exigências do edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Outrossim declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços da proposta inicial, digital ou anexa, ou ofertados por meio de lances, estão inclusos todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos, sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas fretes, seguros deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive margem de lucro.

Caso nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

a) Validade da proposta: 60 (SESSENTA) dias, contados da sessão de abertura das propostas;

b) Prazo de entrega: 05 (CINCO) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Compra.

10 de Fevereiro de 2023.

me
[Handwritten signatures]

Prefeitura Municipal de Fortim - Ce
R Vila da Paz, Bloco D, Centro, 40 - Fortim-CE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM CEARÁ

19137793/001
Pregão Eletrônico Aberto Nº 2701.01/2023
Processo 2701.01/2023
Abertura 13/02/2023 Hora 10:30

10 de fevereiro de 2023

				Total(R\$): 123.800,0000		
Item	Und	Qtde	Descrição	Marca	Vir.Unit.	Total
01	Un	46000	AGULHA HIPODERMICA DESC 13X4.5 CX C/100 Registro M.S: 0010369460030 Procedência: Mercadoria Nacional (Hum Mil, Duzentos Décimos de Milésimo de Real) (Cinco Mil, Quinhentos e Vinte Reais)	LABOR IMPORT (SP)	0,1200	5.520,0000
02	UND	6000	AGULHA HIPODERMICA DESC 20X5.5 CX C/100 Registro M.S: 0800261800009 Procedência: Mercadoria Nacional (Hum Mil, Duzentos Décimos de Milésimo de Real) (Setecentos e Vinte Reais)	SR (AM)	0,1200	720,0000
03	UND	44000	AGULHA HIPODERMICA DESC 25X7.0 CX C/100 Registro M.S: 0080026180031 Procedência: Mercadoria Nacional (Hum Mil, Duzentos Décimos de Milésimo de Real) (Cinco Mil, Duzentos e Oitenta Reais)	SR (AM)	0,1200	5.280,0000
04	UND	50000	AGULHA HIPODERMICA DESC 25X8.0 CX C/100 Registro M.S: 0080026180031 Procedência: Mercadoria Nacional (Hum Mil, Duzentos Décimos de Milésimo de Real) (Seis Mil Reais)	SR (AM)	0,1200	6.000,0000
05	UND	50000	AGULHA HIPODERMICA DESC 30X7.0 CX C/100 Registro M.S: 0080026180031 Procedência: Mercadoria Nacional (Hum Mil, Duzentos Décimos de Milésimo de Real) (Seis Mil Reais)	SR (AM)	0,1200	6.000,0000
06	UND	50000	AGULHA HIPODERMICA DESC 30X8,0 Registro M.S: 0080026180031 Procedência: Mercadoria Nacional (Hum Mil, Quatrocentos Décimos de Milésimo de Real) (Sete Mil Reais)	SR	0,1400	7.000,0000
07	UND	56000	AGULHA HIPODERMICA DESC 40X12 Registro M.S: 0080026180031 Procedência: Mercadoria Nacional (Hum Mil, Trezentos Décimos de Milésimo de Real) (Sete Mil, Duzentos e Oitenta Reais)	SR (AM)	0,1300	7.280,0000

Validade da Proposta Será de 60 dia(s).
Prazo de Entrega CONFORME O EDITAL
Prazo de Pagamento CONFORME O EDITAL

[Handwritten signatures and marks]

Prefeitura Municipal de Fortim - Ce
R Vila da Paz, Bloco D, Centro, 40 - Fortim-CE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM CEARÁ

19137793/002
Pregão Eletrônico Aberto Nº 2701.01/2023
Processo 2701.01/2023
Abertura 13/02/2023 Hora 10:30

10 de fevereiro de 2023

26				Total(R\$): 123.800,0000		
Item	Und	Qtde	Descrição	Marca	Vir.Unit.	Total
08	Un	30000	SERINGA DESC 01ML C/AG 13X4,5 CX C/500 Registro M.S: 0080026180015 Procedência: Mercadoria Nacional (Três Mil, Duzentos Décimos de Milésimo de Real) (Nove Mil, Seiscentos Reais)	SR (AM)	0,3200	9.600,0000
09	Un	28000	SERINGA DESC 03ML S/AG (LUER SLIP) CX C/100 Registro M.S: 0010330660103 Procedência: Mercadoria estrangeira adquirida no mercado nacional (Dois Mil, Oitocentos Décimos de Milésimo de Real) (Sete Mil, Oitocentos e Quarenta Reais)	DESCARPACK (SC)	0,2800	7.840,0000
10	Un	38000	SERINGA DESC 05ML S/AG L.L. CX C/100 Registro M.S: 0010330669025 Procedência: Mercadoria estrangeira adquirida no mercado nacional (Três Mil, Seiscentos Décimos de Milésimo de Real) (Treze Mil, Seiscentos e Oitenta Reais)	DESCARPACK (SC)	0,3600	13.680,0000
11	Un	38000	SERINGA DESC 10ML S/AG L.LOCK S/TRAV CX C/100 Registro M.S: 0010330669025 Procedência: Mercadoria estrangeira adquirida no mercado nacional (Cinco Mil Décimos de Milésimo de Real) (Dezenove Mil Reais)	DESCARPACK (SC)	0,5000	19.000,0000
12	Un	46000	SERINGA DESC 20ML S/AG L.L CX C/50 Registro M.S: 1033066010300 Procedência: Mercadoria Nacional (Sete Mil, Oitocentos Décimos de Milésimo de Real) (Trinta e Cinco Mil, Oitocentos e Oitenta Reais)	DESCARPACK (SC)	0,7800	35.880,0000

Validade da Proposta: Será de 60 dia(s).
Prazo de Entrega: CONFORME O EDITAL
Prazo de Pagamento: CONFORME O EDITAL

[Handwritten signatures and marks]

Prefeitura Municipal de Fortim - Ce
R Vila da Paz, Bloco D, Centro, 40 - Fortim-CE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM CEARÁ

19137793/3
Pregão Eletrônico Aberto Nº 2701.01/2023
Processo 2701.01/2023
Abertura 13/02/2023 Hora 10:30

10 de fevereiro de 2023

Item	Und	Qtde	Descrição	Marca	Vir.Unit.	Total
Total(R\$):						
Validade da Proposta			Será de 60 dia(s).			
Prazo de Entrega			CONFORME O EDITAL			
Forma de Pagamento			CONFORME O EDITAL			
Valor Global da Proposta			123.800.0000 (Cento e Vinte e Três Mil, Oitocentos Reais)			
Observação			AQUISIÇÃO DE MEDIC. E MATERIAL. (BBM NET)			
Prazo de Vigência do Contrato			O período de vigência deste contrato será de 12 meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado observando os parâmetros da lei.			
Da Declaração			Declara para os devidos fins que, no preço proposto estão inclusos todos os encargos (obrigações sociais, impostos, despesas de frete, materiais, mão-de-obra, taxas, etc) e despesas necessárias à entrega do objeto da licitação, bem como declara ainda que, atende, tem conhecimento, e cumpre com todas as especificações exigidas neste edital. Declara que todas as providências para entrega ou substituição dos objetos serão adotadas, no prazo máximo de 02 dias úteis, contado a partir da data da notificação pelo responsável do órgão / entidade demandante. Declara também, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.			

M

SP

SP

NOME DO ORGÃO/MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM/CE	SETOR DE LICITAÇÃO
Nº DO PREGÃO: 2701.01/23-SMS/2023	PREGÃO: ELETRÔNICO/MENOR PREÇO LOTE

ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, SUBSIDIADA PELA LEI Nº 8.666/93 E SUA POSTEIORES ALTERAÇÕES E, AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE PREGÃO.

DECLARAMOS QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO E E NOS COMPROMETEMOS A FORNECER INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOLICITADAS PELO PREGOEIRO.

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTAMOS ENQUADRADOS COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E NÃO ESTÁ SUJEITA A QUAISQUER DOS IMPEDIMENTOS DO § 4º DESTE ARTIGO, ESTANDO APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ESTABELECIDO NOS ART. 42 A 49 DA MENCIONADA LEI, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014

DECLARAMOS QUE NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTAO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHITAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO DO OBJETO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO E QUE CUMPRE TAMBEM A TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.

DECLARAMOS AINDA QUE, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAS, OBJETO DESSE EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGENCIA EDITALICIA E CONTRATUAL E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE A CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM CEARÁ.

LOTE 26 - INSUMOS I

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	MARCA	V.UNIT	V.TOTAL
1	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X4,5MM -UND	Unidade	46000	SR	R\$ 0,16	R\$ 7.360,00
2	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X0,55MM -UND	Unidade	6000	SR	R\$ 0,16	R\$ 960,00
3	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,7MM-UND	Unidade	44000	SR	R\$ 0,16	R\$ 7.040,00
4	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,8MM -UNID	Unidade	50000	SR	R\$ 0,16	R\$ 8.000,00
5	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X 0,7MM - UNID	Unidade	50000	SR	R\$ 0,16	R\$ 8.000,00
6	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,8MM-UNID	Unidade	50000	SR	R\$ 0,16	R\$ 8.000,00
7	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12MM-UND	Unidade	56000	SR	R\$ 0,16	R\$ 8.960,00
8	SERINGA DESCARTÁVEL 01ML C/AGULHA 13X4,5 MM - UNID	Unidade	30000	SR	R\$ 0,42	R\$ 12.600,00
9	SERINGA DESCARTÁVEL 03ML S/AGULHA - UNID	Unidade	28000	BIOMASS	R\$ 0,28	R\$ 7.840,00
10	SERINGA DESCARTÁVEL 05ML S/AGULHA - UNID	Unidade	38000	BIOMASS	R\$ 0,32	R\$ 12.160,00
11	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML S/AGULHA - UNID	Unidade	38000	BIOMASS	R\$ 0,60	R\$ 22.800,00
12	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML S/AGULHA - UNID	Unidade	46000	BIOMASS	R\$ 0,90	R\$ 41.400,00
VALOR TOTAL LOTE 26					R\$ 145.120,00	

cento e quarenta e cinco mil, cento e vinte reais

PRAZO DE ENTREGA: 5 (CINCO) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

13 DE FEVEREIRO DE 2023

98

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ao
Pregoeiro (a) da Prefeitura Municipal de Fortim – Ce.
Pregão Eletrônico Nº 2701.01/2023- SMS/SRP/PE

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGAO ELETRÔNICO Nº 2701.01/2023- SMS/SRP/PE, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CEARÁ

Senhor (a) Pregoeiro (a) apresentamos nossa Proposta de Preços referente ao objeto do pregão acima epigrafado:

LOTE 26 - INSUMOS I									
ITEM	DESCRIÇÃO	REG.ANVISA	MARCA	UNIDADE	QUANT.	V. UNIT	V. U. EXT.	V. TOTAL	V. T. EXT.
1	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X4,5MM -UND	80495510095	MEDIX	UNID	46.000	R\$ 0,20	vingte centavos de real	R\$ 9.200,00	nove mil e duzentos reais
2	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X0,55MM -UND	80495510095	MEDIX	UNID	6.000	R\$ 0,20	vingte centavos de real	R\$ 1.200,00	mil e duzentos reais
3	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25X0,7MM -UND	80495510095	MEDIX	UNID	44.000	R\$ 0,20	vingte centavos de real	R\$ 8.800,00	oito mil e oitocentos reais
4	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25X0,8MM - UNID	80495510095	MEDIX	UNID	50.000	R\$ 0,20	vingte centavos de real	R\$ 10.000,00	dez mil reais
5	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30X 0,7MM - UNID	80495510095	MEDIX	UNID	50.000	R\$ 0,20	vingte centavos de real	R\$ 10.000,00	dez mil reais
6	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30X0,8MM -UNID	80495510095	MEDIX	UNID	50.000	R\$ 0,20	vingte centavos de real	R\$ 10.000,00	dez mil reais
7	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40X12MMUND	80495510095	MEDIX	UNID	56.000	R\$ 0,23	vingte e três centavos de real	R\$ 12.880,00	doze mil, oitocentos e oitenta reais
8	SERINGA DESCARTÁVEL 01 ML C/AGULHA 13X4,5 MM - UND	80518310028	DESCAPACK	UNID	30.000	R\$ 0,63	sessenta e três centavos de real	R\$ 18.900,00	dezoito mil e novecentos reais
9	SERINGA DESCARTÁVEL 03ML S/AGULHA - UNID	80495519004	MEDIX	UNID	28.000	R\$ 0,43	quarenta e três centavos de real	R\$ 12.040,00	doze mil e quarenta reais
10	SERINGA DESCARTÁVEL 05ML S/AGULHA - UNID	80495519004	MEDIX	UNID	38.000	R\$ 0,50	cinquenta centavos de real	R\$ 19.000,00	dezenove mil reais
11	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML S/AGULHA - UNID	80495519004	MEDIX	UNID	38.000	R\$ 0,75	setenta e cinco centavos de real	R\$ 28.500,00	vingte e oito mil e quinhentos reais
12	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML S/AGULHA - UNID	80495519004	MEDIX	UNID	46.000	R\$ 1,30	um real e trinta centavos	R\$ 59.800,00	cinquenta e nove mil e oitocentos reais
VALOR TOTAL DO LOTE								R\$ 200.320,00	
Duzentos mil, trezentos e vinte reais									

Valor Global da Proposta: **R\$ 10.004.775,80 (dez milhões e quatro mil, setecentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos)**

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias conforme solicitado no Edital.

Prazo de entrega: 5 (cinco) dias após recebimento da Ordem de Compra.

Declaramos, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital)

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela aquisição dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra, e ainda, que nos preços estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do FORNECIMENTO, tais como: todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal,

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 921
RUBRICA

e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto, constantes da proposta, abrangendo, assim, todos os custos com os serviços necessários a execução do objeto em perfeitas condições a manutenção destas condições durante o prazo de contrato.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalíssima e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Compra.

13 de fevereiro de 2023.



FORTALEZA-CE, 13 DE FEVEREIRO 2023.

AO GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM/CE
 ATT.: AO PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 REF.: PROPOSTA DE PREÇO

PREZADOS SENHORES;
 APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2701.01/2023, REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CEARÁ.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2701.01/2023 DATA DE ABERTURA 13 DE FEVEREIRO AS 10:30HRS.

PREZADOS SENHORES,

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 26 - INSUMOS I										
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD. HOSPITAL	QTD. ATENÇÃO BÁSICA	QTD TOTAL	MARCA	V. UNITÁRIO	-	V. TOTAL	-
1	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X4,5MM -UND	Unidade	20000	26000	46000	DESCARPACK	R\$ 0,24	vinte e quatro centavos de real	R\$ 11.040,00	onze mil e quarenta reais
2	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X0,55MM -UND	Unidade		6000	6000	DESCARPACK	R\$ 0,24	vinte e quatro centavos de real	R\$ 1.440,00	mil quatrocentos e quarenta reais
3	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,7MM-UND	Unidade	24000	20000	44000	DESCARPACK	R\$ 0,24	vinte e quatro centavos de real	R\$ 10.560,00	dez mil, quinhentos e sessenta reais
4	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,8MM -UNID	Unidade	30000	20000	50000	DESCARPACK	R\$ 0,24	vinte e quatro centavos de real	R\$ 12.000,00	doze mil reais
5	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X 0,7MM - UNID	Unidade	30000	20000	50000	DESCARPACK	R\$ 0,24	vinte e quatro centavos de real	R\$ 12.000,00	doze mil reais
6	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,8MM-UNID	Unidade	30000	20000	50000	DESCARPACK	R\$ 0,24	vinte e quatro centavos de real	R\$ 12.000,00	doze mil reais
7	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12MM-UND	Unidade	36000	20000	56000	DESCARPACK	R\$ 0,24	vinte e quatro centavos de real	R\$ 13.440,00	treze mil, quatrocentos e quarenta reais
8	SERINGA DESCARTÁVEL 01ML C/AGULHA 13X4,5 MM - UNID	Unidade	12000	18000	30000	SR	R\$ 0,60	sessenta centavos de real	R\$ 18.000,00	dezoito mil reais
9	SERINGA DESCARTÁVEL 03ML S/AGULHA - UNID	Unidade	20000	8000	28000	SR	R\$ 0,69	sessenta e nove centavos de real	R\$ 19.320,00	dezenove mil, trezentos e vinte reais
10	SERINGA DESCARTÁVEL 05ML S/AGULHA - UNID	Unidade	30000	8000	38000	SR	R\$ 0,69	sessenta e nove centavos de real	R\$ 26.220,00	vinte e seis mil, duzentos e vinte reais
11	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML S/AGULHA - UNID	Unidade	30000	8000	38000	SR	R\$ 1,05	um real e cinco centavos	R\$ 39.900,00	trinta e nove mil e novecentos reais
12	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML S/AGULHA - UNID	Unidade	36000	10000	46000	SR	R\$ 1,50	um real e cinquenta centavos	R\$ 69.000,00	sessenta e nove mil reais
LOTE 26									R\$	244.920,00

duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos e vinte reais

VALOR TOTAL DOS LOTES	R\$	244.920,00
duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos e vinte reais		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NOS PREÇOS OFERECIDOS ESTAO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO, TRIBUTOS, DESLOCAMENTO DE PESSOAL E DEMAIS ONUS PERTINENTES A CONTRATAÇÃO.

DECLARAMOS AINDA QUE, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA ENTREGA DOS PRODUTOS, E QUE SERAO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICIA E CONTRATUAL, E QUE SERAO INCIADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À EPECIFICAÇÃO E CARACTERISTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXO

DECLARAMOS QUE NOS VALORES APRESENTADOS EM NOSSA PROPOSTA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, SEGUROS, DESLOCAMENTO DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

FORTALEZA/CE, 13 DE FEVEREIRO DE 2023.

[Assinatura]
Rúbrica

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2701.01/2023-SMS/SRP

DISPUTA DE LANCES: 13/02/2023 ÀS 10H30

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CEARÁ.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 26 - INSUMOS I							
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTDE	VL.UNIT.	VL.TOTAL
26	1	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X4,5MM -UND	UND	SR	46000	R\$ 0,27	R\$ 12.420,00
26	2	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X0,55MM -UND	UND	SR	6000	R\$ 0,27	R\$ 1.620,00
26	3	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,7MM-UND	UND	SR	44000	R\$ 0,27	R\$ 11.880,00
26	4	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,8MM -UNID	UND	SR	50000	R\$ 0,27	R\$ 13.500,00
26	5	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X 0,7MM - UNID	UND	SR	50000	R\$ 0,27	R\$ 13.500,00
26	6	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,8MM-UNID	UND	SR	50000	R\$ 0,27	R\$ 13.500,00
26	7	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12MM-UND	UND	SR	56000	R\$ 0,30	R\$ 16.800,00
26	8	SERINGA DESCARTAVEL 01ML C/AGULHA 13X4,5 MM - UND	UND	DESCARPACK	30000	R\$ 0,87	R\$ 26.100,00
26	9	SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/AGULHA - UNID	UND	SR	28000	R\$ 0,51	R\$ 14.280,00
26	10	SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/AGULHA - UNID	UND	SR	38000	R\$ 0,54	R\$ 20.520,00
26	11	SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/AGULHA - UNID	UND	SR	38000	R\$ 1,11	R\$ 42.180,00
26	12	SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/AGULHA - UNID	UND	DESCARPACK	46000	R\$ 1,86	R\$ 85.560,00
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$ 271.860,00
duzentos e setenta e um mil, oitocentos e sessenta reais							
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							R\$ 271.860,00
duzentos e setenta e um mil, oitocentos e sessenta reais							

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: 05 (cinco) dias corridos

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

13/02/2023

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM/CE.
A/C DA PREGOEIRA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, MARIA VANESSA LOURENÇO MENESES.
REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2701.01/2023-SMS/SRP/PE
DATA E HORA DA ABERTURA: 13 DE FEVEREIRO DE 2023 ÀS 08:30H.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CEARÁ.

PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 27 - INSUMOS II

ITEM	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	REGISTRO ANVISA	HOSPITAL	AT. BÁSICA	QUANT.	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
1	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.04-UND	BIOBASE	80212340033	150	50	200	R\$ 0,63	sessenta e três centavos de real	R\$ 126,00	cento e vinte e seis reais
2	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.06-UND	BIOBASE	80212340033	950	50	1000	R\$ 0,64	sessenta e quatro centavos de real	R\$ 640,00	seiscentos e quarenta reais
3	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.08-UND	BIOBASE	80212340033	250	50	300	R\$ 0,66	sessenta e seis centavos de real	R\$ 198,00	cento e noventa e oito reais
4	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.10-UND	BIOBASE	80212340033	250	50	300	R\$ 0,67	sessenta e sete centavos de real	R\$ 201,00	duzentos e um reais
5	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.12-UND	BIOBASE	80212340033	250	50	300	R\$ 0,70	setenta centavos de real	R\$ 210,00	duzentos e dez reais
6	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.14-UND	BIOBASE	80212340033	250	50	300	R\$ 0,71	setenta e um centavos de real	R\$ 213,00	duzentos e treze reais
7	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.16-UND	BIOBASE	80212340033	250	50	300	R\$ 0,73	setenta e três centavos de real	R\$ 219,00	duzentos e dezoito reais
8	UNID	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.18-UND	BIOBASE	80212340033	250	50	300	R\$ 0,74	setenta e quatro centavos de real	R\$ 222,00	duzentos e vinte e dois reais
9	UNID	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC N. 3,5 (SEM BALÃO) -UND	SOLIDOR	10369460139	20	60	80	R\$ 3,07	três reais e sete centavos	R\$ 245,60	duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos
10	UNID	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC N. 4,0 (SEM BALÃO) -UND	SOLIDOR	10369460139	20	60	80	R\$ 3,21	três reais e vinte e um centavos	R\$ 256,80	duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos
11	UNID	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC N. 5,0 (SEM BALÃO) -UND	SOLIDOR	10369460139	20	60	80	R\$ 3,21	três reais e vinte e um centavos	R\$ 256,80	duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos
12	UNID	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC N. 6,5 (COM BALÃO) - UNID	SOLIDOR	10369460123	100	50	150	R\$ 3,29	três reais e vinte e nove centavos	R\$ 493,50	quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos
13	UNID	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC N. 7,0 (COM BALÃO) -UND	SOLIDOR	10369460123	100	50	150	R\$ 3,22	três reais e vinte e dois centavos	R\$ 483,00	quatrocentos e oitenta e três reais
14	UNID	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC N. 7,5 (COM BALÃO) -UND	SOLIDOR	10369460123	100	350	450	R\$ 3,54	três reais e cinquenta e quatro centavos	R\$ 1.593,00	mil quinhentos e noventa e três reais
15	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.10 - UNID	BIOBASE	80212340034	100	200	300	R\$ 0,67	sessenta e sete centavos de real	R\$ 201,00	duzentos e um reais
16	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.12 - UNID	BIOBASE	80212340034	200	700	900	R\$ 0,69	sessenta e nove centavos de real	R\$ 621,00	seiscentos e vinte e um reais
17	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.14 - UNID	BIOBASE	80212340034	300	200	500	R\$ 0,70	setenta centavos de real	R\$ 350,00	trezentos e cinquenta reais
18	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.16 - UNID	BIOBASE	80212340034	500	100	600	R\$ 0,71	setenta e um centavos de real	R\$ 426,00	quatrocentos e vinte e seis reais
19	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.18- UNID	BIOBASE	80212340034	200	100	300	R\$ 0,73	setenta e três centavos de real	R\$ 219,00	duzentos e dezoito reais
20	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.06 - UNID	BIOBASE	80212340034	100	200	300	R\$ 0,74	setenta e quatro centavos de real	R\$ 222,00	duzentos e vinte e dois reais
21	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.08 - UNID	BIOBASE	80212340034	100	200	300	R\$ 0,76	setenta e seis centavos de real	R\$ 228,00	duzentos e vinte e oito reais
22	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.10 - UNID	BIOBASE	80212340034	100	200	300	R\$ 0,77	setenta e sete centavos de real	R\$ 231,00	duzentos e trinta e um reais
23	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.12 - UNID	BIOBASE	80212340034	100	350	450	R\$ 0,80	oitenta centavos de real	R\$ 360,00	trezentos e sessenta reais
24	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.14 - UNID	BIOBASE	80212340034	400	50	450	R\$ 0,98	noventa e oito centavos de real	R\$ 441,00	quatrocentos e quarenta e um reais
25	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.16 - UNID	BIOBASE	80212340034	400	200	600	R\$ 0,99	noventa e nove centavos de real	R\$ 594,00	quinhentos e noventa e quatro reais
26	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.18 - UNID	BIOBASE	80212340034	400	50	450	R\$ 1,08	um real e oito centavos	R\$ 486,00	quatrocentos e oitenta e seis reais
27	UNID	SONDA URETRAL N.04 - UNID	BIOBASE	80212340035	200	200	400	R\$ 0,63	sessenta e três centavos de real	R\$ 252,00	duzentos e cinquenta e dois reais
28	UNID	SONDA URETRAL N.06 - UNID	BIOBASE	80212340035	200	200	400	R\$ 0,64	sessenta e quatro centavos de real	R\$ 256,00	duzentos e cinquenta e seis reais
29	UNID	SONDA URETRAL N.08 - UNID	BIOBASE	80212340035	200	200	400	R\$ 0,66	sessenta e seis centavos de real	R\$ 264,00	duzentos e sessenta e quatro reais
30	UNID	SONDA URETRAL N.10 - UNID	BIOBASE	80212340035	200	400	600	R\$ 0,67	sessenta e sete centavos de real	R\$ 402,00	quatrocentos e dois reais
31	UNID	SONDA URETRAL N.12 - UNID	BIOBASE	80212340035	200	400	600	R\$ 0,69	sessenta e nove centavos de real	R\$ 414,00	quatrocentos e quatorze reais
32	UNID	SONDA URETRAL N.14 - UNID	BIOBASE	80212340035	400	600	1000	R\$ 0,70	setenta centavos de real	R\$ 700,00	setecentos reais
33	UNID	SONDA URETRAL N.16 - UNID	BIOBASE	80212340035	400	400	800	R\$ 0,71	setenta e um centavos de real	R\$ 568,00	quinhentos e sessenta e oito reais
34	PCT	DRENO DE PENROSE N.02 PACT. C/12UNID	INOVATEX	80950310006	20	0	20	R\$ 24,64	vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 492,80	quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos
35	PCT	DRENO DE PENROSE N.03 PACT. C/12UNID	INOVATEX	80950310006	20	0	20	R\$ 25,90	vinte e cinco reais e noventa centavos	R\$ 518,00	quinhentos e dezoito reais

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten Signature]
Ribeira

36	METRO	LÁTEX PARA ASPIRADOR N.204 EM SILICONE	KINNER	8028020001	200	0	200	R\$ 11,21	onze reais e vinte e um centavos	R\$ 2.242,00	dois mil, duzentos e quarenta e dois reais
37	METRO	LÁTEX PARA GARROTE N° 200 EM SILICONE	LÁTEX BR	10182420010	200	100	300	R\$ 2,25	dois reais e vinte e cinco centavos	R\$ 675,00	seiscentos e setenta e cinco reais
VALOR TOTAL DO LOTE				R\$ 16.520,50				dezesesseis mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta centavos			

PRAZO DE ENTREGA: 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DATA DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.
PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAÇÃO QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

DECLARAMOS QUE SOMOS MICROEMPRESA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO 4º DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06.

FORTALEZA/CE, 13 DE FEVEREIRO DE 2023.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM/CE.
 A/C DA PREGOEIRA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, MARIA VANESSA LOURENÇO MENESES.
 REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2701.01/2023-SMS/SRP/PE
 DATA E HORA DA ABERTURA: 13 DE FEVEREIRO DE 2023 ÀS 08:30H.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CEARÁ.

LOTE 27 - INSUMOS II

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	ANVISA	MARCA	HOSPITAL	AT. BÁSICA	QUANT.	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
1	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.04-UND	UNID	80212340033	BIOBASE	150	50	200	R\$ 0,65	sessenta e cinco centavos de real	R\$ 130,00	cento e trinta reais
2	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.06-UND	UNID	80212340033	BIOBASE	950	50	1000	R\$ 0,67	sessenta e sete centavos de real	R\$ 670,00	seiscentos e setenta reais
3	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.08-UND	UNID	80212340033	BIOBASE	250	50	300	R\$ 0,68	sessenta e oito centavos de real	R\$ 204,00	duzentos e quatro reais
4	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.10-UND	UNID	80212340033	BIOBASE	250	50	300	R\$ 0,70	setenta centavos de real	R\$ 210,00	duzentos e dez reais
5	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.12-UND	UNID	80212340033	BIOBASE	250	50	300	R\$ 0,73	setenta e três centavos de real	R\$ 219,00	duzentos e dezenove reais
6	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.14-UND	UNID	80212340033	BIOBASE	250	50	300	R\$ 0,74	setenta e quatro centavos de real	R\$ 222,00	duzentos e vinte e dois reais
7	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.16-UND	UNID	80212340033	BIOBASE	250	50	300	R\$ 0,75	setenta e cinco centavos de real	R\$ 225,00	duzentos e vinte e cinco reais
8	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.18-UND	UNID	80212340033	BIOBASE	250	50	300	R\$ 0,77	setenta e sete centavos de real	R\$ 231,00	duzentos e trinta e um reais
9	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC N. 3,5 (SEM BALÃO) -UND	UNID	10369460139	SOLIDOR	20	60	80	R\$ 3,18	três reais e dezoito centavos	R\$ 254,40	duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos
10	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC N. 4,0 (SEM BALÃO) -UND	UNID	10369460139	SOLIDOR	20	60	80	R\$ 3,32	três reais e trinta e dois centavos	R\$ 265,60	duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos
11	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC N. 5,0 (SEM BALÃO) -UND	UNID	10369460139	SOLIDOR	20	60	80	R\$ 3,32	três reais e trinta e dois centavos	R\$ 265,60	duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos
12	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC N. 6,5 (COM BALÃO) - UNID	UNID	10369460123	SOLIDOR	100	50	150	R\$ 3,41	três reais e quarenta e um centavos	R\$ 511,50	quinhentos e onze reais e cinquenta centavos
13	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC N. 7,0 (COM BALÃO) -UND	UNID	10369460123	SOLIDOR	100	50	150	R\$ 3,34	três reais e trinta e quatro centavos	R\$ 501,00	quinhentos e um reais
14	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC N. 7,5 (COM BALÃO) -UND	UNID	10369460123	SOLIDOR	100	350	450	R\$ 3,67	três reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.651,50	mil seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos
15	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.10 - UND	UNID	80212340034	BIOBASE	100	200	300	R\$ 0,70	setenta centavos de real	R\$ 210,00	duzentos e dez reais
16	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.12 - UND	UNID	80212340034	BIOBASE	200	700	900	R\$ 0,71	setenta e um centavos de real	R\$ 639,00	seiscentos e trinta e nove reais

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 924
 R. R. R. R. R.
 R. R. R. R. R.

17	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.14 – UND	UNID	80212340034	BIOBASE	300	200	500	R\$ 0,73	setenta e três centavos de real	R\$ 365,00	trezentos e sessenta e cinco reais
18	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.16 – UND	UNID	80212340034	BIOBASE	500	100	600	R\$ 0,74	setenta e quatro centavos de real	R\$ 444,00	quatrocentos e quarenta e quatro reais
19	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.18- UND	UNID	80212340034	BIOBASE	200	100	300	R\$ 0,75	setenta e cinco centavos de real	R\$ 225,00	duzentos e vinte e cinco reais
20	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.06 – UND	UNID	80212340034	BIOBASE	100	200	300	R\$ 0,77	setenta e sete centavos de real	R\$ 231,00	duzentos e trinta e um reais
21	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.08 – UND	UNID	80212340034	BIOBASE	100	200	300	R\$ 0,78	setenta e oito centavos de real	R\$ 234,00	duzentos e trinta e quatro reais
22	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.10 – UND	UNID	80212340034	BIOBASE	100	200	300	R\$ 0,80	oitenta centavos de real	R\$ 240,00	duzentos e quarenta reais
23	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.12 – UND	UNID	80212340034	BIOBASE	100	350	450	R\$ 0,83	oitenta e três centavos de real	R\$ 373,50	trezentos e setenta e três reais e cinquenta centavos
24	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.14 – UND	UNID	80212340034	BIOBASE	400	50	450	R\$ 1,02	um real e dois centavos	R\$ 459,00	quatrocentos e cinquenta e nove reais
25	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.16 – UND	UNID	80212340034	BIOBASE	400	200	600	R\$ 1,03	um real e três centavos	R\$ 618,00	seiscentos e dezoito reais
26	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.18 – UND	UNID	80212340034	BIOBASE	400	50	450	R\$ 1,12	um real e doze centavos	R\$ 504,00	quinhentos e quatro reais
27	SONDA URETRAL N.04 – UND	UNID	80212340035	BIOBASE	200	200	400	R\$ 0,65	sessenta e cinco centavos de real	R\$ 260,00	duzentos e sessenta reais
28	SONDA URETRAL N.06 – UND	UNID	80212340035	BIOBASE	200	200	400	R\$ 0,67	sessenta e sete centavos de real	R\$ 268,00	duzentos e sessenta e oito reais
29	SONDA URETRAL N.08 – UND	UNID	80212340035	BIOBASE	200	200	400	R\$ 0,68	sessenta e oito centavos de real	R\$ 272,00	duzentos e setenta e dois reais
30	SONDA URETRAL N.10 – UND	UNID	80212340035	BIOBASE	200	400	600	R\$ 0,70	setenta centavos de real	R\$ 420,00	quatrocentos e vinte reais
31	SONDA URETRAL N.12 – UND	UNID	80212340035	BIOBASE	200	400	600	R\$ 0,71	setenta e um centavos de real	R\$ 426,00	quatrocentos e vinte e seis reais
32	SONDA URETRAL N.14 – UND	UNID	80212340035	BIOBASE	400	600	1000	R\$ 0,73	setenta e três centavos de real	R\$ 730,00	setecentos e trinta reais
33	SONDA URETRAL N.16 – UND	UNID	80212340035	BIOBASE	400	400	800	R\$ 0,74	setenta e quatro centavos de real	R\$ 592,00	quinhentos e noventa e dois reais
34	DRENO DE PENROSE N.02 PACT. C/12UND	PCT	80950310006	INOVATEX	20	0	20	R\$ 25,52	vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 510,40	quinhentos e dez reais e quarenta centavos
35	DRENO DE PENROSE N.03 PACT. C/12UNID	PCT	80950310006	INOVATEX	20	0	20	R\$ 26,83	vinte e seis reais e oitenta e três centavos	R\$ 536,60	quinhentos e trinta e seis reais e sessenta centavos
36	LÁTEX PARA ASPIRADOR N.204 EM SILICONE	METRO	80280200001	KINNER	200	0	200	R\$ 11,61	onze reais e sessenta e um centavos	R\$ 2.322,00	dois mil, trezentos e vinte e dois reais

COPIA
 Rubrica
 028
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

37	LÁTEX PARA GARROTE N° 200 EM SILICONE	METRO	10182420010	LATEX BR	200	100	300	R\$ 2,33	dois reais e trinta e três centavos	R\$ 699,00	seiscentos e noventa e nove reais
VALOR TOTAL DO LOTE		R\$ 17.139,10 dezessete mil, cento e trinta e nove reais e dez centavos									

PRAZO DE ENTREGA: 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DATA DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.
PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).
DECLARAÇÃO QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

FORTALEZA/CE, 13 DE FEVEREIRO DE 2023.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis. 929
Rubrica

Me
Rubrica

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM
À CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTIM
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 2701.01/2023
DIA E HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13 DE FEVEREIRO DE 2023 ÀS 08:30H
DIA E HORÁRIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANÇES: 13 DE FEVEREIRO DE 2023 ÀS 10H30

At. Sr. (a) Pregoeiro (a)

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta de Escrita, relativa ao objeto do referido pregão, bem como as informações especificações e as condições abaixo discriminadas

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CEARÁ.

PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 27								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUAND	MARCA	V. UNITÁRIO	EXTENSO UNITÁRIO	V. TOTAL	EXTENSO TOTAL
1	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.04-UND	UNIDADE	200	BIOBASE	R\$ 0,72	setenta e dois centavos de real	R\$ 144,00	cento e quarenta e quatro reais
2	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.06-UND	UNIDADE	1000	BIOBASE	R\$ 0,74	setenta e quatro centavos de real	R\$ 740,00	setecentos e quarenta reais
3	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.08-UND	UNIDADE	300	BIOBASE	R\$ 0,75	setenta e cinco centavos de real	R\$ 225,00	duzentos e vinte e cinco reais
4	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.10-UND	UNIDADE	300	BIOBASE	R\$ 0,77	setenta e sete centavos de real	R\$ 231,00	duzentos e trinta e um reais
5	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.12-UND	UNIDADE	300	BIOBASE	R\$ 0,79	setenta e nove centavos de real	R\$ 237,00	duzentos e trinta e sete reais
6	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.14-UND	UNIDADE	300	BIOBASE	R\$ 0,81	oitenta e um centavos de real	R\$ 243,00	duzentos e quarenta e três reais
7	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.16-UND	UNIDADE	300	BIOBASE	R\$ 0,82	oitenta e dois centavos de real	R\$ 246,00	duzentos e quarenta e seis reais
8	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.18-UND	UNIDADE	300	BIOBASE	R\$ 0,84	oitenta e quatro centavos de real	R\$ 252,00	duzentos e cinquenta e dois reais
9	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC N. 3.5 (SEMBALÃO) -UND	UNIDADE	80	SOLIDOR	R\$ 4,60	quatro reais e sessenta centavos	R\$ 368,00	trezentos e sessenta e oito reais
10	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC N. 4.0 (SEMBALÃO) -UND	UNIDADE	80	CIRUTI	R\$ 4,43	quatro reais e quarenta e três centavos	R\$ 354,40	trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos
11	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC N. 5.0 (SEMBALÃO) -UND	UNIDADE	80	CIRUTI	R\$ 4,76	quatro reais e setenta e seis centavos	R\$ 380,80	trezentos e oitenta reais e oitenta centavos
12	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC N. 6.5 (COMBALÃO) - UNID	UNIDADE	150	SOLIDOR	R\$ 5,52	cinco reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 828,00	oitocentos e vinte e oito reais
13	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC N. 7.0 (COMBALÃO) -UND	UNIDADE	150	SOLIDOR	R\$ 5,76	cinco reais e setenta e seis centavos	R\$ 864,00	oitocentos e sessenta e quatro reais
14	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC N. 7.5 (COMBALÃO) -UND	UNIDADE	450	SOLIDOR	R\$ 5,76	cinco reais e setenta e seis centavos	R\$ 2592,00	dois mil, quinhentos e noventa e dois reais
15	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.10 - UNID	UNIDADE	300	BIOBASE	R\$ 0,77	setenta e sete centavos de real	R\$ 231,00	duzentos e trinta e um reais
16	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.12 - UNID	UNIDADE	900	BIOBASE	R\$ 0,79	setenta e nove centavos de real	R\$ 711,00	setecentos e onze reais
17	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.14 - UNID	UNIDADE	500	BIOBASE	R\$ 0,81	oitenta e um centavos de real	R\$ 405,00	quatrocentos e cinco reais
18	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.16 - UNID	UNIDADE	600	BIOBASE	R\$ 0,82	oitenta e dois centavos de real	R\$ 492,00	quatrocentos e noventa e dois reais
19	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.18 - UNID	UNIDADE	300	BIOBASE	R\$ 0,84	oitenta e quatro centavos de real	R\$ 252,00	duzentos e cinquenta e dois reais
20	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.06 - UNID	UNIDADE	300	BIOBASE	R\$ 0,84	oitenta e quatro centavos de real	R\$ 252,00	duzentos e cinquenta e dois reais
21	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.08 - UNID	UNIDADE	300	BIOBASE	R\$ 0,96	oitenta e seis centavos de real	R\$ 288,00	duzentos e cinquenta e oito reais
22	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.10 - UNID	UNIDADE	300	BIOBASE	R\$ 0,87	oitenta e sete centavos de real	R\$ 261,00	duzentos e sessenta e um reais
23	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.12 - UNID	UNIDADE	450	BIOBASE	R\$ 0,91	noventa e um centavos de real	R\$ 409,50	quatrocentos e nove reais e cinquenta centavos
24	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.14 - UNID	UNIDADE	450	BIOBASE	R\$ 1,11	um real e onze centavos	R\$ 499,50	quatrocentos e noventa e nove reais e quinze centavos
25	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.16 - UNID	UNIDADE	600	BIOBASE	R\$ 1,13	um real e treze centavos	R\$ 678,00	seiscentos e setenta e oito reais
26	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.18 - UNID	UNIDADE	450	BIOBASE	R\$ 1,32	um real e trinta e dois centavos	R\$ 594,00	quinhentos e noventa e quatro reais
27	SONDA URETRAL N.04 - UNID	UNIDADE	400	BIOBASE	R\$ 0,72	setenta e dois centavos de real	R\$ 288,00	duzentos e oitenta e oito reais
28	SONDA URETRAL N.06 - UNID	UNIDADE	400	BIOBASE	R\$ 0,74	setenta e quatro centavos de real	R\$ 296,00	duzentos e noventa e seis reais
29	SONDA URETRAL N.08 - UNID	UNIDADE	400	BIOBASE	R\$ 0,75	setenta e cinco centavos de real	R\$ 300,00	trezentos reais
30	SONDA URETRAL N.10 - UNID	UNIDADE	600	BIOBASE	R\$ 0,77	setenta e sete centavos de real	R\$ 462,00	quatrocentos e sessenta e dois reais
31	SONDA URETRAL N.12 - UNID	UNIDADE	600	BIOBASE	R\$ 0,79	setenta e nove centavos de real	R\$ 474,00	quatrocentos e setenta e quatro reais
32	SONDA URETRAL N.14 - UNID	UNIDADE	1000	BIOBASE	R\$ 0,81	oitenta e um centavos de real	R\$ 810,00	oitocentos e dez reais
33	SONDA URETRAL N.16 - UNID	UNIDADE	800	BIOBASE	R\$ 0,82	oitenta e dois centavos de real	R\$ 656,00	seiscentos e cinquenta e seis reais
34	DRENO DE P PENRONE N.02 PACT. C/12UND	PACOTE	20	MADEITEX	R\$ 30,67	trinta reais e sessenta e sete centavos	R\$ 613,40	seiscentos e treze reais e quarenta centavos
35	DRENO DE PENRONE N.03 PACT. C/12UNID	PACOTE	20	MADEITEX	R\$ 32,37	trinta e dois reais e trinta e sete centavos	R\$ 647,40	seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos
36	LÁTEX PARA ASPIRADOR N.204 EM SILICONE	METRO	200	MEDICONE	R\$ 10,40	dez reais e quarenta centavos	R\$ 2.080,00	dois mil e oitenta reais
37	LÁTEX PARA GARROTE N.200 EM SILICONE	METRO	300	LEMGRUBER	R\$ 2,59	dois reais e cinquenta e nove centavos	R\$ 777,00	setecentos e setenta e sete reais
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$ 20.152,00	

Me

[Assinatura]

vinte mil, cento e cinquenta e dois reais

Rubrica

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação que nosso Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do Edital, supracitado e seus anexos.

Declaramos que objeto cotado atende todas as exigências do edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Outrossim declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços da proposta inicial, digital ou anexa, ou ofertados por meio de lances, estão incluídos todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos, sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas fretes, seguros deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive margem de lucro.

Caso nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

- a) Validade da proposta: 60 (SESSENTA) dias, contados da sessão de abertura das propostas;
- b) Prazo de entrega: 05 (CINCO) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Compra.

10 de Fevereiro de 2023.



Ao
Pregoeiro (a) da Prefeitura Municipal de Fortim – Ce.
Pregão Eletrônico Nº 2701.01/2023- SMS/SRP/PE

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGAO ELETRÔNICO Nº 2701.01/2023- SMS/SRP/PE, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CEARÁ

Senhor (a) Pregoeiro (a) apresentamos nossa Proposta de Preços referente ao objeto do pregão acima epigrafado:

LOTE 27 - INSUMOS II									
ITEM	DESCRIÇÃO	REG.ANVISA	MARCA	UNIDADE	QUANT.	V. UNIT	V. U. EXT.	V. TOTAL	V. T. EXT.
1	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.04-UND	8028600037	BIOSANI	UNID	200	R\$ 1,42	um real e quarenta e dois centavos	R\$ 284,00	duzentos e oitenta e quatro reais
2	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.06-UND	8028600037	BIOSANI	UNID	1.000	R\$ 1,46	um real e quarenta e seis centavos	R\$ 1.460,00	mil quatrocentos e sessenta reais
3	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.08-UND	8028600037	BIOSANI	UNID	300	R\$ 1,51	um real e cinquenta e um centavos	R\$ 453,00	quatrocentos e cinquenta e três reais
4	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.10-UND	8028600037	BIOSANI	UNID	300	R\$ 1,60	um real e sessenta centavos	R\$ 480,00	quatrocentos e oitenta reais
5	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.12-UND	8028600037	BIOSANI	UNID	300	R\$ 1,63	um real e sessenta e três centavos	R\$ 489,00	quatrocentos e oitenta e nove reais
6	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.14-UND	8028600037	BIOSANI	UNID	300	R\$ 1,68	um real e sessenta e oito centavos	R\$ 504,00	quinhentos e quatro reais
7	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.16-UND	8028600037	BIOSANI	UNID	300	R\$ 1,82	um real e oitenta e dois centavos	R\$ 546,00	quinhentos e quarenta e seis reais
8	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.18-UND	8028600037	BIOSANI	UNID	300	R\$ 1,96	um real e noventa e seis centavos	R\$ 588,00	quinhentos e oitenta e oito reais
9	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC Nº 3,5 (SEM BALÃO)- UND	80495510046	MEDIX	UNID	80	R\$ 4,05	quatro reais e cinco centavos	R\$ 324,00	trezentos e vinte e quatro reais
10	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC Nº 4,0 (SEM BALÃO)- UND	80495510046	MEDIX	UNID	80	R\$ 4,05	quatro reais e cinco centavos	R\$ 324,00	trezentos e vinte e quatro reais
11	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC Nº 5,0 (SEM BALÃO)- UND	80495510046	MEDIX	UNID	80	R\$ 4,08	quatro reais e oito centavos	R\$ 326,40	trezentos e vinte e seis reais e quarenta centavos
12	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC Nº 6,5 (COM BALÃO) - UND	80495510045	MEDIX	UNID	150	R\$ 4,93	quatro reais e noventa e três centavos	R\$ 739,50	setecentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos
13	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC Nº 7,0 (COM BALÃO) - UND	80495510045	MEDIX	UNID	150	R\$ 4,93	quatro reais e noventa e três centavos	R\$ 739,50	setecentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos
14	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC Nº 7,5 (COM BALÃO) - UND	80495510045	MEDIX	UNID	450	R\$ 4,95	quatro reais e noventa e cinco centavos	R\$ 2.227,50	dois mil, duzentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos
15	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 10 - UND	8028600034	BIOSANI	UNID	300	R\$ 1,60	um real e sessenta centavos	R\$ 480,00	quatrocentos e oitenta reais
16	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 12 - UND	8028600034	BIOSANI	UNID	900	R\$ 1,63	um real e sessenta e três centavos	R\$ 1.467,00	mil quatrocentos e sessenta e sete reais
17	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 14 - UND	8028600034	BIOSANI	UNID	500	R\$ 1,68	um real e sessenta e oito centavos	R\$ 840,00	oitocentos e quarenta reais
18	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 16 - UND	8028600034	BIOSANI	UNID	600	R\$ 1,82	um real e oitenta e dois centavos	R\$ 1.092,00	mil e noventa e dois reais
19	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 18 - UND	8028600034	BIOSANI	UNID	300	R\$ 1,96	um real e noventa e seis centavos	R\$ 588,00	quinhentos e oitenta e oito reais

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis. 932

20	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 06 - UND	80286000034	BIOSANI	UNID	300	R\$ 1,71	um real e setenta e um centavos	R\$ 513,00	quinhentos e treze reais
21	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08 - UND	80286000034	BIOSANI	UNID	300	R\$ 1,85	um real e oitenta e cinco centavos	R\$ 555,00	quinhentos e cinquenta e cinco reais
22	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10 - UND	80286000034	BIOSANI	UNID	300	R\$ 1,95	um real e noventa e cinco centavos	R\$ 585,00	quinhentos e oitenta e cinco reais
23	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12 - UND	80286000034	BIOSANI	UNID	450	R\$ 2,26	dois reais e vinte e seis centavos	R\$ 1.017,00	mil e dezessete reais
24	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14 - UND	80286000034	BIOSANI	UNID	450	R\$ 2,59	dois reais e cinquenta e nove centavos	R\$ 1.165,50	mil cento e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos
25	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16 - UND	80286000034	BIOSANI	UNID	600	R\$ 2,78	dois reais e setenta e oito centavos	R\$ 1.668,00	mil seiscentos e sessenta e oito reais
26	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18 - UND	80286000034	BIOSANI	UNID	450	R\$ 3,10	três reais e dez centavos	R\$ 1.395,00	mil trezentos e noventa e cinco reais
27	SONDA URETRAL Nº 04 - UND	80286009007	BIOSANI	UNID	400	R\$ 1,42	um real e quarenta e dois centavos	R\$ 568,00	quinhentos e sessenta e oito reais
28	SONDA URETRAL Nº 06 - UND	80286009007	BIOSANI	UNID	400	R\$ 1,46	um real e quarenta e seis centavos	R\$ 584,00	quinhentos e oitenta e quatro reais
29	SONDA URETRAL Nº 08 - UND	80286009007	BIOSANI	UNID	400	R\$ 1,51	um real e cinquenta e um centavos	R\$ 604,00	seiscentos e quatro reais
30	SONDA URETRAL Nº 10 - UND	80286009007	BIOSANI	UNID	600	R\$ 1,60	um real e sessenta centavos	R\$ 960,00	novecientos e sessenta reais
31	SONDA URETRAL Nº 12 - UND	80286009007	BIOSANI	UNID	600	R\$ 1,63	um real e sessenta e três centavos	R\$ 978,00	novecientos e setenta e oito reais
32	SONDA URETRAL Nº 14 - UND	80286009007	BIOSANI	UNID	1.000	R\$ 1,68	um real e sessenta e oito centavos	R\$ 1.680,00	mil seiscentos e oitenta reais
33	SONDA URETRAL Nº 16 - UND	80286009007	BIOSANI	UNID	800	R\$ 1,82	um real e oitenta e dois centavos	R\$ 1.456,00	mil quatrocentos e cinquenta e seis reais
34	DRENO DE P PENRONE Nº02 PACT. C/12UND	80950310002	MADEITEX	PCT	20	R\$ 8,00	oito reais	R\$ 160,00	cento e sessenta reais
35	DRENO DE PENRONE Nº03 PACT. C/12UND	80950310002	MADEITEX	PCT	20	R\$ 9,98	nove reais e noventa e oito centavos	R\$ 199,60	cento e noventa e nove reais e sessenta centavos
36	LÁTEX PARA ASPIRADOR Nº 204 EM SILICONE	80020550031	MEDICONE	METRO	200	R\$ 52,15	cinquenta e dois reais e quinze centavos	R\$ 10.430,00	dez mil, quatrocentos e trinta reais
37	LÁTEX PARA GARROTE Nº 200 EM SILICONE	RDC 185	LEMGRUBER	METRO	300	R\$ 4,45	quatro reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 1.335,00	mil trezentos e trinta e cinco reais
VALOR TOTAL DO LOTE								R\$ 39.805,00	
Trinta e nove mil, oitocentos e cinco reais									

Valor Global da Proposta: **R\$ 10.004.775,80 (dez milhões e quatro mil, setecentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos)**



Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias conforme solicitado no Edital.

Prazo de entrega: 5 (cinco) dias após recebimento da Ordem de Compra.

Declaramos, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital)

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 933
 Rúbrica


Declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela aquisição dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra, e ainda, que nos preços estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do FORNECIMENTO, tais como: todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto, constantes da proposta, abrangendo, assim, todos os custos com os serviços necessários a execução do objeto em perfeitas condições a manutenção destas condições durante o prazo de contrato.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Compra.

13 de fevereiro de 2023.



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 934
Rubrica



Rubrica

FORTALEZA-CE, 13 DE FEVEREIRO 2023.

AO GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM/CE
ATT.: AO PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: PROPOSTA DE PREÇO

PREZADOS SENHORES;
APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2701.01/2023, REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CEARÁ.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2701.01/2023 DATA DE ABERTURA 13 DE FEVEREIRO AS 10:30HRS.

PREZADOS SENHORES,

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 27 - INSUMOS II										
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD. HOSPITAL	QTD. ATENÇÃO BÁSICA	QTD TOTAL	MARCA	V. UNITÁRIO	-	V. TOTAL	-
1	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.04-UND	Unidade	150	50	200	SOLIDOR	R\$ 2,10	dois reais e dez centavos	R\$ 420,00	quatrocentos e vinte reais
2	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.06-UND	Unidade	950	50	1000	SOLIDOR	R\$ 2,10	dois reais e dez centavos	R\$ 2.100,00	dois mil e cem reais
3	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.08-UND	Unidade	250	50	300	SOLIDOR	R\$ 2,25	dois reais e vinte e cinco centavos	R\$ 675,00	seiscentos e setenta e cinco reais
4	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.10-UND	Unidade	250	50	300	SOLIDOR	R\$ 2,10	dois reais e dez centavos	R\$ 630,00	seiscentos e trinta reais
5	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.12-UND	Unidade	250	50	300	SOLIDOR	R\$ 2,10	dois reais e dez centavos	R\$ 630,00	seiscentos e trinta reais
6	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.14-UND	Unidade	250	50	300	SOLIDOR	R\$ 2,25	dois reais e vinte e cinco centavos	R\$ 675,00	seiscentos e setenta e cinco reais
7	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.16-UND	Unidade	250	50	300	SOLIDOR	R\$ 2,25	dois reais e vinte e cinco centavos	R\$ 675,00	seiscentos e setenta e cinco reais
8	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.18-UND	Unidade	250	50	300	SOLIDOR	R\$ 2,25	dois reais e vinte e cinco centavos	R\$ 675,00	seiscentos e setenta e cinco reais
9	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC N. 3,5 (SEM BALÃO) -UND	Unidade	20	60	80	SOLIDOR	R\$ 9,45	nove reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 756,00	setecentos e cinquenta e seis reais
10	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC N. 4,0 (SEM BALÃO) -UND	Unidade	20	60	80	SOLIDOR	R\$ 9,45	nove reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 756,00	setecentos e cinquenta e seis reais
11	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC N. 5,0 (SEM BALÃO) -UND	Unidade	20	60	80	SOLIDOR	R\$ 9,45	nove reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 756,00	setecentos e cinquenta e seis reais
12	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC N. 6,5 (COM BALÃO) - UNID	Unidade	100	50	150	SOLIDOR	R\$ 9,45	nove reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 1.417,50	mil quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos
13	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC N. 7,0 (COM BALÃO) -UND	Unidade	100	50	150	SOLIDOR	R\$ 9,45	nove reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 1.417,50	mil quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos
14	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC N. 7,5 (COM BALÃO) -UND	Unidade	100	350	450	SOLIDOR	R\$ 9,57	nove reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 4.306,50	quatro mil, trezentos e seis reais e cinquenta centavos
15	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.10 – UND	Unidade	100	200	300	BIOSANI	R\$ 3,63	três reais e sessenta e três centavos	R\$ 1.089,00	mil e oitenta e nove reais
16	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.12 – UND	Unidade	200	700	900	BIOSANI	R\$ 3,63	três reais e sessenta e três centavos	R\$ 3.267,00	três mil, duzentos e sessenta e sete reais
17	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.14 – UND	Unidade	300	200	500	BIOSANI	R\$ 3,63	três reais e sessenta e três centavos	R\$ 1.815,00	mil oitocentos e quinze reais
18	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.16 – UND	Unidade	500	100	600	BIOSANI	R\$ 3,63	três reais e sessenta e três centavos	R\$ 2.178,00	dois mil, cento e setenta e oito reais
19	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N.18- UND	Unidade	200	100	300	BIOSANI	R\$ 3,63	três reais e sessenta e três centavos	R\$ 1.089,00	mil e oitenta e nove reais

Arb
Rubrica

20	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.06 – UND	Unidade	100	200	300	BIOSANI	R\$ 3,63	três reais e sessenta e três centavos	R\$ 1.089,00	mil e oitenta e nove reais
21	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.08 – UND	Unidade	100	200	300	BIOSANI	R\$ 3,63	três reais e sessenta e três centavos	R\$ 1.089,00	mil e oitenta e nove reais
22	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.10 – UND	Unidade	100	200	300	BIOSANI	R\$ 3,63	três reais e sessenta e três centavos	R\$ 1.089,00	mil e oitenta e nove reais
23	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.12 – UND	Unidade	100	350	450	BIOSANI	R\$ 3,63	três reais e sessenta e três centavos	R\$ 1.633,50	mil seiscentos e trinta e três reais e cinquenta centavos
24	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.14 – UND	Unidade	400	50	450	BIOSANI	R\$ 3,63	três reais e sessenta e três centavos	R\$ 1.633,50	mil seiscentos e trinta e três reais e cinquenta centavos
25	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.16 – UND	Unidade	400	200	600	BIOSANI	R\$ 3,63	três reais e sessenta e três centavos	R\$ 2.178,00	dois mil, cento e setenta e oito reais
26	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N.18 – UND	Unidade	400	50	450	BIOSANI	R\$ 3,63	três reais e sessenta e três centavos	R\$ 1.633,50	mil seiscentos e trinta e três reais e cinquenta centavos
27	SONDA URETRAL N.04 – UND	Unidade	200	200	400	SOLIDOR	R\$ 1,71	um real e setenta e um centavos	R\$ 684,00	seiscentos e oitenta e quatro reais
28	SONDA URETRAL N.06 – UND	Unidade	200	200	400	SOLIDOR	R\$ 1,71	um real e setenta e um centavos	R\$ 684,00	seiscentos e oitenta e quatro reais
29	SONDA URETRAL N.08 – UND	Unidade	200	200	400	SOLIDOR	R\$ 1,86	um real e oitenta e seis centavos	R\$ 744,00	setecentos e quarenta e quatro reais
30	SONDA URETRAL N.10 – UND	Unidade	200	400	600	SOLIDOR	R\$ 1,98	um real e noventa e oito centavos	R\$ 1.188,00	mil cento e oitenta e oito reais
31	SONDA URETRAL N.12 – UND	Unidade	200	400	600	SOLIDOR	R\$ 1,68	um real e sessenta e oito centavos	R\$ 1.008,00	mil e oito reais
32	SONDA URETRAL N.14 – UND	Unidade	400	600	1000	SOLIDOR	R\$ 2,01	dois reais e um centavo	R\$ 2.010,00	dois mil e dez reais
33	SONDA URETRAL N.16 – UND	Unidade	400	400	800	SOLIDOR	R\$ 1,95	um real e noventa e cinco centavos	R\$ 1.560,00	mil quinhentos e sessenta reais
34	DRENO DE P PENRONE N.02 PACT. C/12UND	Pacote	20		20	WALTEX	R\$ 39,60	trinta e nove reais e sessenta centavos	R\$ 792,00	setecentos e noventa e dois reais
35	DRENO DE PENRONE N.03 PACT. C/12UNID	Pacote	20		20	WALTEX	R\$ 39,60	trinta e nove reais e sessenta centavos	R\$ 792,00	setecentos e noventa e dois reais
36	LÁTEX PARA ASPIRADOR N.204 EM SILICONE	Metro	200		200	LATEX BR	R\$ 10,05	dez reais e cinco centavos	R\$ 2.010,00	dois mil e dez reais
37	LÁTEX PARA GARROTE N.200 EM SILICONE	Metro	200	100	300	LATEX BR	R\$ 3,48	três reais e quarenta e oito centavos	R\$ 1.044,00	mil e quarenta e quatro reais
LOTE 27									R\$	48.189,00
quarenta e oito mil, cento e oitenta e nove reais										

VALOR TOTAL DOS LOTES	R\$	48.189,00
quarenta e oito mil, cento e oitenta e nove reais		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NOS PREÇOS OFERECIDOS ESTAO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO, TRIBUTOS, DESLOCAMENTO DE PESSOAL E DEMAIS ONUS PERTINENTES A CONTRATAÇÃO.

DECLARAMOS AINDA QUE, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA ENTREGA DOS PRODUTOS, E QUE SERAO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICIA E CONTRATUAL, E QUE SERAO INCIADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À EPECIFICAÇÃO E CARACTERISTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXO

DECLARAMOS QUE NOS VALORES APRESENTADOS EM NOSSA PROPOSTA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, SEGUROS, DESLOCAMENTO DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

FORTALEZA/CE, 13 DE FEVEREIRO DE 2023.

MC

[Handwritten signature]

me
Rubrica

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2701.01/2023-SMS/SRP

DISPUTA DE LANCES: 13/02/2023 ÀS 10H30

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CEARÁ.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 27 - INSUMOS II								
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTDE	VL.UNIT.	VL.TOTAL	
27	1	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.04-UND	UND	BIOSANI	200	R\$ 1,71	R\$ 342,00	
27	2	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.06-UND	UND	BIOSANI	1000	R\$ 1,77	R\$ 1.770,00	
27	3	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.08-UND	UND	BIOSANI	300	R\$ 1,80	R\$ 540,00	
27	4	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.10-UND	UND	BIOSANI	300	R\$ 1,83	R\$ 549,00	
27	5	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.12-UND	UND	BIOSANI	300	R\$ 1,86	R\$ 558,00	
27	6	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.14-UND	UND	BIOSANI	300	R\$ 1,95	R\$ 585,00	
27	7	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.16-UND	UND	BIOSANI	300	R\$ 2,07	R\$ 621,00	
27	8	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.18-UND	UND	BIOSANI	300	R\$ 2,16	R\$ 648,00	
27	9	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC Nº 3,5 (SEM BALÃO) - UND	UND	TOPMED	80	R\$ 10,08	R\$ 806,40	
27	10	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC Nº 4,0 (SEM BALÃO) - UND	UND	TOPMED	80	R\$ 10,08	R\$ 806,40	
27	11	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC Nº 5,0 (SEM BALÃO) - UND	UND	TOPMED	80	R\$ 10,08	R\$ 806,40	
27	12	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC Nº 6,5 (COM BALÃO) - UND	UND	TOPMED	150	R\$ 13,77	R\$ 2.065,50	
27	13	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC Nº 7,0 (COM BALÃO) - UND	UND	TOPMED	150	R\$ 13,77	R\$ 2.065,50	
27	14	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC Nº 7,5 (COM BALÃO) - UND	UND	TOPMED	450	R\$ 13,77	R\$ 6.196,50	
27	15	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 10 - UND	UND	BIOSANI	300	R\$ 1,86	R\$ 558,00	
27	16	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 12 - UND	UND	BIOSANI	900	R\$ 1,92	R\$ 1.728,00	
27	17	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 14 - UND	UND	BIOSANI	500	R\$ 1,98	R\$ 990,00	
27	18	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 16 - UND	UND	BIOSANI	600	R\$ 2,07	R\$ 1.242,00	
27	19	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 18 - UND	UND	BIOSANI	300	R\$ 2,22	R\$ 666,00	
27	20	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 06 - UND	UND	BIOSANI	300	R\$ 2,10	R\$ 630,00	
27	21	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08 - UND	UND	BIOSANI	300	R\$ 2,25	R\$ 675,00	
27	22	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10 - UND	UND	BIOSANI	300	R\$ 2,40	R\$ 720,00	
27	23	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12 - UND	UND	BIOSANI	450	R\$ 2,91	R\$ 1.309,50	
27	24	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14 - UND	UND	BIOSANI	450	R\$ 3,27	R\$ 1.471,50	
27	25	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16 - UND	UND	BIOSANI	600	R\$ 3,54	R\$ 2.124,00	
27	26	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18 - UND	UND	BIOSANI	450	R\$ 3,75	R\$ 1.687,50	
27	27	SONDA URETRAL Nº 04 - UND	UND	BIOSANI	400	R\$ 1,77	R\$ 708,00	
27	28	SONDA URETRAL Nº 06 - UND	UND	BIOSANI	400	R\$ 1,77	R\$ 708,00	
27	29	SONDA URETRAL Nº 08 - UND	UND	BIOSANI	400	R\$ 1,80	R\$ 720,00	
27	30	SONDA URETRAL Nº 10 - UND	UND	BIOSANI	600	R\$ 1,83	R\$ 1.098,00	
27	31	SONDA URETRAL Nº 12 - UND	UND	BIOSANI	600	R\$ 1,86	R\$ 1.116,00	
27	32	SONDA URETRAL Nº 14 - UND	UND	BIOSANI	1000	R\$ 1,95	R\$ 1.950,00	
27	33	SONDA URETRAL Nº 16 - UND	UND	BIOSANI	800	R\$ 2,07	R\$ 1.656,00	
27	34	DRENO DE P PENRONE Nº 02 PACT. C/12UND	PCT	MADEITEX	20	R\$ 32,19	R\$ 643,80	
27	35	DRENO DE PENRONE Nº 03 PACT. C/12UNID	PCT	MADEITEX	20	R\$ 43,59	R\$ 871,80	
27	36	LÁTEX PARA ASPIRADOR Nº 204 EM SILICONE	MTR	MEDICONE	200	R\$ 27,57	R\$ 5.514,00	
27	37	LÁTEX PARA GARROTE Nº 200 EM SILICONE	MTR	MEDICONE	300	R\$ 18,45	R\$ 5.535,00	
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$ 52.681,80	
cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta centavos								
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							R\$ 52.681,80	
cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta centavos								

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: 05 (cinco) dias corridos

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

13/02/2023

M

me

me
Rubrica

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM
À CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTIM
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 2701.01/2023
DIA E HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13 DE FEVEREIRO DE 2023 ÀS 08:30H
DIA E HORÁRIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 13 DE FEVEREIRO DE 2023 ÀS 10H30

At. Sr.(a) Pregoeiro (a)

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta de Escrita, relativa ao objeto do referido pregão, bem como as informações especificações e as condições abaixo descritas

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CEARÁ.

PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 28								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUAND	MARCA	V. UNITÁRIO	EXTENSO UNITÁRIO	V. TOTAL	EXTENSO TOTAL
1	DETECTOR FETAL PORTÁTIL	UNIDADE	25	SGMED	R\$ 485,71	quatrocentos e oitenta e	R\$ 12.142,75	doze mil, cento e
2	NEGATOSCÓPIO PANORÂMICO 1 CORPO	UNIDADE	7	SANTA CLARA	R\$ 715,44	setecentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 5.008,08	cinco mil e oito reais e oito centavos
3	FOCO DE LUZ CLÍNICO E GINECOLÓGICO	UNIDADE	25	QUALITY	R\$ 427,93	quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos	R\$ 10.698,25	dez mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos
4	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL (HOSPITAL)	UNIDADE	15	CARONE	R\$ 1.129,36	mil cento e vinte e nove reais e trinta e seis centavos	R\$ 16.940,40	dezesseis mil, novecentos e quarenta reais e quarenta centavos
5	CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA (HOSPITAL)	UNIDADE	4	CARONE	R\$ 374,75	trezentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos	R\$ 1.499,00	mil quatrocentos e noventa e nove reais
6	OXÍMETRO DE DEDO COM TELA LED COLORIDA DE FÁCIL LEITURA, INDICADO PARA USO HOSPITALAR, COM INDICADOR DE PULSO. DOIS FORMATOS DE VISUALIZAÇÃO, FÁCIL USO, APENAS UM BOTÃO. UTILIZA 2 PILHAS ALCALINAS AAA. CORDÃO PARA MELHOR MOBILIDADE INDICAÇÃO DA CARGA DA BATERIA ALARME DE 02 ABAIXO DE 90%. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 08 SEGUNDOS DE INATIVIDADE, ALARME VISUAL E SONORO. DEVE POSSUIR BARRA LATERAL QUE GARANTE MAIOR PRECISÃO. CAPACIDADE DA BATERIA: PODE SER USADA POR 18 HORAS CONTINUAMENTE. DEVE ATENDER ÀS NORMAS NBR IEC 60601-1 E 60601-1-2. APRESENTAR DOCUMENTO ANEXO A PROPOSTA APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO DO FORNECEDOR, AUTORIZANDO O FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO	UNIDADE	40	GTECH	R\$ 119,07	cento e dezenove reais e sete centavos	R\$ 4.762,80	quatro mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos
7	OXÍMETRO DE MESA TÉCNICAS DE ESPECTROFOTOMETRIA E PLETISMOGRAFIA MOSTRA OS VALORES-MEDIDAS DE SPO2 E PULSO CURVA PLETISMOGRÁFICA, INDICA QUALIDADE DO SINAL PROCURANDO PULSO E PULSO FRACO FAIXA DE MEDIDAS SPO2 0 A 100%, FAIXA SPO2: ±2% 70 A 100%. FAIXA DE MEDIDAS PULSO: 30 A 254 BPM. PRECISÃO OPCIONAIS EXTENSÃO DE SENSOR (1,5M) CONECTOR DB-9, SENSOR DE DEDO ADULTO REUTILIZÁVEL (1,2M) SENSOR DESCARTÁVEL ADULTO (0,6M) > 45KG SENSOR DESCARTÁVEL INFANTIL (0,6M) 15-45KG SENSOR DESCARTÁVEL NEONATO (0,6M) <3KG SENSOR UNIVERSAL "Y" SENSOR DE ORELHA SENSOR REUTILIZÁVEL INFANTIL (46CM) 3 15KG SENSOR REUTILIZÁVEL NEONATO (46CM) <3KG ESPECIFICAÇÕES GERAIS CONGELAMENTO DA FORMA DE ONDA E SPO2 MONITORAÇÃO NO MODO ADULTO E NEONATAL. AJUSTE DIGITAL DO CONTRASTE DO DISPLAY. CONTROLE DIGITAL DO VOLUME DO BIP DE PULSO E ALARMES. AJUSTE DE VELOCIDADE DE TRAÇADO PARA 25 OU 50 MM/S. AJUDA "ON-LINE" INDICAÇÃO DE CARREGAMENTO DE BATERIA, BATERIA FRACA, REDE ELÉTRICA OU SÓ BATERIA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NO CASO DE LIMITE MÍNIMO DE CARGA DE BATERIA. ALARMES ALARMES DE SITUAÇÃO PARA AUSÊNCIAS DE SENSOR DE OXIMETRIA, LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PARA OXIMETRIA E PULSO INDICAÇÃO SONORA COM 3 TONS DE FREQUÊNCIAS E VOLUME AJUSTÁVEL	UNIDADE	2	MD	R\$ 2.299,60	dois mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta centavos	R\$ 4.599,20	quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e vinte centavos
8	ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL ASPIRADOR COM COMANDOS NA PARTE SUPERIOR; CAIXA DE PROTEÇÃO DO CONJUNTO DO MOTOR, EM PLÁSTICO RESISTENTE; RUÍDO MENOR QUE 60 DBA; COM ALÇA. MONTADO EM MÓVEL DE ESTRUTURA METÁLICA APOIADA SOBRE QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS. REGISTRO DE AGULHA, EM AÇO INOX. VACUÔMETRO CALIBRADO ATÉ 29 POLHG (760 MMHG). SUPORTE PARA DUAS CÂMULAS TAMPÃO DO FRASCO EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL. CONEXÃO TIPO "ENGATE RÁPIDO". SUPORTE PARA ATÉ DOIS FRASCOS COLETORES SUSPENSOS. ACOMPANHA: 02 FRASCOS COLETORES DE SECREÇÕES DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E A ALTAS TEMPERATURAS (121°C) EM PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 25 LITROS CADA. GRADUADO EM ALTORELEVO E PEDAL DE AÇIONAMENTO. FLUXO DE AR: 0 A 24 LPM. VÁCUO: 0 A 22 POLHG / 560 MMHG. MEDIDAS EXTERNAS (LXPXH): 45 X 52 X 120 CM. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 127/220 V AC COM CHAVE DE COMUTAÇÃO. POTÊNCIA ELÉTRICA: 540 VA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CATÁLOGO DO PRODUTO.	UNIDADE	3	OLIDEF	R\$ 1.958,75	mil novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos	R\$ 5.876,25	cinco mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$ 61.526,73	
sessenta e um mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos								
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA							R\$ 61.526,73	

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rubrica

sessenta e um mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação que nosso Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do Edital, supracitado e seus anexos.

Declaramos que objeto cotado atende todas as exigências do edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Outrossim declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços da proposta inicial, digital ou anexa, ou ofertados por meio de lances, estão inclusos todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos, sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas fretes, seguros deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive margem de lucro.

Caso nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

a) Validade da proposta: 60 (SESENTA) dias, contados da sessão de abertura das propostas;

b) Prazo de entrega: 05 (CINCO) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Compra.

10 de Fevereiro de 2023.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM/CE.
A/C DA PREGOEIRA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, MARIA VANESSA LOURENÇO MENESES.
REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2701.01/2023-SMS/SRP/PE
DATA E HORA DA ABERTURA: 13 DE FEVEREIRO DE 2023 ÀS 08:30H.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CEARÁ.

PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 28 - PERMANENTE III

ITEM	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	REGISTRO ANVISA	HOSPITAL	AT. BÁSICA	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	UNID	DETECTOR FETAL PORTÁTIL	MD	80070210067	1	24	25	R\$ 720,44	R\$ 18.011,00	setecentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos dezoito mil e onze reais
2	UNID	NEGATOSCÓPIO PANORÂMICO 1 CORPO	MODELO MOVEIS	RDC 185/2001	1	6	7	R\$ 602,00	R\$ 4.214,00	seiscentos e dois reais quatro mil, duzentos e quatorze reais
3	UNID	FOCO DE LUZ CLÍNICO E GINECOLÓGICO	TUBOMED	RDC 185/2001	0	25	25	R\$ 182,00	R\$ 4.550,00	cento e oitenta e dois reais quatro mil, quinhentos e cinquenta reais
4	UNID	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL (HOSPITAL)	DUNE	81354110002	5	10	15	R\$ 602,00	R\$ 9.030,00	seiscentos e dois reais nove mil e trinta reais
5	UNID	CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA (HOSPITAL)	ORTOBRAS	80118040001	4	0	4	R\$ 684,94	R\$ 2.739,76	seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos dois mil, setecentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos
6	UNID	OXIMETRO DE DEDO COM TELA LED COLORIDA DE FÁCIL LEITURA, INDICADO PARA USO HOSPITALAR, COM INDICADOR DE PULSO. DOIS FORMATOS DE VISUALIZAÇÃO, FÁCIL USO, APENAS UM BOTÃO, UTILIZA 2 PILHAS ALCALINAS AAA, CORDÃO PARA MELHOR MOBILIDADE INDICAÇÃO DA CARGA DA BATERIA ALARME DE O2 ABAIXO DE 90%, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 08 SEGUNDOS DE INATIVIDADE, ALARME VISUAL E SONORO, DEVE POSSUIR BARRA LATERAL QUE GARANTE MAIOR PRECISÃO. CAPACIDADE DA BATERIA: PODE SER USADA POR 18 HORAS CONTINUAMENTE. DEVE ATENDER ÀS NORMAS NBR IEC 60601-1 E 60601-1-2, APRESENTAR DOCUMENTO ANEXO A PROPOSTA. APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO DO FORNECEDOR, AUTORIZANDO O FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO.	MD	80070210011	15	25	40	R\$ 449,11	R\$ 17.964,40	quatrocentos e quarenta e nove reais e onze centavos dezesete mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 940
Rubrica

7	UNID	<p>OXIMETRO DE MESA: TÉCNICAS DE ES+B430:B467 PECTROFOTOMETRIA E PLETISMOGRAFIA MOSTRA OS VALORES-MEDIDAS DE SPO2 E PULSO CURVA PLETISMOGRÁFICA, INDICA QUALIDADE DO SINAL PROCURANDO PULSO E PULSO FRACO FAIXA DE MEDIDAS SPO2 0 A 100%, FAIXA SPO2: ±2% 70 A 100%, FAIXA DE MEDIDAS PULSO: 30 A 254 BPM, PRECISÃO PULSO: ±3 BPM OU ±2% (A QUE FOR O MAIOR) ACESSÓRIOS 1 CABO DE FORÇA DE 3 PINOS (2,5M), 1 SENSOR DE DEDO ADULTO REUTILIZÁVEL (2,7M) 1 CERTIFICADO DE GARANTIA 1 MANUAL DO USUÁRIO ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTENSÃO DE SENSOR (1,5M) CONECTOR DB-9, SENSOR DE DEDO ADULTO REUTILIZÁVEL (1,2M) SENSOR DESCARTÁVEL ADULTO (0,6M) > 45KG SENSOR DESCARTÁVEL INFANTIL (0,6M) 15-45KG SENSOR DESCARTÁVEL NEONATO (0,6M) <3KG SENSOR UNIVERSAL "Y" SENSOR DE ORELHA SENSOR REUTILIZÁVEL INFANTIL (46CM) 3-15KG SENSOR REUTILIZÁVEL NEONATO (46CM) <3KG ESPECIFICAÇÕES GERAIS CONGELAMENTO DA FORMA DE ONDA E SPO2. MONITORAÇÃO NO MODO ADULTO E NEONATAL. AJUSTE DIGITAL DO CONTRASTE DO DISPLAY. CONTROLE DIGITAL DO VOLUME DO BIP DE PULSO E ALARMES. AJUSTE DE VELOCIDADE DE TRAÇADO PARA 25 OU 50 MM/S. AJUDA "ON-LINE" INDICAÇÃO DE CARREGAMENTO DE BATERIA, BATERIA FRACA, REDE ELÉTRICA OU SÓ BATERIA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NO CASO DE LIMITE MÍNIMO DE CARGA DE BATERIA. ALARMES ALARMES DE SITUAÇÃO PARA AUSÊNCIAS DE SENSOR DE OXIMETRIA, LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PARA OXIMETRIA E PULSO INDICAÇÃO SONORA COM 3 TONS DIFERENTES E VOLUME AJUSTÁVEL DIGITALMENTE INDICAÇÃO VISUAL GRÁFICOS E TENDÊNCIAS TENDÊNCIA PARA VARIAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA E SPO2 NAS ÚLTIMAS 72H VISUALIZAÇÃO EM INTERVALOS AJUSTÁVEIS DE 30 MIN., 1H, 2H, 3H, 6H, 12H, 32H, 64H ESCALA AUTOMÁTICA DE 0-MÁX. OU MIN-MÁX SAIDA PARA IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DOS VALORES DE SPO2 E DAS CONDIÇÕES DE ALARME DOIS MODOS DE IMPRESSÃO; RELATÓRIO E CONTÍNUO COMPATÍVEL COM IMPRESSORA MATRICIAL SAIDAS SERIAL E ANALÓGICA PADRÃO RS232 PARA COMPUTADORES OU ESTAÇÃO CENTRAL (SOFTWARE OPCIONAL) ALIMENTAÇÃO REDE ELÉTRICA - 110 A 220 VAC - 50/60HZ AUTOMÁTICA 50VA FONTE EXTERNA: 12 VDC (ESTABILIZADA) X 30W BATERIA: CHUMBO-ÁCIDO, 12 VDC/AH, RECARGA INTERNA E AUTOMÁTICA, USO APROXIMADO DE 8H PARA ECG QUANDO TOTALMENTE CARREGADA TEMPO DE RECARGA: 16 HORAS QUANDO TOTALMENTE DESCARREGADA DIMENSÕES ALTURA: 14,0 CM LARGURA: 22,8 CM PROFUNDIDADE: 21,0 CM PESO: 3,8 KG ESPECIFICAÇÃO AMBIENTAL TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 60°C TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 A 70°C UMIDADE RELATIVA: 15 A 95% (OPERAÇÃO) 10 A 90% (ARMAZENAMENTO).</p>	MD	80070219025	2	0	2	R\$ 1 609,69	mil seiscentos e nove reais e sessenta e nove centavos	R\$ 3.219,38	três mil, duzentos e dezenove reais e trinta e oito centavos
8	UNID	<p>ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL ASPIRADOR COM COMANDOS NA PARTE SUPERIOR, CAIXA DE PROTEÇÃO DO CONJUNTO DOMOTOR, EM PLÁSTICO RESISTENTE, RUÍDO MENOR QUE 60 DBA, COM ALÇA, MONTADO EM MÓVEL DE ESTRUTURA METÁLICA APOIADA SOBRE QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS. REGISTRO DE AGULHA, EM AÇO INOX. VACUÔMETRO CALIBRADO ATÉ 29 POLHG (760 MMHG). SUPORTE PARA DUAS CÂNULAS. TAMPÃO DO FRASCO EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL. CONEXÃO TIPO "ENGATE RÁPIDO". SUPORTE PARA ATÉ DOIS FRASCOS COLETORES SUSPENSOS. ACOMPANHA: 02 FRASCOS COLETORES DE SECREÇÕES DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E A ALTAS TEMPERATURAS (121°C) EM PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 2,5 LITROS CADA, GRADUADO EM ALTO-RELEVO E PEDAL DE ACIONAMENTO. FLUXO DE AR: 0 A 24 LPM. VÁCUO: 0 A 22 POLHG / 560 MMHG. MEDIDAS EXTERNAS (LXPXH): 45 X 52 X 120 CM. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 127/220 V AC COM CHAVE DE COMUTAÇÃO. POTÊNCIA ELÉTRICA: 540 VA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CATÁLOGO DO PRODUTO.</p>	HR	81731740002	3	0	R\$ 600,60	seiscentos reais e sessenta centavos	R\$ 1 801,80	mil oitocentos e um reais e oitenta centavos	
VALOR TOTAL DO LOTE		R\$ 61.530,34	sessenta e um mil, quinhentos e trinta reais e trinta e quatro centavos								


PRAZO DE ENTREGA: 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DATA DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA
 PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.


DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).
 DECLARAÇÃO QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

DECLARAMOS QUE SOMOS MICROEMPRESA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO 4º DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06.

FORTALEZA/CE, 13 DE FEVEREIRO DE 2023.


 FLS 941
 2/3
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO





7	<p>OXIMETRO DE MESA: TÉCNICAS DE ES+B430 B467 PECTROFOTOMETRIA E PLETISMOGRAFIA MOSTRA OS VALORES-MEDIDAS DE SPO2 E PULSO CURVA PLETISMOGRÁFICA, INDICA QUALIDADE DO SINAL PROCURANDO PULSO E PULSO FRACO FAIXA DE MEDIDAS SPO2 0 A 100%, FAIXA SPO2: $\pm 2\%$ 70 A 100%, FAIXA DE MEDIDAS PULSO: 30 A 254 BPM, PRECISÃO PULSO: ± 3 BPM OU $\pm 2\%$ (A QUE FOR O MAIOR) ACESSÓRIOS 1 CABO DE FORÇA DE 3 PINOS (2,5M), 1 SENSOR DE DEDO ADULTO REUTILIZÁVEL (2,7M) 1 CERTIFICADO DE GARANTIA 1 MANUAL DO USUÁRIO ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTENSÃO DE SENSOR (1,5M) CONECTOR DB-9, SENSOR DE DEDO ADULTO REUTILIZÁVEL (1,2M) SENSOR DESCARTÁVEL ADULTO (0,6M) > 45KG SENSOR DESCARTÁVEL INFANTIL (0,6M) 15-45KG SENSOR DESCARTÁVEL NEONATO (0,6M) <3KG SENSOR UNIVERSAL "Y" SENSOR DE ORELHA SENSOR REUTILIZÁVEL INFANTIL (46CM) 3-15KG SENSOR REUTILIZÁVEL NEONATO (46CM) <3KG ESPECIFICAÇÕES GERAIS CONGELAMENTO DA FORMA DE ONDA E SPO2. MONITORAÇÃO NO MODO ADULTO E NEONATAL. AJUSTE DIGITAL DO CONTRASTE DO DISPLAY. CONTROLE DIGITAL DO VOLUME DO BIP DE PULSO E ALARMES. AJUSTE DE VELOCIDADE DE TRAÇADO PARA 25 OU 50 MM/S AJUDA "ON-LINE" INDICAÇÃO DE CARREGAMENTO DE BATERIA. BATERIA FRACA, REDE ELÉTRICA OU SÓ BATERIA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NO CASO DE LIMITE MÍNIMO DE CARGA DE BATERIA. ALARMES ALARMES DE SITUAÇÃO PARA AUSÊNCIAS DE SENSOR DE OXIMETRIA, LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PARA OXIMETRIA E PULSO INDICAÇÃO SONORA COM 3 TONS DIFERENTES E VOLUME AJUSTÁVEL DIGITALMENTE INDICAÇÃO VISUAL GRÁFICOS E TENDÊNCIAS TENDÊNCIA PARA VARIAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA E SPO2 NAS ÚLTIMAS 72H VISUALIZAÇÃO EM INTERVALOS AJUSTÁVEIS DE 30 MIN., 1H, 2H, 3H, 6H, 12H, 32H, 64H ESCALA AUTOMÁTICA DE 0-MÁX. OU MIN-MÁX SAIDA PARA IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DOS VALORES DE SPO2 E DAS CONDIÇÕES DE ALARME DOIS MODOS DE IMPRESSÃO: RELATÓRIO E CONTÍNUO COMPATÍVEL COM IMPRESSORA MATRICIAL SAIDAS SERIAL E ANALÓGICA PADRÃO RS232 PARA COMPUTADORES OU ESTAÇÃO CENTRAL (SOFTWARE OPCIONAL) ALIMENTAÇÃO REDE ELÉTRICA - 110 A 220 VAC - 50/60HZ AUTOMÁTICA 50VA FONTE EXTERNA: 12 VDC (ESTABILIZADA) X 30W BATERIA: CHUMBO-ÁCIDO, 12 VDC/AH, RECARGA INTERNA E AUTOMÁTICA, USO APROXIMADO DE 8H PARA ECG QUANDO TOTALMENTE CARREGADA TEMPO DE RECARGA: 16 HORAS QUANDO TOTALMENTE DESCARREGADA DIMENSÕES ALTURA: 14,0 CM LARGURA: 22,8 CM PROFUNDIDADE: 21,0 CM PESO: 3,8 KG ESPECIFICAÇÃO AMBIENTAL TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 60°C TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 A 70°C? UMIDADE RELATIVA: 15 A</p>	UNID	80070219025	MD
---	--	------	-------------	----

2	0	2	R\$ 1.667,18	mil seiscentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos	R\$ 3.334,36	três mil, trezentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos
---	---	---	--------------	---	--------------	--


 Rubrica
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 243

8	ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL ASPIRADOR COM COMANDOS NA PARTE SUPERIOR; CAIXA DE PROTEÇÃO DO CONJUNTO DOMOTOR, EM PLÁSTICO RESISTENTE; RUIDO MENOR QUE 60 DBA; COM ALÇA, MONTADO EM MÓVEL DE ESTRUTURA METÁLICA APOIADA SOBRE QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS. REGISTRO DE AGULHA, EM AÇO INOX. VACUÔMETRO CALIBRADO ATÉ 29 POLHG (760 MMHG). SUPORTE PARA DUAS CÂNULAS. TAMPÃO DO FRASCO EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL. CONEXÃO TIPO "ENGATE RÁPIDO. SUPORTE PARA ATÉ DOIS FRASCOS COLETORES SUSPENSOS. ACOMPANHA: 02 FRASCOS COLETORES DE SECREÇÕES DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E A ALTAS TEMPERATURAS (121°C) EM PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 2,5 LITROS CADA, GRADUADO EM ALTO-RELEVO E PEDAL DE ACIONAMENTO. FLUXO DE AR: 0 A 24 LPM. VÁCUO: 0 A 22 POLHG / 560 MMHG. MEDIDAS EXTERNAS (LXPXH): 45 X 52 X 120 CM. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 127/220 V AC COM CHAVE DE COMUTAÇÃO. POTÊNCIA ELÉTRICA: 540 VA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CATÁLOGO DO PRODUTO.	UNID	81731740002	HR	3	0	3	R\$ 622,05	seiscentos e vinte e dois reais e cinco centavos	R\$ 1.866,15	mil oitocentos e sessenta e seis reais e quinze centavos
---	---	------	-------------	----	---	---	---	------------	--	--------------	--

VALOR TOTAL DO LOTE	R\$ 63.727,86 sessenta e três mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos
----------------------------	--

PRAZO DE ENTREGA: 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DATA DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.
PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESENTA) DIAS, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).
DECLARAÇÃO QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

FORTALEZA/CE, 13 DE FEVEREIRO DE 2023.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Rubrica
 Fis. 942m

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM
FORTIM/CE

PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2701.01/2023 - SMS/SRP/PE

ABERTURA: 13/02/2023

HORÁRIO: 08:30

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Pregão Eletrônico, que integram o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

Declaramos:

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens
Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de Tributação de Empresa de Pequeno Porte conforme estabelece Artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 28

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa nº	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
01	25	UND	DETECTOR FETAL PORTÁTIL	JUMPER/ ShenZhen Jumper Med. Equip. Co.,Ltd. - CHINA/ JPD-100B/ 80901110024	800,00	20.000,00
02	7	UND	NEGATOSCÓPIO PANORÂMICO 1 CORPO	METALIC/ Metalic Medical Prod. Hosp. Ltda. - EPP/ MT- 483/ ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA	600,00	4.200,00
03	25	UND	FOCO DE LUZ CLÍNICO E GINECOLÓGICO	MEDICATE/ DORJA IND. E COM. DE EQUIP.MÉD.LTDA - BRASIL/ 500L/ 10332170041	700,00	17.500,00
04	15	UND	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL (HOSPITAL)	CDS/ c.d.s. artef. de plast.e met. ltda- EPP/ 101/ 80917280001	800,00	12.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

05	4	UND	CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA (HOSPITAL)	CDS/ c.d.s. artef. de plast.e met. ltda- EPP/ 201/ 80917280002	600,00	2.400,00
06	40	UND	OXIMETRO DE DEDO COM TELA LED COLORIDA DE FÁCIL LEITURA, INDICADO PARA USO HOSPITALAR, COM INDICADOR DE PULSO. DOIS FORMATOS DE VISUALIZAÇÃO, FÁCIL USO, APENAS UM BOTÃO, UTILIZA 2 PILHAS ALCALINAS AAA, CORDÃO PARA MELHOR MOBILIDADE INDICAÇÃO DA CARGA DA BATERIA ALARME DE 02 ABAIXO DE 90%, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 08 SEGUNDOS DE INATIVIDADE, ALARME VISUAL E SONORO, DEVE POSSUIR BARRA LATERAL QUE GARANTE MAIOR PRECISÃO. CAPACIDADE DA BATERIA: PODE SER USADA POR 18 HORAS CONTINUAMENTE. DEVE ATENDER ÀS NORMAS NBR IEC 60601 -1 E 60601-1-2, APRESENTAR DOCUMENTO ANEXO A PROPOSTA. APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO DO FORNECEDOR, AUTORIZANDO O FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO.	YONKER/ XUZHOU YONG.ELECT.SCIENCE TECHN.CO., LTD- CHINA/ YK-81A/ 80901119010	200,00	8.000,00
07	2	UND	OXIMETRO DE MESA: TÉCNICAS DE ES+B430:B467PECTROFOTOMETRIA E PLETISMOGRAFIA MOSTRA OS VALORES-MEDIDAS DE SP02 E PULSO CURVA PLETISMOGRÁFICA, INDICA QUALIDADE DO SINAL PROCURANDO PULSO E PULSO FRACO FAIXA DE MEDIDAS SP02 0 A 100%, FAIXA SP02: ±2% 70 A 100%, FAIXA DE MEDIDAS PULSO: 30 A 254 BPM, PRECISÃO PULSO: ±3 BPM OU ±2% (A QUE FOR O MAIOR) ACESSÓRIOS 1 CABO DE FORÇA DE 3 PINOS (2,5M), 1 SENSOR DE DEDO ADULTO REUTILIZÁVEL (2,7M) 1 CERTIFICADO DE GARANTIA 1 MANUAL DO USUÁRIO ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTENSÃO DE SENSOR (1,5M) CONECTOR DB-9, SENSOR DE DEDO ADULTO REUTILIZÁVEL (1,2M) SENSOR DESCARTÁVEL ADULTO (0,6M) > 45KG SENSOR DESCARTÁVEL INFANTIL (0,6M) 15-45KG	EMAI/ TRANSMAI EQUIP.MÉD. HOSP. LTDA- BRASIL/ MX-300/ 80052640002	9.000,00	18.000,00

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten Signature]
Rubrica

		<p>SENSOR DESCARTÁVEL NEONATO (0,6M) <3KG SENSOR UNIVERSAL "Y" SENSOR DE ORELHA SENSOR REUTILIZÁVEL INFANTIL (46CM) 3 15KG SENSOR REUTILIZÁVEL NEONATO (46CM) <3KG ESPECIFICAÇÕES GERAIS CONGELAMENTO DA FORMA DE ONDA E SP02. MONITORAÇÃO NO MODO ADULTO E NEONATAL. AJUSTE DIGITAL DO CONTRASTE DO DISPLAY. CONTROLE DIGITAL DO VOLUME DO BIP DE PULSO E ALARMES. AJUSTE DE VELOCIDADE DE TRAÇADO PARA 25 OU 50 MM/S. AJUDA "ON-LINE" INDICAÇÃO DE CARREGAMENTO DE BATERIA, BATERIA FRACA, REDE ELÉTRICA OU SÓ BATERIA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NO CASO DE LIMITE MÍNIMO DE CARGA DE BATERIA. ALARMES ALARMES DE SITUAÇÃO PARA AUSÊNCIAS DE SENSOR DE OXIMETRIA, UMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PARA OXIMETRIA E PULSO INDICAÇÃO SONORA COM</p>			
		<p>3 TONS DIFERENTES E VOLUME AJUSTÁVEL DIGITALMENTE INDICAÇÃO VISUAL GRÁFICOS E TENDÊNCIAS TENDÊNCIA PARA VARIAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA E SP02 NAS ÚLTIMAS 72H VISUALIZAÇÃO EM INTERVALOS AJUSTÁVEIS DE 30 MIN., 1H, 2H, 3H, 6H, 12H, 32H, 64H ESCALA AUTOMÁTICA DE 0-MÁX. OU MIN MÁX SAÍDA PARA IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DOS VALORES DE SP02 E DAS CONDIÇÕES DE ALARME DOIS MODOS DE IMPRESSÃO; RELATÓRIO E CONTÍNUO COMPATÍVEL COM IMPRESSORA MATRICIAL SAÍDAS SERIAL E ANALÓGICA PADRÃO RS232 PARA COMPUTADORES OU ESTAÇÃO CENTRAL (SOFTWARE OPCIONAL)</p>			
		<p>ALIMENTAÇÃO REDE ELÉTRICA - 110 A 220 VAC - 50/60HZ AUTOMÁTICA 50VA FONTE EXTERNA: 12 VDC (ESTABILIZADA) X 30W BATERIA: CHUMBO- ÁCIDO, 12 VDC/AAH, RECARGA INTERNA E AUTOMÁTICA, USO APROXIMADO DE 8H PARA ECG QUANDO TOTALMENTE CARREGADA TEMPO DE RECARGA: 16 HORAS QUANDO TOTALMENTE DESCARREGADA DIMENSÕES ALTURA: 14,0 CM LARGURA: 22,8 CM PROFUNDIDADE: 21,0 CM PESO: 3,8 KG ESPECIFICAÇÃO AMBIENTAL TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 60°C TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 A 70°C? UMIDADE RELATIVA: 15 A 95% (OPERAÇÃO) 10 A 90% (ARMAZENAMENTO)</p>			

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

08	3	UND	ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL ASPIRADOR COM COMANDOS NA PARTE SUPERIOR; CAIXA DE PROTEÇÃO DO CONJUNTO DOMOTOR, EM PLÁSTICO RESISTENTE; RUÍDO MENOR QUE 60 DBA; COM ALÇA, MONTADO EM MÓVEL DE ESTRUTURA METÁLICA APOIADA SOBRE QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS. REGISTRO DE AGULHA, EM AÇO INOX. VACUÔMETRO CALIBRADO ATÉ 29 POLHG (760 MMHG). SUPORTE PARA DUAS CÂNULAS. TAMPÃO	ASCLÉPIOS/ Asclepios Equipamentos Hospitalares Eireli - BRASIL/ AS-100/ 81941119002	4.000,00	12.000,00
			DO FRASCO EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL. CONEXÃO TIPO "ENGATE RÁPIDO. SUPORTE PARA ATÉ DOIS FRASCOS COLETORES SUSPENSOS. ACOMPANHA: 02 FRASCOS COLETORES DE SECREÇÕES DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E A ALTAS TEMPERATURAS (121°C) EM PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 2,5 LITROS CADA, GRADUADO EM ALTO-RELEVO E PEDAL DE ACIONAMENTO. FLUXO DE AR: 0 A 24 LPM. VÁCUO: 0 A 22 POLHG / 560 MMHG. MEDIDAS EXTERNAS (LXPXH): 45 X 52 X 120 CM. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 127/220 V AC COM CHAVE DE COMUTAÇÃO. POTÊNCIA ELÉTRICA: 540 VA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CATÁLOGO DO PRODUTO.			
VALOR TOTAL DO LOTE POR EXTENSO: noventa e quatro mil e cem reais					TOTAL	94.100,00

Faturamento Mínimo R\$1.000,00 (mil reais)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: noventa e quatro mil e cem reais	TOTAL	94.100,00
---	--------------	------------------

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DECLARA, que:

- cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possuo 08 (oito) funcionários em minha empresa.

Pinhais, 13 de fevereiro de 2023.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

ACESSIBILIDADE (ACESSIBILIDADE) ALTO CONTRASTE
MAPA DO SITE (MAPA-DO-SITE)

ANVISA

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

(/)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 950
Rubrica
(/login)

Buscar no portal

✉ (<https://correlo.anvisa.gov.br/owa>)

Perguntas (perguntas-frequentes) | Legislação (legislacao) | Contato (contato) | Serviços (servicos) | Imprensa (area-de-imprensa)

MENU

Regularização de Produtos - Produtos para a Saúde

Produtos Não Regulados pela GGTPS/Anvisa


Atualizado em 01/10/2020

CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório
16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
17. Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
 - 23.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
24. Centrífuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)
 - 24.1 Centrífuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue



25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para uso em saúde
30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).
32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
36. Digestor
37. Diluidor de amostras
38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
41. Equipamento para gerenciamento de amostras
42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
45. Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
46. Evaporador centrífugo a vácuo
47. Fermentador de culturas
48. Filtro para soluções
49. Forno mufla
50. Fotômetro de chama
51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
55. Indicador físico, químico ou biológico
56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.
- 56.1 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)
57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
58. Lenço para assepsia da pele
59. Liofilizador
60. Luxímetro
61. Medidor de O2 dissolvido em amostras
62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
63. Medidor do ponto de fusão
64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
66. Mobiliário para laboratório
67. Moinho de amostras sólidas
68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
69. Montadores automáticos de lâminas e lamínulas
70. Navalhas para micrótomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Almofadas para cadeiras de rodas, exceto para prevenção de úlceras
2. Almotolia
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - 3.1. Condicionadores de ar



3. 2. Purificador de ar
3. 3. Esterilizador de ar
3. 4. Umidificador de ar
4. Babador de uso odontológico
5. Balde
6. Bandejas / Caixas / Estojos, inclusive para esterilização (Etiquetas para identificação de caixas/racks)
7. Barreira para separação de ambientes
 7. 1. Biombo
8. Bomba a vácuo
9. Caldeira
10. Caneta para marcação cirúrgica
11. Capa para colchão, poltronas e travesseiros
12. Capa para Equipamentos
13. Central de ar comprimido
14. Central de gases medicinais
15. Central de vácuo
16. Comadre/ cuba rim/ papagaio/ escarradeira
17. Compressor de ar
18. Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
19. Cortador de isopor para confecção de moldes
20. Dispositivo destruidor e inutilizador de produto médico / contador (agulhas, bisturis entre outros)
21. Dispositivo para abertura de frasco ampola
22. Dispositivo para abertura de produtos médicos
23. Embalagem para esterilização de produtos médicos
24. Embalagens para transporte e armazenamento de órgãos
25. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
 25. 1. Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
26. Equipamentos para Lavanderia
27. Escada para paciente, exceto indicada para terapia
28. Escova para limpeza de produtos em geral
29. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
30. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
31. Fogão para preparação de alimentos
32. Gel para absorção de resíduos orgânicos
33. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
34. Gerador de vapor
35. Gesso para confecção de modelo odontológico
36. Hamper (recipiente para acondicionamento de roupa hospitalar) e saco para hamper
37. Incinerador de resíduos hospitalares
38. Indicador físico, químico ou biológico
39. Lacres, tapetes, suportes, escovas para limpeza de instrumentais
40. Lona /dispositivo/campo para transferência de paciente
41. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
 41. 1. Mocho Odontológico ou cirúrgico.
 41. 2. Cadeiras de espera
 41. 3. Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
 41. 4. Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
 41. 5. Mesa de cabeceira Mesa para
 41. 6. Necrópsia
42. Negatoscópio
43. Papel higiênico / papel toalha
44. Pia hospitalar
45. Produto para coleta ou inutilização de materiais perfurocortantes
46. Protetor auricular de ruídos
47. Pulseiras de identificação de pacientes (incluindo pulseiras mãe-filho) e de classificação de risco, placas e outros produtos para tal finalidade
48. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
49. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
50. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
51. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
52. Régua endodôntica para medição de limas
53. Restritores utilizados na contenção do paciente
54. Roupa de cama, incluindo de uso hospitalar descartável
55. Saco para coleta de resíduos hospitalares
56. Sacos para óbito/ sacos para cadáver
57. Saltos ortopédicos
58. Secador de ar medicinal
59. Seladora de embalagens de produtos médicos
60. Sistema de comunicação hospitalar
61. Sistema de sinalização hospitalar
62. Dispensário Eletrônico utilizados para acondicionamento de medicamentos e materiais hospitalares

CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO

1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação
2. Bomba para dedetização
3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
4. Cronômetro
 - 4.1 Relógio para treinamento
5. Dardo
6. Dilatador nasal adesivo
7. Disco
8. Equipamentos passivos para condicionamento físico
 - 8.1 Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
 - 8.2 Halteres
 - 8.3 Estações de Musculação
 - 8.4 Remadores
 - 8.5 Aparelho para abdominais
 - 8.6 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
9. Mesa ou cadeira para massagem
10. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
11. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
12. Protetor não ortopédico de partes do corpo
13. Tablado (exceto para fisioterapia)
14. Vara para salto

CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

1. Absorvente higiênico
2. Alicata e tesoura para cortar unhas
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - 3.1 Condicionadores de ar
 - 3.2 Purificador de ar
 - 3.3 Esterilizador de ar
 - 3.4 Umidificador de ar
4. Balanças
5. Barbeador
6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
7. Brincos para perfuração
8. Chupeta
9. Coletor menstrual
10. Escova odontológica
11. Escova para cabelos
12. Esponja para limpeza de pele
13. Fio dental
14. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
15. Lente para ampliar escalas
16. Limpador de língua
17. Luvas sem indicação de uso em saúde
18. Mamadeira e bico
19. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
20. Massageador de gengiva
21. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
22. Mordedor para lactentes



23. Óculos para presbiopia
24. Papel higiênico/papel toalha
25. Passador de fio dental
26. Piercing
27. Pipetas e frascos de vidro para coleta, armazenamento e pasteurização de leite humano
28. Produto destinado à limpeza de lentes de óculos
29. Produto para estimulação sexual
30. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
31. Prótese mamária externa e sutiã para suporte da prótese
32. Protetor de mamilo
33. Purificador de água
34. Sauna
35. Secador e escova de cabelos
36. Top maternal, Sling

CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens, exceto os indicados para registro de sinais ou imagens médicas
6. Impressora, exceto as indicadas para registro de sinais ou imagens médicas
7. Monitor de vídeo, exceto as indicadas para exibição de imagens médicas
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, incluindo indicado para registro de sinais ou imagens médicas

CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE

CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteiras, provetas, tubos de ensaio, lâminulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcalinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnóstico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia
17. Fixadores celulares

Volta para o topo!

(<http://www.brasil.gov.br/>) Barra GovBr (<http://www.acessoinformacao.gov.br/>)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 953
[Handwritten Signature]
Rubrica



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

CNPJ 07.626.776/0001-60 **Autorização** 8.09.011-1

Produto Doppler Fetal

Modelo Produto Médico

JPD-100B

JPD-100E

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Doppler Fetal 100-E.pdf	4917517/22-2 - 08/11/2022 - 01:41
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Doppler feta JPD-100B.pdf	4917517/22-2 - 08/11/2022 - 01:41

Nome Técnico Monitor Fetal

Registro 80901110024

Processo 25351.012527/2020-80

Fabricante Legal

- FABRICANTE: ShenZhen Jumper Medical Equipment Co.,Ltd. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

Classificação de Risco II - MEDIO RISCO

Vencimento do Registro VIGENTE

[Exportar para Excel](#)
[Exportar para PDF](#)
[Voltar](#)

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa DORJA INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ 50.208.271/0001-05 **Autorização** 1.03.321-7

Produto Foco clinico medicate

Modelo Produto Médico

FOCO CLINICO MEDICATE 500L

FOCO CLINICO MEDICATE 500LE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual FOCO Rev.11.2020.pdf	1148071/22-9 - 16/03/2022 - 07:11

Nome Técnico Foco Cirurgico**Registro** 10332170041**Processo** 25351.729685/2015-14

Fabricante Legal

- FABRICANTE: DORJA INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - BRASIL

Classificação de Risco I - BAIXO RISCO**Vencimento do Registro** VIGENTE[Exportar para Excel](#)[Exportar para PDF](#)[Voltar](#)

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	c.d.s. artefatos de plasticos e metalicos ltda-EPP
CNPJ	67.065.110/0001-02
Autorização	8.09.172-8
Produto	CADEIRA DE RODAS

Modelo Produto Médico
Cadeira de Rodas com Apoio para Braços Removíveis - M2000 Pneus Infláveis
Cadeira de Rodas com Apoio para braços removíveis - M2000 Pneus Maciços
Cadeira de Rodas com as rodas Invertidas - Roda Invertida Pneus Infláveis
Cadeira de Rodas com as rodas Invertidas - Roda Invertida Pneus Maciços
Cadeira de Rodas com Regulagem de Altura para Pernas - 301 P Pneus Infláveis
Cadeira de Rodas com Regulagem de Altura para Pernas - 301 P Pneus Maciços
Cadeira de Rodas Econômica
Cadeira de Rodas em aço carbono rodas nylon - H10
Cadeira de Rodas em Alumínio Pneus Infláveis - Confort
Cadeira de Rodas em alumínio pneus Infláveis - Sol Plus
Cadeira de Rodas Infantil com Regulagem de Altura para Pernas - Repan
Cadeira de Rodas Infantil pneus infláveis - Recreio
Cadeira de Rodas Obeso - Max Obeso
Cadeira de Rodas Obeso pneus infláveis - 505
Cadeira de Rodas Pneus Infláveis - CDS 102
Cadeira de Rodas Pneus Maciços - CDS 101

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MUR -002 REV 03 de 22-09-2021 - Manual do Usuário Cadeira de Rodas.pdf	3979881211 - 08/10/2021 17:20:45
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MUR -003 REV 02 de 06-10-2021 - Manual do Usuário Cadeira de Rodas Alumínio.pdf	3979881211 - 08/10/2021 17:20:45
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MUR -004 REV 02 de 22-09-2021 - Manual do Usuário Cadeira de Rodas Infantil a fazer OK.pdf	3979881211 - 08/10/2021 17:20:45
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MUR -005 REV 02 de 06-10-2021 - Manual do Usuário Cadeira de Rodas Aro 06.pdf	3979881211 - 08/10/2021 17:20:45

Nome Técnico	Cadeira de Rodas
--------------	------------------

Registro	80917280001
Processo	25351449212201381
Fabricante Legal	c. d. s. artefatos de plasticos e metalicos Itda-EPP
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]

[Assinatura]
Rubrica

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	c.d.s. artefatos de plasticos e metalicos ltda-EPP
CNPJ	67.065.110/0001-02
Autorização	8.09.172-8
Produto	CADEIRA DE RODAS HIGIENICA

Modelo Produto Médico
Cadeira de Rodas HIGIÊNICA E BANHO - CDS 201
Cadeira de Rodas HIGIÊNICA E BANHO Braços Escamoteáveis - 201 Escam
Cadeira de Rodas HIGIÊNICA E BANHO compacta - 203
Cadeira de Rodas HIGIÊNICA E BANHO dobrável
Cadeira de Rodas HIGIÊNICA E BANHO pés Escamoteáveis - 202
Cadeira de Rodas HIGIÊNICA E BANHO Rodas aro 20" - 205

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MUB -001 REV 02 de 06-10-2021 - Manual do Usuário Cadeira de Banho.pdf	3979922219 - 08/10/2021 17:24:15

Nome Técnico	Cadeira de Rodas para Higienizacao
Registro	80917280002
Processo	25351445500201336
Fabricante Legal	c.d.s. artefatos de plasticos e metalicos ltda-EPP
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

CNPJ 07.626.776/0001-60 **Autorização** 8.09.011-1

Produto OXIMETRO DE PULSO / DEDO - YONKER

Modelo Produto Médico

YK-80A

YK-80C

YK-81A

YK-81B

YK-81C

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instrução de Uso.pdf	4745486/22-7 - 27/09/2022 - 02:50

Nome Técnico Oxímetro de Pulso

Registro 80901119010

Processo 25351.326647/2022-23

Fabricante Legal

- FABRICANTE: XUZHOU YONGKANG ELECTRONIC SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD (LEYE ROAD) - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
- FABRICANTE: XUZHOU YONGKANG ELECTRONIC SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

Classificação de Risco II - MEDIO RISCO

Vencimento do Registro VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar


COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis. 956V
Rubrica



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa TRANSMAI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 43.179.225/0001-60 **Autorização** 8.00.526-4

Produto OXIMETRO DE PULSO

Modelo Produto Médico

OX-P-10

MX-300

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual do Usuário OX-P-10- Rev2 .pdf	4303420/21-2 - 30/10/2021 - 08:28
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual do Usuário Oxímetro de Pulso MX-300 - Rev.5.pdf	4303420/21-2 - 30/10/2021 - 08:28

Nome Técnico Oxímetro de Pulso

Registro 80052640002

Processo 25351.024814/0107

Fabricante Legal

- FABRICANTE: TRANSMAI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL

Classificação de Risco III - ALTO RISCO

Vencimento do Registro 27/12/2026

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa Asclepios Equipamentos Hospitalares Eireli

CNPJ 33.068.320/0001-32 **Autorização** 8.19.411-1

Produto aspirador cirurgico

Modelo Produto Médico

ASPIRADOR CIRURGICO AS-100

ASPIRADOR CIRURGICO AS-200

ASPIRADOR CIRURGICO AS-300

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	ASC_AS_Rev.01 - Manual do Usuário Aspirador Cirúrgico modelos AS-100, AS-200 e AS-300.pdf	0092738/23-1 - 30/01/2023 - 02:07

Nome Técnico Aspirador Cirurgico

Registro 81941119002

Processo 25351.033793/2022-16

Fabricante Legal • FABRICANTE: Asclepios Equipamentos Hospitalares Eireli - BRASIL

Classificação de Risco II - MEDIO RISCO

Vencimento do Registro VIGENTE


Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar



COM/Fls. 958
RUBRICA

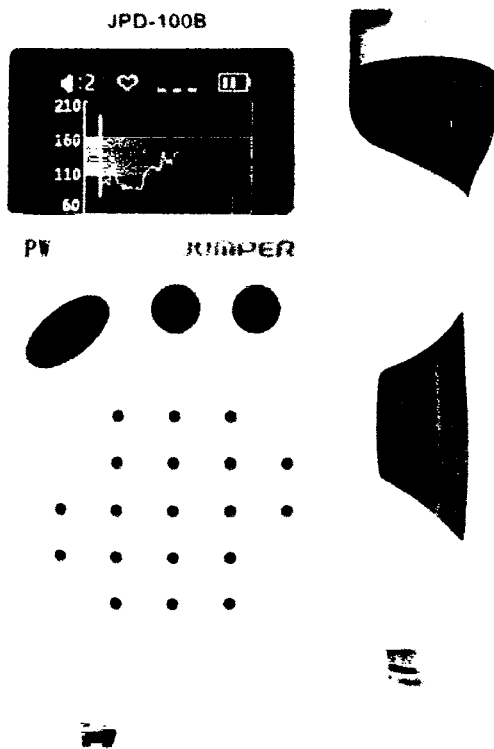

Características

- Modelo JPD 100B
- Faixa de medição FHR 30 - 240 bpm
- Sensibilidade 09 a 12 semanas de gestação
- Display LCD Screen
- Auto falante
- Transdutor 2.5 Mhz (com opção de 2 Mhz e 3 Mhz)
- Forma de exibição numérica e curva
- Transdutor plástico ABS
- Unidade principal plástico ABS
- Grau de proteção IPX4
- Saída para fone de ouvido, gravador de som ou computador
- Botão liga/desliga
- Desligamento automático após 1 minuto sem detecção
- Controle de volume
- Fonte de alimentação: pilhas AA ou bateria recarregável com carregador bivolt automático
- Dimensões 128mm x 91,5mm x 37,5mm
- USB
- Peso ±190 5g

Opcional

- Base de mesa
- Fone de ouvido
- Estojo

Acompanha

- 01 Transdutor
- 01 Manual de instruções

Certificados

- ABNT NBR IEC 60601-1: 2010 + Emenda IEC: 2012
- ABNT NBR IEC 60601-1 - 2: 2017
- ABNT NBR IEC 60601-1 - 6: 2011
- ABNT NBR IEC 60601-1 - 9: 2014
- ABNT NBR IEC 60601-1 - 2 - 37: 2016
- ANVISA: 80901110024



MT 483 - Negatoscopio Pintado 1 Corpo Bivolt

Descrição completa

MT483 - Negatoscopio pintado 1 Corpo bivolt

Estrutura confeccionada em chapa de aço carbono com 0,75mm de espessura.

Acabamento em pintura eletrostática Epóxi.

Painel frontal em acrílico branco translúcido leitoso de 3mm.

Prendedor de radiografias em aço inox.

Iluminação através de duas lâmpadas fluorescentes de 15 watts cada uma.

Luminosidade de 1500 lúmens, luz fria 6500K.

Reator eletrônico de partida rápida com frequência de 50/60 Hz

Acionamento através de interruptor (botão) liga / desliga.

Chave para seleção de voltagem em 110v ou 220v.

Cabo de alimentação tripolar com comprimento de 1m.

Consumo total de 30 watts.

Área de visualização: 0,35m largura x 0,42m altura.

Dimensões:

Largura: 0,38m

Altura: 0,50m

Profundidade (comprimento): 0,11m


medicate

Foco Clínico



Uso em clínicas e hospitais

Estética
Ginecologia
Otorrino
Oftalmologia
Urologia
Angiologia
Pequenas cirurgias

**Lâmpada de Led
Potência 5 watts**

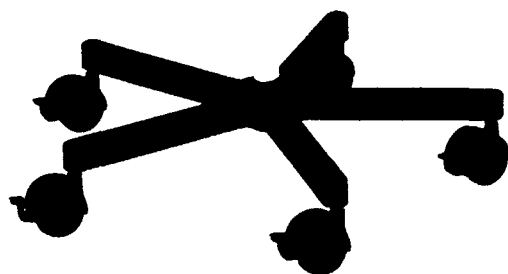

Melhor Luminosidade
Maior ângulo de movimentação
Autonomia (2 metros de fio)
Base com 5 pés e rodízio
Bivolt 127/220V~ bivolt
automático
Baixo consumo de energia

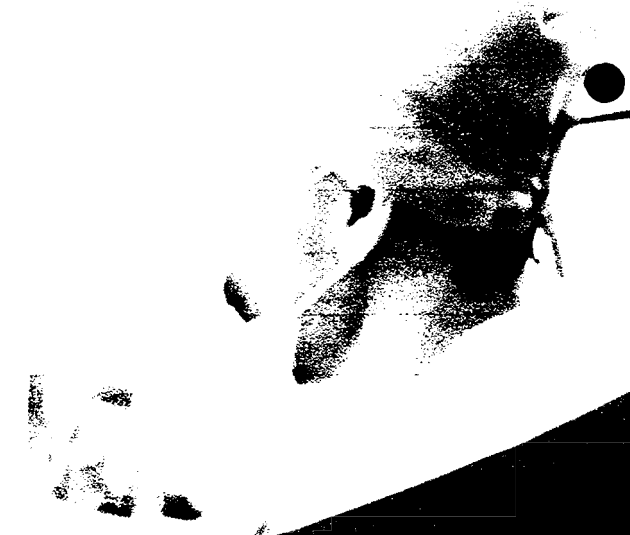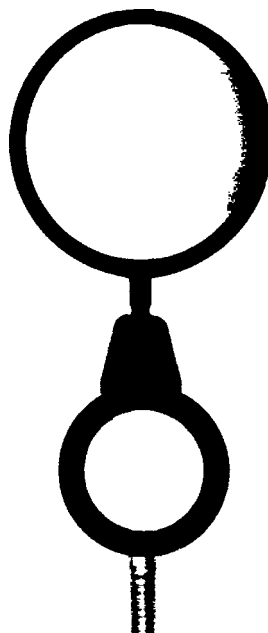


Saúde e Bem-Estar

medicate

Rubrica

Foco Clínico

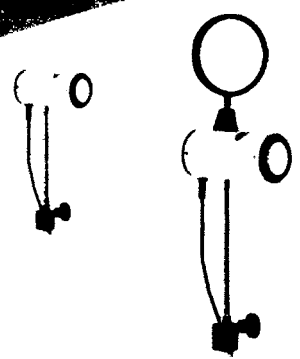


Regulagem de altura sem espelho
1,08 à 1,38 m

Regulagem de altura com espelho
1,24 à 1,54 m

Base com 5 pés e rodízio, 45x45 cm (maior estabilidade) com travas

Ref.: 500LE (com espelho)






Ref.: 500L

Uso em clínicas e consultórios
Design inovador e portátil
Leve e de fácil manuseio
Baixa emissão de calor
Potência 5 watts
Apoiado sobre rodízios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de proteção contra choque elétrico	Equipamento classe II
Grau de proteção contra choque elétrico	Parte aplicada Tipo B
Grau de proteção contra penetração nociva de água	IPX0
Grau de segurança de aplicação na presença de mistura anestésica inflamável com ar, oxigênio ou óxido nítrico	Não adequado
Modo de operação	Contínuo
Condições de resfriamento	Não há exigências de instalação de resfriamento
Funcionamento	Manual, controle pelo usuário
Tensão	127 / 220V~ bivolt automático
Frequência de operação	60 Hz
Lâmpada de Led	5W x127/220V~
Fusível	0,5A
Consumo de energia	127V~ 74mA / 220V~ 43mA
Dimensões com espelho	C: 1540 x L: 450 x A: 450 mm
Dimensões sem espelho	C: 1380 x L: 450 x A: 450 mm
Peso do aparelho com tripe	2,5 Kg
Registro da ANVISA	10332170041



Maior Luminosidade
Lâmpada de Led

Foco clínico com espelho (mod. 500LE)

Chave liga e Desliga e porta fusível

Produto Certificado INMETRO

Responsável Técnico:
Ricardo Nardelli Escobosa
CREA 0601694023
Validade indeterminada.

Garantia 12 meses contra defeito de fabricação

Assistência técnica permanente

REVENDEDOR AUTORIZADO



Indústria e Comércio de Equipamento Médico Ltda.
Itu - SP - São Paulo - CNPJ 50.208.271/0001-05
Sistema de Gestão da Qualidade Certificado NBR ISO 9001:2008 / NBR ISO 13485:2004

www.dorja.com.br

Handwritten signature




Cirúrgica São Felipe®
Produtos Para Saúde

Oxímetro de Pulso YK-80 - Yonker

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 960V

[Assinatura]
Rubrica

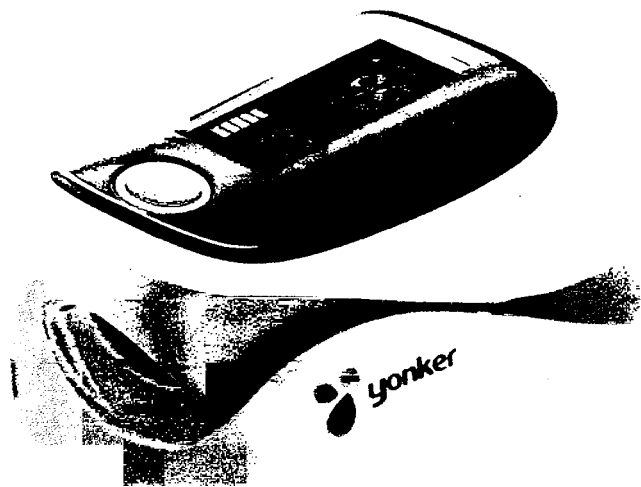

Especificações técnicas

Faixa de aplicação

YK - 81A - Adulto

YK - 80A - Infantil (circunferência de dedo a partir de 5mm)

SpO2

Faixa de medição 0 - 100%

Precisão: 70% - 100%: ± 2%

Resolução: 1%

Baixo desempenho de perfusão: PI: 0 - 20

Taxa de pulso

Faixa de medição 30 - 254 bpm

Precisão ±1bpm ou ±1%

Resolução 1bpm

Funções

OLED Dual Color exibe SpO2, PR, Forma de Onda, Barra de Pulso, Curva Pletismográfica

O visor possui 4 direções e 6 modos de exibição

Configuração de alarme de SpO2, taxa de pulso e funções de menu

Desligamento automático

Dimensão

58mm*36mm*32mm

Peso (sem bateria)

26.5g

Alimentação

2 pilhas alcalinas AAA

Condições de armazenamento

Temperatura de operação 5 - 40°C

Temperatura de armazenamento -20 - +55°C

Acompanha

01 Oxímetro

01 Cordão

01 Manual de instruções

Opcionais

Pilhas AAA

Bolsa

Capa de silicone

Case

Anvisa: 80901119010


www.cirurgicasaofelipe.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 96
me
Rubrica

Cardiologia

OXÍMETRO DE PULSO

MX300

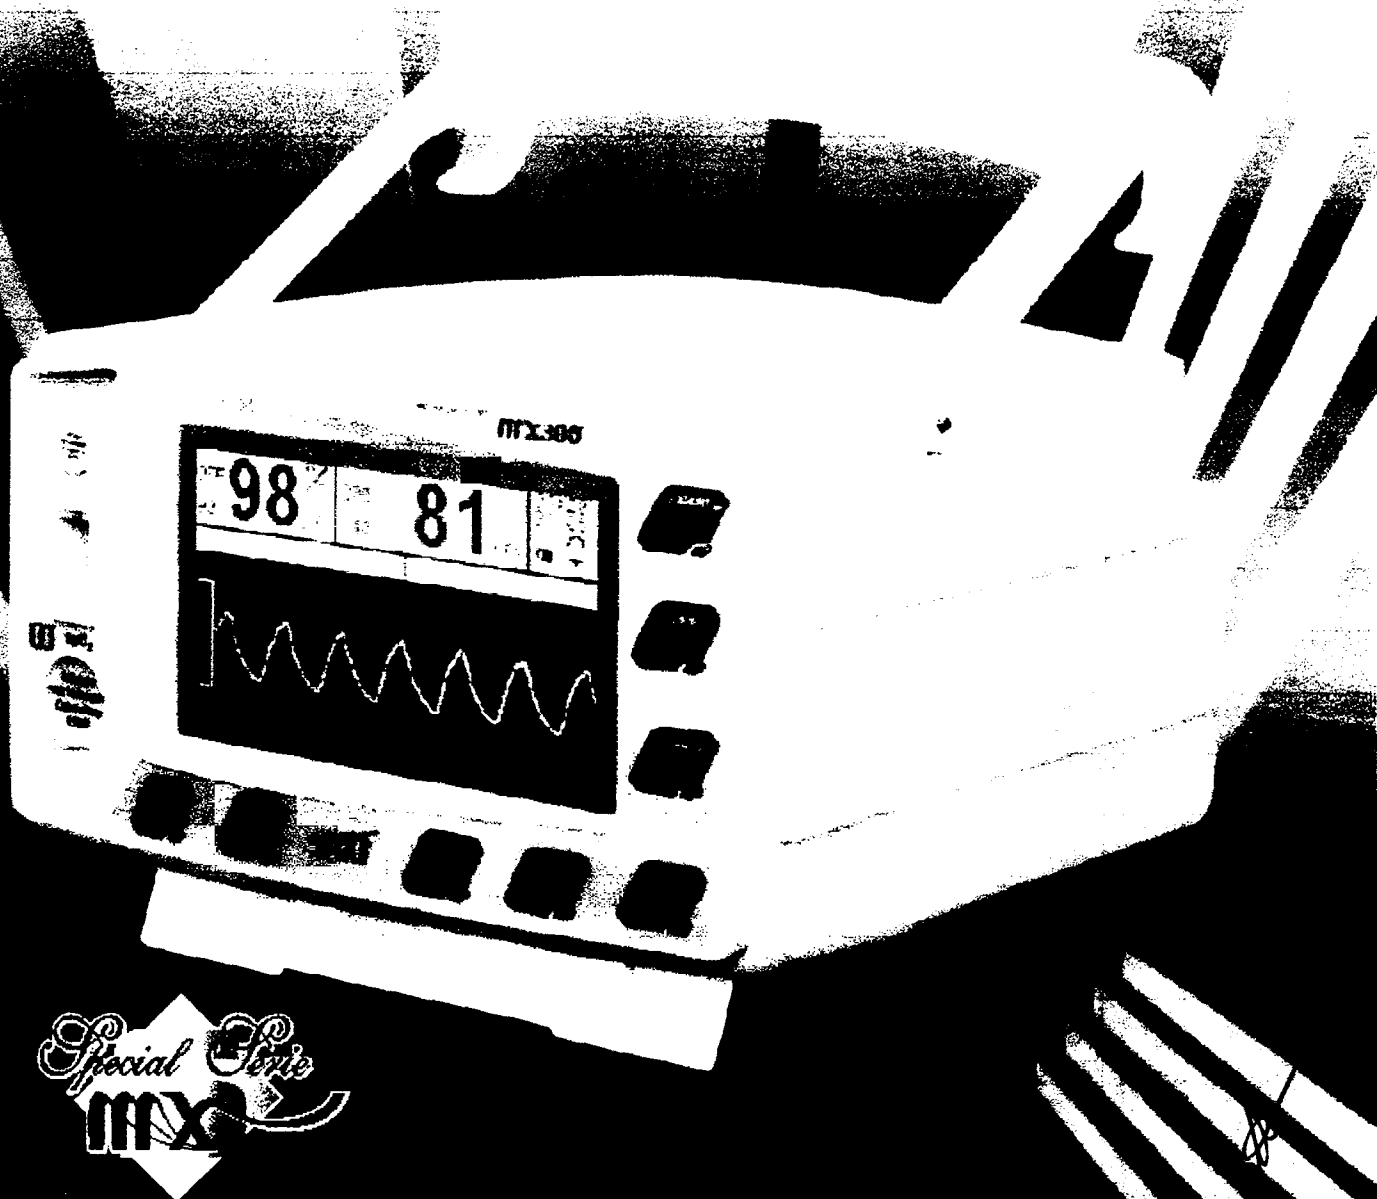

Special Serie
MX

- ✓ Tecnologia digital de ponta;
- ✓ Apresenta técnicas de Espectrofotometria e pletismografia;
- ✓ Mostra os valores medido de SpO₂ e pulso;
- ✓ Indica qualidade de sinal, procurando pulso e pulso fraco;
- ✓ Tela de LCD de 5 polegadas.

EMMAI
TRANSMAI

me

me

OXÍMETRO DE PULSO **MX300**

Com tecnologia digital de ponta, permite a monitoração constante do paciente, desde neonatal até adulto, inclusive aqueles com baixa perfusão periférica. Apresenta técnicas de Espectrofotometria e pletismografia. Mostra os valores medidos de SpO₂ e pulso, indica qualidade do sinal, procurando pulso e pulso fraco.

SpO₂

- ♥ Técnicas de espectrofotometria e pletismografia;
- ♥ Mostra os valores-medidas de SpO₂ e pulso;
- ♥ Curva Pletismográfica;
- ♥ Indica qualidade do sinal procurando pulso e pulso fraco;
- ♥ Faixa de medidas SpO₂: 0 a 100%
- ♥ Precisão SpO₂:
50 a 69 - ±3%
70 a 100% - ±2%
- ♥ Faixa de medidas Pulso: 30 a 254 bpm
- ♥ Precisão Pulso: ±2%.

ACESSÓRIOS

- ♥ 1 Cabo de força de 3 pinos (2,5m);
- ♥ 1 Sensor de dedo adulto reutilizável (2,7m) - SD-10;
- ♥ 1 Certificado de garantia;
- ♥ 1 Manual do usuário.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- ♥ Congelamento da forma de onda de e SpO₂;
- ♥ Monitoração no modo adulto e neonatal;
- ♥ Ajuste digital do contraste do display;
- ♥ Controle digital do volume do bip de pulso e alarmes;
- ♥ Ajuste de velocidade de traçado para 25 ou 50 mm/s;
- ♥ Ajuda "on-line";
- ♥ Indicação de carregamento de bateria, bateria fraca, rede elétrica ou só bateria;
- ♥ Desligamento automático no caso de limite mínimo de carga de bateria.

ALARMES

- ♥ Alarmes de situação para ausências de sensor de oximetria, limites máximos e mínimos para oximetria e pulso;
- ♥ Indicação sonora com 3 tons diferentes e volume ajustável digitalmente;
- ♥ Indicação visual.

GRÁFICO DE TENDÊNCIAS

- ♥ Tendência para variação da frequência cardíaca e SpO₂ nas últimas 72h;
- ♥ Visualização em intervalos ajustáveis de 30 min., 1h, 2h, 3h, 6h, 12h, 24h, 48h e 72h;
- ♥ Escala automática de 0-máx. ou min-máx.

SAÍDA PARA IMPRESSORA

- ♥ Para impressão dos valores de SpO₂ e das condições de alarme;
- ♥ Dois modos de impressão; relatório e contínuo;
- ♥ Compatível com impressora matricial (Padrão Epson).

ALIMENTAÇÃO

- ♥ Rede Elétrica - 110 a 230 Vac - 50/60Hz Automática;
- ♥ Fonte externa: 12 Vdc (estabilizada) x 30W;
- ♥ Bateria: chumbo-ácido, 12 Vdc/4Ah, recarga interna e automática, uso aproximado de 8h quando totalmente carregada;
- ♥ Tempo de Recarga: 16 horas quando totalmente descarregada.

DIMENSÕES

- ♥ Altura: 14,5 cm
- ♥ Largura: 23,0 cm
- ♥ Profundidade: 22,5 cm
- ♥ Peso: 3,18 Kg

OPCIONAIS


- ♥ Extensão de sensor (1,5m) com conector - DB-9 - ES-10
- ♥ Sensor de dedo adulto reutilizável (1,2m) - 3044
- ♥ Sensor descartável adulto (0,6m) > 45kg - 1300
- ♥ Sensor descartável infantil (0,6m) 15-45kg - 1303
- ♥ Sensor descartável neonato (46cm) <3kg - 3026
- ♥ Sensor universal "Y" - SY-10
- ♥ Sensor de orelha - SO-10
- ♥ Sensor reutilizável infantil (46cm) 3-15kg - 3178
- ♥ Sensor reutilizável neonato (0,6cm) <3kg - 1302

EMAI
TRANSMAI

Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.

Av. Maria Estela, 33 - Jardim Maria Estela
☎ (0**11) 2335-1000 - Fax: Ramal 210 - CEP 04180-010 - São Paulo - Brasil
www.transmai.com.br - e-mail: vendas@transmai.com.br

Registro na ANVISA nº 80052640002

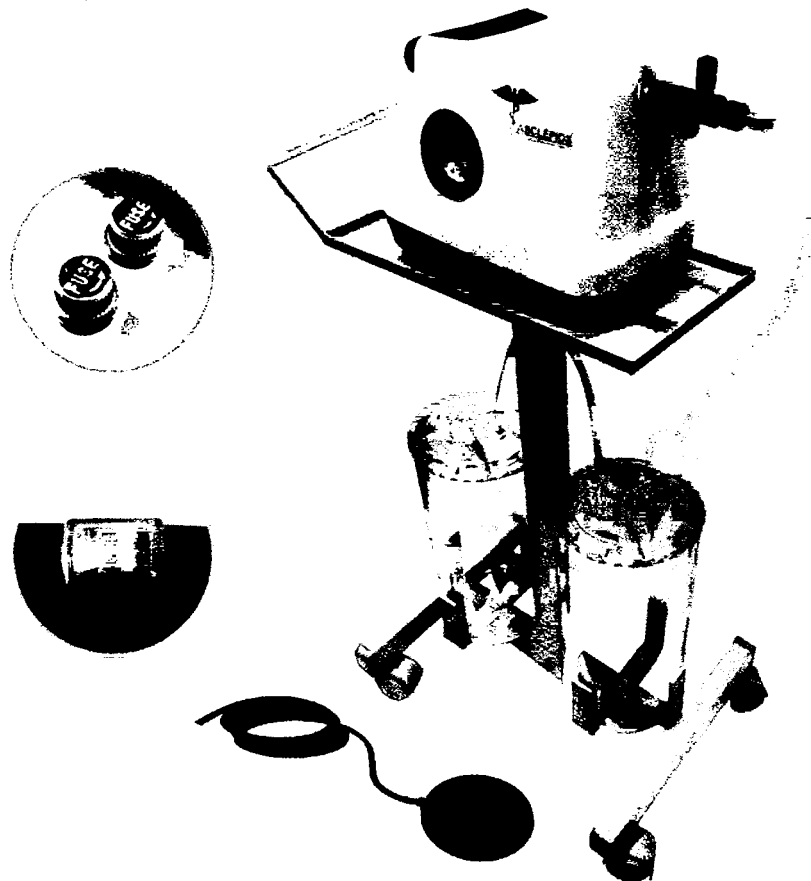

Modelos: AS-100 35L/min AS-200 45L/min AS-300 60L/min

O aspirador cirúrgico é indicado para aspirar sangue/secreções, podendo ser utilizado em hospitais, clínicas, consultórios odontológicos, ambulâncias entre outros.

O equipamento produz vácuo através do acionamento do compressor de diafragma ou pistão.

Cânula atóxica e biocompatível conforme NBR ISO 10993-1, com formato anatômico com furação de controle próxima a empunhadura.

Frasco e tampa reutilizáveis e autoclaváveis à 134°C.

Totalmente isento de óleo com baixo ruído.

Vacuômetro com faixa de leitura 0 à -30polHg/ 0 à -760mmHg.

Potência do motor: 1/4CV

Alça para transporte.

Alimentação bivolt (127/220V ± 10%) - seleção automática.

Acionamento por botão liga/desliga.

Grau de proteção IP22

Acessórios:

- 01 Cânula de uso único produzida em Poliestireno (PS).
- 01 Frasco de vidro ou policarbonato graduado, com capacidade de 5 litros.
- 01 Tampa com válvula de segurança anti-transbordamento.
- 01 Mangueira com filtro hidrofóbico;
- 01 Mangueira autoclavável
- 01 Filtro interno;
- 01 Cabo de alimentação padrão IEC.
- 02 Fusíveis extras;
- 01 Manual de operação
- 01 Certificado de garantia.

Opcionais:

- Pedal para acionamento contínuo/intermitente IPX8.
- Suporte para frasco, com alça e rodízios.
- Frascos coletores de vidro de 2 litros ou 5litros.
- Frascos de policarbonato (inquebrável) de 5 litros.

Arvisa 81941119002

Fabricado de acordo com as normas aplicáveis:

- ABNT NBR IEC 60601-1-2:2016 • ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017
- ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 • ABNT NBR IEC 60601-1-9:20

** Para processos licitatórios, o Fabricante informa que os acessórios serão fornecidos de acordo com o exposto em sua proposta comercial.



Handwritten signature or mark.



COMISSÃO DE
Fls. 9

CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado nº: NCC 22.09415 Revisão/revision nº.: 00
Data de emissão: 11/08/2022 Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3
Emission date: 11/08/2022 Certificate valid only accompanied of pages 1 through 3

Data de validade: Indeterminada
Validity date:

Solicitante: Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde Eireli.
Applicant: Rua Graça Aranha, 875, Barracão 2 Sala C, Vargem Grande
CEP: 83321-020 - Pinhais/PR - Brasil
CNPJ: 07.626.776/0001-60

Produto: Oxímetro de Pulso
Product:

Marca / Modelo: Yonker / YK-80A, YK-80C, YK-81A, YK-81B, YK-81C
Brand / Model:

Fabricante (Fabricante legal): Xuzhou Yongkang Electronic Science Technology Co., Ltd.
Manufacturer (Legal manufacture): 1st & 2nd Floor, 6# Building, 1st Phase Economic Development Manufacturing Zone, LIANDO U Valley, 6# Leye Road, Xuzhou ETDZ, China

Unidade fabril: Xuzhou Yongkang Electronic Science Technology Co., Ltd.
Manufacturing location: 4F Building C8, 40 Jingshan Road, Economic and Technological Development Zone, 221000 Xuzhou, China

Assinado de forma digital por WILSON
MONTEIRO BONATO JUNIOR:04261009803

Wilson Bonato
Gerente Técnico
Technical Manager

Certificado emitido conforme, requisitos de avaliação da conformidade para equipamentos sob regime de vigilância sanitária, anexo à Portaria Inmetro nº 384, de 18 de dezembro de 2020.
Certificate issued in accordance with the conformity assessment requirements equipment under sanitary surveillance system, annex to Inmetro's ordinance no. 384 of December 18, 2020.

1. Este certificado somente pode ser reproduzido com todas as folhas.
This certificate may only be reproduced with all its pages.
2. A situação e autenticidade deste certificado podem ser verificadas no website oficial do Inmetro.
The status and authenticity of this certificate may be verified by visiting Inmetro's website.
3. Este certificado de conformidade foi emitido por um organismo de certificação acreditado pela Cgcre - Coordenação Geral de Acreditação.
This certificate of conformity was issued by a product certification body accredited by Cgcre.

Certificado emitido por:
Certificate issued by:

NCC Certificações do Brasil Ltda.
Acreditação Cgcre nº 0034 (16/10/2003)
Av. Orosimbo Maia, 360, Campinas, SP, CEP 13010-211
CNPJ nº 16.587.151/0001-28
www.nccgroup.com.br





CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
 EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
 CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

[Handwritten Signature]
Rubrica

Certificado Nº: NCC 22.09415
 Certificate No.

Revisão/revision nº.: 00

Data de emissão: 11/08/2022
 Emission date:

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3
 Certificate valid only accompanied of pages 1 through 3

Este certificado é emitido como uma verificação que amostras, representativas da linha de produção, foram avaliadas e ensaiadas e atenderam às normas listadas abaixo, e que o sistema de gestão da qualidade do fabricante, relativo aos produtos cobertos por este certificado, foi avaliado e atendeu aos requisitos de sistema da qualidade da Portaria Inmetro. Este certificado é concedido sujeito às condições previstas na Portaria Inmetro.

This certificate is issued as verification that samples, representative of production, were assessed and tested and found to comply with the standards listed below and that the manufacturer's quality system, relating to the products covered by this certificate, was assessed and found to comply with the Inmetro quality system requirements. This certificate is granted subject to the conditions as set out in Inmetro Rules.

**NORMAS:
 STANDARDS:**

- ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016
- ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017
- ABNT NBR IEC 60601-1-6:2013 + Emenda 1:2020
- ABNT NBR IEC 60601-1-9/2010 + Emenda1: 2014
- IEC 60601-1-11:2015
- IEC 60601-2-61:2017

Este certificado não indica conformidade com outros requisitos de segurança e desempenho do que os expressamente incluídos nas normas listadas acima.

This certificate does not indicate compliance with safety and performance requirements other than those expressly included in the standards listed above

**RELATÓRIOS DE ENSAIO E AVALIAÇÃO:
 TEST AND ASSESSMENT REPORTS:**

Amostras do equipamento listado passaram com sucesso nas avaliações e ensaios registrados em:
 Samples of the equipment listed has successfully met the assessment and test requirements as recorded in:

Registro de avaliação da conformidade técnica (apresenta a verificação dos documentos utilizados para análise e as conclusões para a recomendação da certificação):

Technical conformity assessment register (assessment that presents the verification of the documents used for analysis and recommendation of certification conclusions):

FLUIG: 70071
 Processo: 66042/21.1
 Data do aceite da proposta: 14/07/2021
 Data da auditoria: 31/12/2021

**Relatório(s) de ensaio:
 Test report(s):**

Nº do relatório	Norma	Laboratório	Data de emissão
CSTSM20100019	IEC 60601-1: 2005 + CORR. 1:2006 + CORR. 2:2007 + A1:2012	CCIC Huatongwei International Inspection (Suzhou) Co.,Ltd	10/11/2020
CSTEM20110002	IEC 60601-1-2:2014, ISO 80601-2-61:2017 clause 202	CCIC Huatongwei International Inspection (Suzhou) Co.,Ltd	09/11/2020
701982066201-13-0	IEC/EN 60601-1-11: 2015	Tüv Süd Certification and Testing (China) Co., Ltd	25/12/2020
SHT2202045401SM	IEC 60601-1-11:2015 (shock and vibration tests)	Shenzhen Huatongwei International Inspection Co., Ltd	01/03/2022
CSTSM20100017	IEC/EN 60601-1-11: 2015	CCIC Huatongwei International Inspection (Suzhou) Co.,Ltd	10/11/2020
701982066201-14-0	ISO 80601-2-61: 2017	CCIC Huatongwei International Inspection (Suzhou) Co.,Ltd	25/12/2020

**PRODUTO:
 PRODUCT:**

Produtos e sistemas abrangidos por este certificado estão especificados como segue:
 Products and systems covered by this certificate are specified as follows:

O oxímetro de pulso pode ser usado para medir a saturação de hemoglobina humana e a taxa de pulso através do dedo, pode ser usado em hospitais, domicílio, escolas, centros desportivos e centros médicos.


Características técnicas da Família:

Modelos	Tensão	Frequência	Potência/Corrente	Marca
YK-80A, YK-80C, YK-81A, YK-81B, YK-81C	3 VDC (2 Pilhas AAA)	-	-	Yonker

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº: NCC 22.09415 Revisão/revision nº.: 00
Certificate No.

Data de emissão: 11/08/2022 Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3
Emission date: Certificate valid only accompanied of pages 1 through 3

CONDIÇÕES DE CERTIFICAÇÃO:
CONDITIONS OF CERTIFICATION:

Modelo 5: Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no comércio e no fabricante. Modelo baseado no ensaio de tipo e acompanhado de avaliação das medidas tomadas pelo fabricante para o Sistema de Gestão da Qualidade de sua produção, seguido de um acompanhamento a cada 15 meses, por meio de auditorias, do controle da qualidade da fábrica e de ensaios de verificação em amostras tomadas no comércio e na fábrica.

Model 5: Type test, evaluation and approval of the manufacturer's Quality Management System, surveillance through audits on the factory and test on samples taken in market and on the manufacturer. Model based on the type of test and accompanied by evaluation of the actions taken by the manufacturer for the Quality Management System of its production, followed by a follow-up every 15 months by means of audits of the factory quality control and test checks in samples taken in market and factory.

A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NCC e previstas no RAC específico da Portaria Inmetro nº. 384, de 18 de dezembro de 2020. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

The validity of this certificate is linked to carrying out evaluations of maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the orientations of the NCC and Inmetro Ordinance no. 384 of December 18, 2020. For verification of updated condition of regularity from this Conformity's Certificate, must be checked on product and services data bank certificated from Inmetro.

Este Certificado é válido apenas para os equipamentos de modelos idênticos aos equipamentos efetivamente ensaiados. Quaisquer modificações nos projetos, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos pela documentação descritiva dos equipamentos, sem a prévia autorização da NCC, invalidarão este Certificado.

This Certificate is valid only for models identical to those effectively tested. Any modifications to the projects and the use of components and / or different materials from those defined by descriptive documentation of the equipment, without the prior permission of NCC, will invalidate this certificate.

O usuário tem a responsabilidade de assegurar que os produtos serão instalados em atendimento às instruções do fabricante e as normas aplicadas a estes.

The user has the responsibility to ensure that the products will be installed in compliance with manufacturer's instructions and standards applied to them.

Outras especificações:

Tipo de proteção contra choque elétrico: Energizado internamente

Grau de proteção contra choque elétrico: parte aplicada tipo BF

Grau de proteção contra penetração de líquidos: IP22

Modo de operação: Contínuo

Não adequado na presença de mistura anestésica inflamável

Versão do software: V1.0.1

Lista dos acessórios e partes ensaiados em conjunto com o produto: N/A

Código de barras:

YK-80A:6921745201368

YK-80C:6921745201122

YK-81A:6921745201191

YK-81B:6921745201375

YK-81C:6921745200255

DOCUMENTAÇÃO DESCRITIVA DO EQUIPAMENTO (CONFIDENCIAL):
EQUIPMENT DESCRIPTIVE DOCUMENTS (CONFIDENTIAL):

Documento	Descrição	Revisão
IFU-FPO	Manual do usuário - YK-80A, YK-80C, YK-81A, YK-81B, YK-81C	1.2
K/JS-7.3-001	Projeto do produto avaliado - YK-80A, YK-80C, YK-81A, YK-81B, YK-81C	A01

Histórico da Revisão:

Revisão	Certificado	Data da Revisão	Processo	Descrição
0	NCC 22.09415	11/08/2022	66042/21.1	Emissão inicial

Rúbrica

FORTALEZA-CE, 13 DE FEVEREIRO 2023.

AO GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM/CE
ATT.: AO PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: PROPOSTA DE PREÇO

PREZADOS SENHORES;
APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2701.01/2023, REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CEARÁ.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2701.01/2023 DATA DE ABERTURA 13 DE FEVEREIRO AS 10:30HRS.

PREZADOS SENHORES,

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

PROPOSTA DE PREÇO

lic. n.º

LOTE 28 - PERMANENTE III										
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD. HOSPITAL	QTD. ATENÇÃO BÁSICA	QTD TOTAL	MARCA	V. UNITÁRIO		V. TOTAL	
1	DETECTOR FETAL PORTÁTIL	Unidade	1	24	25	MD	R\$ 1.353,60	mil trezentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos	R\$ 33.840,00	trinta e três mil, oitocentos e quarenta reais
2	NEGATOSCÓPIO PANORÂMICO 1 CORPO	Unidade	1	6	7	MODELO MOVEIS	R\$ 2.145,00	dois mil, cento e quarenta e cinco reais	R\$ 15.015,00	quinze mil e quinze reais
3	FOCO DE LUZ CLÍNICO E GINECOLÓGICO	Unidade		25	25	MIKATOS	R\$ 1.110,00	mil cento e dez reais	R\$ 27.750,00	vinte e sete mil, setecentos e cinquenta reais
4	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL (HOSPITAL)	Unidade	5	10	15	CAROE=NE	R\$ 1.170,00	mil cento e setenta reais	R\$ 17.550,00	dezessete mil, quinhentos e cinquenta reais
5	CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA (HOSPITAL)	Unidade	4		4	CARONE	R\$ 528,00	quinhentos e vinte e oito reais	R\$ 2.112,00	dois mil, cento e doze reais
6	OXÍMETRO DE DEDO COM TELA LED COLORIDA DE FÁCIL LEITURA, INDICADO PARA USO HOSPITALAR, COM INDICADOR DE PULSO. DOIS FORMATOS DE VISUALIZAÇÃO, FÁCIL USO, APENAS UM BOTÃO, UTILIZA 2 PILHAS ALCALINAS AAA, CORDÃO PARA MELHOR MOBILIDADE INDICAÇÃO DA CARGA DA BATERIA ALARME DE O2 ABAIXO DE 90%, DESLIGAMEN	Unidade	15	25	40	CBEMED	R\$ 300,00	trezentos reais	R\$ 12.000,00	doze mil reais
7	OXÍMETRO DE MESA: TÉCNICAS DE ES+B430:B467PECTROFOTOMETRIA E PLETISMOGRAFIA MOSTRA OS VALORES-MEDIDAS DE SPO2 E PULSO CURVA PLETISMOGRÁFICA, INDICA QUALIDADE DO SINAL PROCURANDO PULSO E PULSO FRACO FAIXA DE MEDIDAS SPO2 0 A 100%, FAIXA SPO2: ±2% 70 A 100%, FAIXA DE MEDIDAS PULSO: 30 A 254 BPM. PRE	Unidade	2		2	MD	R\$ 3.300,00	três mil e trezentos reais	R\$ 6.600,00	seis mil e seiscentos reais
8	ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL ASPIRADOR COM COMANDOS NA PARTE SUPERIOR; CAIXA DE PROTEÇÃO DO CONJUNTO DOMOTOR, EM PLÁSTICO RESISTENTE; RUIDO MENOR QUE 60 DBA; COM ALÇA, MONTADO EM MÓVEL DE ESTRUTURA METÁLICA APOIADA SOBRE QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS. REGISTRO DE AGULHA, EM AÇO INOX. VACUÔMETRO CALIBRA	Unidade	3		3	DORMED	R\$ 1.320,00	mil trezentos e vinte reais	R\$ 3.960,00	três mil, novecentos e sessenta reais
									LOTE 06 R\$	118.827,00

cento e dezoito mil, oitocentos e vinte e sete reais

VALOR TOTAL DOS LOTES	R\$	118.827,00
cento e dezoito mil, oitocentos e vinte e sete reais		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NOS PREÇOS OFERECIDOS ESTAO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO, TRIBUTOS, DESLOCAMENTO DE PESSOAL E DEMAIS ONUS PERTINENTES A CONTRATAÇÃO.

DECLARAMOS AINDA QUE, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA ENTREGA DOS PRODUTOS, E QUE SERAO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICIA E CONTRATUAL, E QUE SERAO INCIADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À EPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXO

DECLARAMOS QUE NOS VALORES APRESENTADOS EM NOSSA PROPOSTA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, SEGUROS, DESLOCAMENTO DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

FORTALEZA/CE, 13 DE FEVEREIRO DE 2023.

me

[Handwritten mark]

Arac
 Rubrica

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2701.01/2023-SMS/SRP

DISPUTA DE LANCES: 13/02/2023 ÀS 10H30

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CEARÁ.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 28 - PERMANENTE III							
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTDE	VL.UNIT.	VL.TOTAL
28	1	DETECTOR FETAL PORTÁTIL	UND	MD	25	R\$ 2.205,00	R\$ 55.125,00
28	2	NEGATOSCÓPIO PANORÂMICO 1 CORPO	UND	ESSENCE DENTAL	7	R\$ 2.535,00	R\$ 17.745,00
28	3	FOCO DE LUZ CLÍNICO E GENECOLÓGICO	UND	MEDPEJ	25	R\$ 1.812,00	R\$ 45.300,00
28	4	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL (HOSPITAL)	UND	CARONE	15	R\$ 1.534,02	R\$ 23.010,30
28	5	CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA (HOSPITAL)	UND	CARONE	4	R\$ 905,40	R\$ 3.621,60
28	6	OXÍMETRO DE DEDO COM TELA LED COLORIDA DE FÁCIL LEITURA, INDICADO PARA USO HOSPITALAR, COM INDICADOR DE PULSO. DOIS FORMATOS DE VISUALIZAÇÃO, FÁCIL USO, APENAS UM BOTÃO, UTILIZA 2 PILHAS ALCALINAS AAA, CORDÃO PARA MELHOR MOBILIDADE INDICAÇÃO DA CARGA DA BATERIA ALARME DE O2 ABAIXO DE 90%, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 08 SEGUNDOS DE INATIVIDADE, ALARME VISUAL E SONORO, DEVE POSSUIR BARRA LATERAL QUE GARANTE MAIOR PRECISÃO. CAPACIDADE DA BATERIA: PODE SER USADA POR 18 HORAS CONTINUAMENTE. DEVE ATENDER ÀS NORMAS NBR IEC 60601-1 E 60601-1-2. APRESENTAR DOCUMENTO ANEXO A PROPOSTA. APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO DO FORNECEDOR, AUTORIZANDO O FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO.	UND	GTECH	40	R\$ 303,51	R\$ 12.140,40
28	7	OXÍMETRO DE MESA: TÉCNICAS DE ES+B430:B467 PECTROFOTOMETRIA E PLETISMOGRAFIA MOSTRA OS VALORES-MEDIDAS DE SPO2 E PULSO CURVA PLETISMOGRÁFICA, INDICA QUALIDADE DO SINAL PROCURANDO PULSO E PULSO FRACO FAIXA DE MEDIDAS SPO2 0 A 100%, FAIXA SPO2: ±2% 70 A 100%, FAIXA DE MEDIDAS PULSO: 30 A 254 BPM, PRECISÃO PULSO: ±3 BPM OU ±2% (A QUE FOR O MAIOR) ACESSÓRIOS 1 CABO DE FORÇA DE 3 PINOS (2,5M), 1 SENSOR DE DEDO ADULTO REUTILIZÁVEL (2,7M) 1 CERTIFICADO DE GARANTIA 1 MANUAL DO USUÁRIO ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTENSÃO DE SENSOR (1,5M) CONECTOR DB-9, SENSOR DE DEDO ADULTO REUTILIZÁVEL (1,2M) SENSOR DESCARTÁVEL ADULTO (0,6M) > 45KG SENSOR DESCARTÁVEL INFANTIL (0,6M) 15-45KG SENSOR DESCARTÁVEL NEONATO (0,6M) <3KG SENSOR UNIVERSAL "Y7" SENSOR DE ORELHA SENSOR REUTILIZÁVEL INFANTIL (46CM) 3 15KG SENSOR REUTILIZÁVEL NEONATO (46CM) <3KG ESPECIFICAÇÕES GERAIS CONGELAMENTO DA FORMA DE ONDA E SPO2. MONITORAÇÃO NO MODO ADULTO E NEONATAL. AJUSTE DIGITAL DO CONTRASTE DO DISPLAY. CONTROLE DIGITAL DO VOLUME DO BIP DE PULSO E ALARMES. AJUSTE DE VELOCIDADE DE TRAÇADO PARA 25 OU 50 MM/S. AJUDA "ON-LINE" INDICAÇÃO DE CARREGAMENTO DE BATERIA, BATERIA FRACA, REDE ELÉTRICA OU SÓ BATERIA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NO CASO DE LIMITE MÍNIMO DE CARGA DE BATERIA. ALARMES ALARMES DE SITUAÇÃO PARA AUSÊNCIAS DE SENSOR DE OXIMETRIA, LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PARA OXIMETRIA E PULSO INDICAÇÃO SONORA COM 3 TONS DIFERENTES E VOLUME AJUSTÁVEL DIGITALMENTE INDICAÇÃO VISUAL GRÁFICOS E TENDÊNCIAS TENDÊNCIA PARA VARIAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA E SPO2 NAS ÚLTIMAS 72H VISUALIZAÇÃO EM INTERVALOS AJUSTÁVEIS DE 30 MIN., 1H, 2H, 3H, 6H, 12H, 32H, 64H ESCALA AUTOMÁTICA DE 0-MÁX. OU MIN MÁX SAIDA PARA IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DOS VALORES DE SPO2 E DAS CONDIÇÕES DE ALARME DOIS MODOS DE IMPRESSÃO; RELATÓRIO E CONTÍNUO COMPATÍVEL COM IMPRESSORA MATRICIAL SAIDAS SERIAL E ANALÓGICA PADRÃO RS232 PARA COMPUTADORES OU ESTAÇÃO CENTRAL (SOFTWARE OPCIONAL) ALIMENTAÇÃO REDE ELÉTRICA - 110 A 220 VAC - 50/60HZ AUTOMÁTICA 50VA FONTE EXTERNA: 12 VDC (ESTABILIZADA) X 30W BATERIA: CHUMBO-ÁCIDO, 12 VDC/AAH, RECARGA INTERNA E AUTOMÁTICA, USO APROXIMADO DE 8H PARA ECG QUANDO TOTALMENTE CARREGADA TEMPO DE RECARGA: 16 HORAS QUANDO TOTALMENTE DESCARREGADA DIMENSÕES ALTURA: 14,0 CM LARGURA: 22,8 CM PROFUNDIDADE: 21,0 CM PESO: 3,8 KG ESPECIFICAÇÃO AMBIENTAL TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 60°C TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 A 70°C UMIDADE RELATIVA: 15 A 95% (OPERAÇÃO) 10 A 90% (ARMAZENAMENTO)	UND	MD	2	R\$ 19.475,25	R\$ 38.950,50
28	8	ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL ASPIRADOR COM COMANDOS NA PARTE SUPERIOR; CAIXA DE PROTEÇÃO DO CONJUNTO DOMOTOR, EM PLÁSTICO RESISTENTE; RUIDO MENOR QUE 60 DBA; COM ALÇA, MONTADO EM MÓVEL DE ESTRUTURA METÁLICA APOIADA SOBRE QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS. REGISTRO DE AGULHA, EM AÇO INOX. VACUÔMETRO CALIBRADO ATÉ 29 POLHG (760 MMHG). SUPORTE PARA DUAS CÂNULAS. TAMPÃO DO FRASCO EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL. CONEXÃO TIPO "ENGATE RÁPIDO. SUPORTE PARA ATÉ DOIS FRASCOS COLETORES SUSPENSOS. ACOMPANHA: 02 FRASCOS COLETORES DE SECREÇÕES DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E A ALTAS TEMPERATURAS (121°C) EM PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 2,5 LITROS CADA, GRADUADO EM ALTO-RELEVO E PEDAL DE AÇONAMENTO. FLUXO DE AR: 0 A 24 LPM. VÁCUO: 0 A 22 POLHG / 560 MMHG. MEDIDAS EXTERNAS (LXPXH): 45 X 52 X 120 CM. AUMENTAÇÃO ELÉTRICA: 127/220 V AC COM CHAVE DE COMUTAÇÃO. POTÊNCIA ELÉTRICA: 540 VA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CATÁLOGO DO PRODUTO.	UND	OLIDEF CZ	3	R\$ 8.334,00	R\$ 25.002,00
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$ 220.894,80
duzentos e vinte mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos							
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							R\$ 220.894,80
duzentos e vinte mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos							

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: 05 (cinco) dias corridos

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

M

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

13/02/2023

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 966

A. C.
Rubrica

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Rubrica

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM/CE.
A/C DA PREGOEIRA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, MARIA VANESSA LOURENÇO MENESES.
REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2701.01/2023-SMS/SRP/PE
DATA E HORA DA ABERTURA: 13 DE FEVEREIRO DE 2023 ÀS 08:30H.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CEARÁ.

PROPOSTA DE PREÇO

MATERIAL ODONTOLÓGICO											
LOTE 01											
ITEM	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	REGISTRO ANVISA	HOSPITAL	AT. BÁSICA	QUANT.	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
1	UND	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1011 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	MICRODONT	80678920015	0	100	100	R\$ 3,36	três reais e trinta e seis centavos	R\$ 336,00	trezentos e trinta e seis reais
2	UND	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1012 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	MICRODONT	80678920015	0	100	100	R\$ 3,36	três reais e trinta e seis centavos	R\$ 336,00	trezentos e trinta e seis reais
3	UND	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1013 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	MICRODONT	80678920015	0	100	100	R\$ 3,36	três reais e trinta e seis centavos	R\$ 336,00	trezentos e trinta e seis reais
4	UND	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1014 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	MICRODONT	80678920015	0	100	100	R\$ 3,36	três reais e trinta e seis centavos	R\$ 336,00	trezentos e trinta e seis reais
5	UND	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1014 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	MICRODONT	80678920015	0	40	40	R\$ 3,36	três reais e trinta e seis centavos	R\$ 134,40	cento e trinta e quatro reais e quarenta centavos
6	UND	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1015 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	MICRODONT	80678920015	0	100	100	R\$ 3,36	três reais e trinta e seis centavos	R\$ 336,00	trezentos e trinta e seis reais
7	UND	BROCA ODONTOLÓGICA - DE AÇO INOX E DIAMANTES; DE FORMA CÔNICA INVERTIDA; NUMERO 1033; DE ALTA ROTAÇÃO; REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 E A RDC 280/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	MICRODONT	80678920015	0	20	20	R\$ 3,36	três reais e trinta e seis centavos	R\$ 67,20	sessenta e sete reais e vinte centavos
8	UND	BROCA ODONTOLÓGICA - DE AÇO INOX E DIAMANTES; DE FORMA CÔNICA INVERTIDA; NUMERO 1034; DE ALTA ROTAÇÃO; REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 E A RDC 280/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	MICRODONT	80678920015	0	30	30	R\$ 3,36	três reais e trinta e seis centavos	R\$ 100,80	cem reais e oitenta centavos
9	UND	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1019 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	MICRODONT	80678920015	0	30	30	R\$ 3,36	três reais e trinta e seis centavos	R\$ 100,80	cem reais e oitenta centavos
10	UND	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1090 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	MICRODONT	80678920015	0	40	40	R\$ 3,36	três reais e trinta e seis centavos	R\$ 134,40	cento e trinta e quatro reais e quarenta centavos
11	UND	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118F DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	MICRODONT	80678920015	0	40	40	R\$ 3,36	três reais e trinta e seis centavos	R\$ 134,40	cento e trinta e quatro reais e quarenta centavos
12	UND	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118FF DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	MICRODONT	80678920015	0	40	40	R\$ 3,36	três reais e trinta e seis centavos	R\$ 134,40	cento e trinta e quatro reais e quarenta centavos
13	UND	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3185F DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	MICRODONT	80678920015	0	40	40	R\$ 3,36	três reais e trinta e seis centavos	R\$ 134,40	cento e trinta e quatro reais e quarenta centavos
14	CX	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1015 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	MICRODONT	80678920015	0	100	100	R\$ 3,36	três reais e trinta e seis centavos	R\$ 336,00	trezentos e trinta e seis reais

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rubrica

15	UND	BROCA CIRÚRGICA AÇO CARBIDE LONGA, 25MM, Nº 08, HASTE LONGA, REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	KAVO	10064010120	0	30	30	R\$ 9,96	oito reais e noventa e seis centavos	R\$ 268,80	duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos	
16	UND	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1016 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA	MICRODONT	80676920015	0	100	100	R\$ 3,36	três reais e trinta e seis centavos	R\$ 336,00	trezentos e trinta e seis reais	
17	CAIXA	BROCA ODONTOLÓGICA - DE AÇO CARBONO; DE FORMA ESFÉRICA, NÚMERO 02; DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA ÂNGULO); REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALAGEM COM 6 UNIDADES.	DENTSPLY	80196880199	0	30	30	R\$ 21,84	vinte e um reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 655,20	seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos	
18	CAIXA	BROCA ODONTOLÓGICA - DE AÇO CARBONO; DE FORMA ESFÉRICA, NÚMERO 04; DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA ÂNGULO); REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALAGEM COM 6 UNIDADES	DENTSPLY	80196880199	0	20	20	R\$ 21,84	vinte e um reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 436,80	quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta centavos	
19	CAIXA	BROCA ODONTOLÓGICA - DE AÇO CARBONO; DE FORMA ESFÉRICA, NÚMERO 08; DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA ÂNGULO); REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALAGEM COM 6 UNIDADES.	DENTSPLY	80196880199	0	30	30	R\$ 21,84	vinte e um reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 655,20	seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos	
20	UND	BROCA ZECRYA DE ALTA ROTAÇÃO COM PARTE ATIVA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E PARTE INATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL, 28MM, REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	KAVO	10064010120	0	20	20	R\$ 15,26	quinze reais e vinte e seis centavos	R\$ 305,20	trezentos e cinco reais e vinte centavos	
21	UND	ESCOVA DE ROBSON PARA CONTRA ÂNGULO, TIPO PINCEL, MACIA, EXTREMIDADE PLANA, PEQUENA. / ESCOVA DE ROBSON C/ PONTA ANATÔMICA P/ CONTRA ÂNGULO - USO ODONTOLÓGICO.	IODONTOSUL	80442020047	0	500	500	R\$ 1,26	um real e vinte e seis centavos	R\$ 630,00	seiscentos e trinta reais	
22	UND	ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS, COM CORPO PLÁSTICO, CAPA PROTETORA E MECANISMO RETRÁTIL.	IODONTOSUL	RDC 185/2001	0	40	40	R\$ 0,66	nove reais e sessenta e seis centavos	R\$ 386,40	trezentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos	
23	UND	TAÇA DE BORRACHA PARA CONTRA ÂNGULO, MACIA, USO ODONTOLÓGICO, PEQUENA. / TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA ADAPTÁVEL AO CONTRA ÂNGULO.	IODONTOSUL	80442020047	0	100	100	R\$ 1,68	um real e sessenta e oito centavos	R\$ 168,00	cento e sessenta e oito reais	
24	UND	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1018 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA	MICRODONT	80676920015	0	100	100	R\$ 3,36	três reais e trinta e seis centavos	R\$ 336,00	trezentos e trinta e seis reais	
25	UND	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1013 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA	MICRODONT	80676920015	0	100	100	R\$ 3,36	três reais e trinta e seis centavos	R\$ 336,00	trezentos e trinta e seis reais	
26	UND	BROCA EM AÇO N. 04 BAIXA ROTAÇÃO	DENTSPLY	80196880199	0	100	100	R\$ 3,64	três reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 364,00	trezentos e sessenta e quatro reais	
27	UND	BROCA EM AÇO N. 06 BAIXA ROTAÇÃO	DENTSPLY	80196880199	0	100	100	R\$ 3,64	três reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 364,00	trezentos e sessenta e quatro reais	
28	UND	BROCA ESFÉRICA DE AÇO N.08 BAIXA ROTAÇÃO	DENTSPLY	80196880199	0	100	100	R\$ 3,64	três reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 364,00	trezentos e sessenta e quatro reais	
29	UND	BROCA ESFÉRICA DE AÇO N.10 BAIXA ROTAÇÃO	DENTSPLY	80196880199	0	100	100	R\$ 3,64	três reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 364,00	trezentos e sessenta e quatro reais	
30	UND	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1013 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	MICRODONT	80676920015	0	100	100	R\$ 3,36	três reais e trinta e seis centavos	R\$ 336,00	trezentos e trinta e seis reais	
31	CX	LIMA HEDSTROEN 25MM, 1ª SÉRIE - KIT DE LIMAS HEDSTROEN 25MM, 1ª SÉRIE, CAIXA COM 06	EURODONT	80398280037	0	100	100	R\$ 16,94	dezois reais e noventa e quatro centavos	R\$ 1.694,00	mil seiscentos e noventa e quatro reais	
32	CX	LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE (15 A 40) 215MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NIQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 6 UNIDADES.	EURODONT	80398280037	0	100	100	R\$ 19,46	dezenove reais e quarenta e seis centavos	R\$ 1.946,00	mil novecentos e quarenta e seis reais	
VALOR TOTAL DO LOTE				R\$ 12.902,40				doze mil, novecentos e dois reais e quarenta centavos				

PRAZO DE ENTREGA: 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DATA DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESENTA) DIAS, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAÇÃO QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

DECLARAMOS QUE SOMOS MICROEMPRESA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO 4º DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06.

FORTALEZA/CE, 13 DE FEVEREIRO DE 2023.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM/CE.

A/C DA PREGOEIRA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, MARIA VANESSA LOURENÇO MENESES.

REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2701.01/2023-SMS/SRP/PE

DATA E HORA DA ABERTURA: 13 DE FEVEREIRO DE 2023 ÀS 08:30H.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CEARÁ.

MATERIAL ODONTOLÓGICO											
LOTE 01											
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	ANVISA	MARCA	HOSPITAL	AT. BÁSICA	QUANT.	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
1	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1011 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UND	80676920015	MICRODONT	0	100	100	R\$ 3,48	três reais e quarenta e oito centavos	R\$ 348,00	trezentos e quarenta e oito reais
2	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1012 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UND	80676920015	MICRODONT	0	100	100	R\$ 3,48	três reais e quarenta e oito centavos	R\$ 348,00	trezentos e quarenta e oito reais
3	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1013 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UND	80676920015	MICRODONT	0	100	100	R\$ 3,48	três reais e quarenta e oito centavos	R\$ 348,00	trezentos e quarenta e oito reais
4	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1014 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UND	80676920015	MICRODONT	0	100	100	R\$ 3,48	três reais e quarenta e oito centavos	R\$ 348,00	trezentos e quarenta e oito reais
5	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1014 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UND	80676920015	MICRODONT	0	40	40	R\$ 3,48	três reais e quarenta e oito centavos	R\$ 139,20	cento e trinta e nove reais e vinte centavos
6	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1015 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UND	80676920015	MICRODONT	0	100	100	R\$ 3,48	três reais e quarenta e oito centavos	R\$ 348,00	trezentos e quarenta e oito reais
7	BROCA ODONTOLÓGICA - DE AÇO INOX E DIAMANTES, DE FORMA CÔNICA INVERTIDA; NUMERO 1033; DE ALTA ROTAÇÃO; REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002. PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	UND	80676920015	MICRODONT	0	20	20	R\$ 3,48	três reais e quarenta e oito centavos	R\$ 69,60	sessenta e nove reais e sessenta centavos

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 HIN 969
 Rubrica

8	BROCA ODONTOLÓGICA - DE AÇO INOX E DIAMANTES; DE FORMA CÔNICA INVERTIDA; NUMERO 1034; DE ALTA ROTAÇÃO; REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	UND	80676920015	MICRODONT	0	30	30	R\$ 3,48	três reais e quarenta e oito centavos	R\$ 104,40	cento e quatro reais e quarenta centavos
9	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1019 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBR	UND	80676920015	MICRODONT	0	30	30	R\$ 3,48	três reais e quarenta e oito centavos	R\$ 104,40	cento e quatro reais e quarenta centavos
10	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1090 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UND	80676920015	MICRODONT	0	40	40	R\$ 3,48	três reais e quarenta e oito centavos	R\$ 139,20	cento e trinta e nove reais e vinte centavos
11	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118F DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UND	80676920015	MICRODONT	0	40	40	R\$ 3,48	três reais e quarenta e oito centavos	R\$ 139,20	cento e trinta e nove reais e vinte centavos
12	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118FF DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UND	80676920015	MICRODONT	0	40	40	R\$ 3,48	três reais e quarenta e oito centavos	R\$ 139,20	cento e trinta e nove reais e vinte centavos
13	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3195F DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UND	80676920015	MICRODONT	0	40	40	R\$ 3,48	três reais e quarenta e oito centavos	R\$ 139,20	cento e trinta e nove reais e vinte centavos
14	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1015 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA	CX	80676920015	MICRODONT	0	100	100	R\$ 3,48	três reais e quarenta e oito centavos	R\$ 348,00	trezentos e quarenta e oito reais
15	BROCA CIRÚRGICA AÇO CARBIDE LONGA, 25MM, Nº 08, HASTE LONGA. REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	UND	10064010120	KAVO	0	30	30	R\$ 9,28	nove reais e vinte e oito centavos	R\$ 278,40	duzentos e setenta e oito reais e quarenta centavos
16	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1016 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA	UND	80676920015	MICRODONT	0	100	100	R\$ 3,48	três reais e quarenta e oito centavos	R\$ 348,00	trezentos e quarenta e oito reais
17	BROCA ODONTOLÓGICA - DE AÇO CARBONO; DE FORMA ESFÉRICA; NUMERO 02; DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA ÂNGULO); REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALAGEM COM 6 UNIDADES.	CAIXA	80196880199	DENTSPLY	0	30	30	R\$ 22,62	vinte e dois reais e sessenta e dois centavos	R\$ 678,60	seiscentos e setenta e oito reais e sessenta centavos

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 2016
 Rubrica

[Handwritten signatures and marks]

18	BROCA ODONTOLÓGICA - DE AÇO CARBONO; DE FORMA ESFÉRICA; NUMERO 04; DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA ÂNGULO); REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALAGEM COM 6 UNIDADES	CAIXA	80196880199	DENTSPLY	0	20	20	R\$ 22,62	vinte e dois reais e sessenta e dois centavos	R\$ 452,40	quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos
19	BROCA ODONTOLÓGICA - DE AÇO CARBONO; DE FORMA ESFÉRICA; NUMERO 08; DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA ÂNGULO); REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALAGEM COM 6 UNIDADES	CAIXA	80196880199	DENTSPLY	0	30	30	R\$ 22,62	vinte e dois reais e sessenta e dois centavos	R\$ 678,60	seiscentos e setenta e oito reais e sessenta centavos
20	BROCA ZECRYA DE ALTA ROTAÇÃO COM PARTE ATIVA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E PARTE INATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL, 28MM. REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE	UND	10064010120	KAVO	0	20	20	R\$ 15,81	quinze reais e oitenta e um centavos	R\$ 316,20	trezentos e dezesseis reais e vinte centavos
21	ESCOVA DE ROBSON PARA CONTRA ÂNGULO, TIPO PINCEL, MACIA, EXTREMIDADE PLANA, PEQUENA / ESCOVA DE ROBSON C/ PONTA ANATÔMICA P/ CONTRA ÂNGULO - USO ODONTOLÓGICO.	UND	80442020047	IODONTOSUL	0	500	500	R\$ 1,31	um real e trinta e um centavos	R\$ 655,00	seiscentos e cinquenta e cinco reais
22	ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS, COM CORPO PLÁSTICO, CAPA PROTETORA E MECANISMO RETRÁTIL.	UND	RDC 185/2001	IODONTOSUL	0	40	40	R\$ 10,01	dez reais e um centavo	R\$ 400,40	quatrocentos reais e quarenta centavos
23	TAÇA DE BORRACHA PARA CONTRA ÂNGULO. MACIA, USO ODONTOLÓGICO, PEQUENA. / TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA ADAPTÁVEL AO CONTRA ÂNGULO.	UND	80442020047	IODONTOSUL	0	100	100	R\$ 1,74	um real e setenta e quatro centavos	R\$ 174,00	cento e setenta e quatro reais
24	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1016 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA	UND	80676920015	MICRODONT	0	100	100	R\$ 3,48	três reais e quarenta e oito centavos	R\$ 348,00	trezentos e quarenta e oito reais
25	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1013 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA	UND	80676920015	MICRODONT	0	100	100	R\$ 3,48	três reais e quarenta e oito centavos	R\$ 348,00	trezentos e quarenta e oito reais
26	BROCA EM AÇO N. 04 BAIXA ROTAÇÃO	UND	80196880199	DENTSPLY	0	100	100	R\$ 3,77	três reais e setenta e sete centavos	R\$ 377,00	trezentos e setenta e sete reais
27	BROCA EM AÇO N. 06 BAIXA ROTAÇÃO	UND	80196880199	DENTSPLY	0	100	100	R\$ 3,77	três reais e setenta e sete centavos	R\$ 377,00	trezentos e setenta e sete reais
28	BROCA ESFÉRICA DE AÇO N.08 BAIXA ROTAÇÃO	UND	80196880199	DENTSPLY	0	100	100	R\$ 3,77	três reais e setenta e sete centavos	R\$ 377,00	trezentos e setenta e sete reais
29	BROCA ESFÉRICA DE AÇO N.10 BAIXA ROTAÇÃO	UND	80196880199	DENTSPLY	0	100	100	R\$ 3,77	três reais e setenta e sete centavos	R\$ 377,00	trezentos e setenta e sete reais
30	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1013 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UND	80676920015	MICRODONT	0	100	100	R\$ 3,48	três reais e quarenta e oito centavos	R\$ 348,00	trezentos e quarenta e oito reais
31	LIMA HEDSTROEN 25MM, 1º SÉRIE - KIT DE LIMAS HEDSTROEN 25MM. 1º SÉRIE, CAIXA COM 06	CX	80398280037	EURODONTO	0	100	100	R\$ 17,55	dezesete reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 1.755,00	mil setecentos e cinquenta e cinco reais

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FILE
 911
 RIBRICA

32	LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE (15 A 40) 215MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 6 UNIDADES.	CX	80398280037	EURODONTO	0	100	100	R\$ 20,16	vinte reais e dezesseis centavos	R\$ 2.016,00	dois mil e dezesseis reais
VALOR TOTAL DO LOTE		R\$ 15.367,60 treze mil, trezentos e sessenta e sete reais									

PRAZO DE ENTREGA: 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DATA DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.
PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESENTA) DIAS, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

**DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).
DECLARAÇÃO QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.**

FORTALEZA/CE, 13 DE FEVEREIRO DE 2023.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FIS. 9124
Rubrica

[Assinatura]
Rubrica

NOME DO ORGÃO/MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM/CE	SETOR DE LICITAÇÃO
Nº DO PREGÃO: 2701.01/23-SMS/2023	PREGÃO: ELETRÔNICO/MENOR PREÇO LOTE

ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, SUBSIDIADA PELA LEI Nº 8.666/93 E SUA POSTEIORES ALTERAÇÕES E, AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE PREGÃO.

DECLARAMOS QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATOS QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO E E NOS COMPROMETEMOS A FORNECER INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOLICITADAS PELO PREGOEIRO.

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTAMOS ENQUADRADOS COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E NÃO ESTÁ SUJEITA A QUAISQUER DOS IMPEDIMENTOS DO § 4º DESTE ARTIGO, ESTANDO APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ESTABELECIDO NOS ART. 42 A 49 DA MENCIONADA LEI, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014

DECLARAMOS QUE NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTAO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO DO OBJETO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO E QUE CUMPRE TAMBEM A TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.

DECLARAMOS AINDA QUE, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAS, OBJETO DESSE EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGENCIA EDITALICIA E CONTRATUAL E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE A CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM CEARÁ.

LOTE 29 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	MARCA	V.UNIT	V.TOTAL
1	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1011 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	Unidade	100	MICRODONT	R\$ 7,40	R\$ 740,00
2	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1012 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	Unidade	100	MICRODONT	R\$ 7,40	R\$ 740,00
3	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1013 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	Unidade	100	MICRODONT	R\$ 7,40	R\$ 740,00
4	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1014 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	Unidade	100	MICRODONT	R\$ 7,40	R\$ 740,00
5	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1014 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA	Unidade	40	MICRODONT	R\$ 7,40	R\$ 296,00
6	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1015 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	Unidade	100	MICRODONT	R\$ 7,40	R\$ 740,00
7	BROCA ODONTOLÓGICA - DE AÇO INOX E DIAMANTES; DE FORMA CÔNICA INVERTIDA; NUMERO 1033; DE ALTA ROTAÇÃO; REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	Unidade	20	MICRODONT	R\$ 4,62	R\$ 92,40
8	BROCA ODONTOLÓGICA - DE AÇO INOX E DIAMANTES; DE FORMA CÔNICA INVERTIDA; NUMERO 1034; DE ALTA ROTAÇÃO; REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	Unidade	30	MICRODONT	R\$ 4,62	R\$ 138,60

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

9	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1019 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBR	Unidade	30	MICRODONT	R\$ 7,40	R\$ 222,00
10	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1090 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	Unidade	40	MICRODONT	R\$ 7,40	R\$ 296,00
11	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118F DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	Unidade	40	MICRODONT	R\$ 7,40	R\$ 296,00
12	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118FF DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	Unidade	40	MICRODONT	R\$ 7,40	R\$ 296,00
13	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3195F DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	Unidade	40	MICRODONT	R\$ 7,40	R\$ 296,00
14	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1015 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA	Caixa	100	MICRODONT	R\$ 7,40	R\$ 740,00
15	BROCA CIRÚRGICA AÇO CARBIDE LONGA, 25MM, Nº 08, HASTE LONGA. REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	Unidade	30	MICRODONT	R\$ 19,80	R\$ 594,00
16	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1016 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA	Unidade	100	MICRODONT	R\$ 7,40	R\$ 740,00
17	BROCA ODONTOLÓGICA - DE AÇO CARBONO; DE FORMA ESFÉRICA; NUMERO 02; DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA ÂNGULO); REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALAGEM COM 6 UNIDADES.	Caixa	30	DENTSPLY	R\$ 30,00	R\$ 900,00
18	BROCA ODONTOLÓGICA - DE AÇO CARBONO; DE FORMA ESFÉRICA; NUMERO 04; DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA ÂNGULO); REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALAGEM COM 6 UNIDADES	Caixa	20	DENTSPLY	R\$ 30,00	R\$ 600,00
19	BROCA ODONTOLÓGICA - DE AÇO CARBONO; DE FORMA ESFÉRICA; NUMERO 08; DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA ÂNGULO); REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALAGEM COM 6 UNIDADES.	Caixa	30	DENTSPLY	R\$ 30,00	R\$ 900,00
20	BROCA ZECRYA DE ALTA ROTAÇÃO COM PARTE ATIVA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E PARTE INATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL, 28MM. REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	Unidade	20	MICRODONT	R\$ 24,00	R\$ 480,00
21	ESCOVA DE ROBSON PARA CONTRA ÂNGULO, TIPO PINCEL, MACIA, EXTREMIDADE PLANA, PEQUENA. / ESCOVA DE ROBSON C/ PONTA ANATÔMICA P/ CONTRA ÂNGULO - USO ODONTOLÓGICO.	Unidade	500	AF DO BRASIL	R\$ 1,50	R\$ 750,00
22	ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS, COM CORPO PLÁSTICO, CAPA PROTETORA E MECANISMO RETRÁTIL.	Unidade	40	IODONTOSUL	R\$ 11,20	R\$ 448,00
23	TAÇA DE BORRACHA PARA CONTRA ÂNGULO. MACIA, USO ODONTOLÓGICO, PEQUENA. / TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA ADAPTÁVEL AO CONTRA ÂNGULO.	Unidade	100	AF DO BRASIL	R\$ 1,70	R\$ 170,00
24	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1016 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA	Unidade	100	MICRODONT	R\$ 7,40	R\$ 740,00
25	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1013 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA	Unidade	100	MICRODONT	R\$ 7,40	R\$ 740,00
26	BROCA EM AÇO N. 04 BAIXA ROTAÇÃO	Unidade	100	DENTSPLY	R\$ 5,00	R\$ 500,00
27	BROCA EM AÇO N. 06 BAIXA ROTAÇÃO	Unidade	100	DENTSPLY	R\$ 5,00	R\$ 500,00
28	BROCA ESFÉRICA DE AÇO N.08 BAIXA ROTAÇÃO	Unidade	100	DENTSPLY	R\$ 5,00	R\$ 500,00
29	BROCA ESFÉRICA DE AÇO N.10 BAIXA ROTAÇÃO	Unidade	100	DENTSPLY	R\$ 5,00	R\$ 500,00

Al
Rubrica

30	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1013 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	Unidade	100	MICRODONT	R\$ 7,40	R\$ 740,00
31	LIMA HEDSTROEN 25MM, 1ª SÉRIE - KIT DE LIMAS HEDSTROEN 25MM. 1ª SÉRIE, CAIXA COM 06	Caixa	100	EURODONT	R\$ 24,18	R\$ 2.418,00
32	LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE (15 A 40) 215MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO. CAIXA COM 6 UNIDADES.	Caixa	100	EURODONT	R\$ 27,80	R\$ 2.780,00
VALOR TOTAL LOTE 29					R\$ 21.373,00	
vinte e um mil, trezentos e setenta e três reais						

PRAZO DE ENTREGA: 5 (CINCO) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

13 DE FEVEREIRO DE 2023

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FORTALEZA-CE, 13 DE FEVEREIRO 2023.

AO GOVERNO MUNICIPAL DE FORTIM/CE
 ATT.: AO PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 REF.: PROPOSTA DE PREÇO

PREZADOS SENHORES;
 APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2701.01/2023, REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CEARÁ.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2701.01/2023 DATA DE ABERTURA 13 DE FEVEREIRO AS 10:30HRS.

PREZADOS SENHORES,

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL

PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 29 - MATERIAL ODONTOLÓGICO										
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD. HOSPITAL	QTD. ATENÇÃO BÁSICA	QTD TOTAL	MARCA	V. UNITÁRIO	-	V. TOTAL	
1	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1011 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	Unidade		100	100	MICRODONT	R\$ 6,60	seis reais e sessenta centavos	R\$ 660,00	seiscentos e sessenta reais
2	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1012 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	Unidade		100	100	MICRODONT	R\$ 6,60	seis reais e sessenta centavos	R\$ 660,00	seiscentos e sessenta reais
3	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1013 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	Unidade		100	100	MICRODONT	R\$ 6,60	seis reais e sessenta centavos	R\$ 660,00	seiscentos e sessenta reais
4	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1014 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	Unidade		100	100	MICRODONT	R\$ 6,60	seis reais e sessenta centavos	R\$ 660,00	seiscentos e sessenta reais
5	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1014 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	Unidade		40	40	MICRODONT	R\$ 6,60	seis reais e sessenta centavos	R\$ 264,00	duzentos e sessenta e quatro reais
6	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1015 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	Unidade		100	100	MICRODONT	R\$ 6,60	seis reais e sessenta centavos	R\$ 660,00	seiscentos e sessenta reais
7	BROCA ODONTOLÓGICA - DE AÇO INOX E DIAMANTES; DE FORMA CÔNICA INVERTIDA; NUMERO 1033; DE ALTA ROTAÇÃO; REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	Unidade		20	20	MICRODONT	R\$ 6,60	seis reais e sessenta centavos	R\$ 132,00	cento e trinta e dois reais
8	BROCA ODONTOLÓGICA - DE AÇO INOX E DIAMANTES; DE FORMA CÔNICA INVERTIDA; NUMERO 1034; DE ALTA ROTAÇÃO; REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	Unidade		30	30	MICRODONT	R\$ 6,60	seis reais e sessenta centavos	R\$ 198,00	cento e noventa e oito reais
9	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1019 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBR	Unidade		30	30	MICRODONT	R\$ 6,60	seis reais e sessenta centavos	R\$ 198,00	cento e noventa e oito reais
10	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1090 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	Unidade		40	40	MICRODONT	R\$ 6,60	seis reais e sessenta centavos	R\$ 264,00	duzentos e sessenta e quatro reais
11	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118F DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	Unidade		40	40	MICRODONT	R\$ 6,60	seis reais e sessenta centavos	R\$ 264,00	duzentos e sessenta e quatro reais
12	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118FF DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO À BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	Unidade		40	40	MICRODONT	R\$ 6,60	seis reais e sessenta centavos	R\$ 264,00	duzentos e sessenta e quatro reais

me

Dani