

A  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM  
 ESTADO DO CEARÁ  
 PREGÃO ELETRÔNICO 1810.01/2023

Objeto

ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE.

Item	Nome do Produto/Descrição	Und	Qtd	Marcas	V. Unitário	V. Total
1	MESA DE EXAMES - CARACTERÍSTICA FÍSICA - ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECCÃO ESPECIFICAÇÃO COM ARMÁRIO - MADEIRA OU MDF	Und	1	LEVITA / LV 84	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
	ESCADA COM 2 DE GRAUS - CARACTERÍSTICA CONFECCÃO AÇO INOXIDAVEL	Und	3	LEVITA / LV 11	R\$ 301,00	R\$ 903,00
	MESA DE MAIO - MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDAVEL	Und	2	LEVITA / LV 16	R\$ 638,00	R\$ 1.276,00
14	DETECTOR METAL TIPO. TECNOLOGIA DE MESA - DISPLAY DIGITAL - POSSUI DE 3 A 5 ALIMENTAÇÃO POR REDE ELÉTRICA E BATERIA	Und	1	MD / FD 3000	R\$ 1.578,00	R\$ 1.578,00
23	MESA ODONTOLÓGICA - ESTRUTURA - MATERIAL DE CONFECCÃO - SEM ARMÁRIO - AÇO OU FERRO PINTADO	Und	1	LEVITA / LV 117	R\$ 1.714,00	R\$ 1.714,00
32	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LITROS) - CARACTERÍSTICA FÍSICA MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL - CAPACIDADE DE ATE 25 L	Und	1	SANTAREM / 21L	R\$ 6.478,00	R\$ 6.478,00
33	Sistema Odontológico Completo (equip. sugador/ refletor) Características Físicas Especificação TERMINAIS ATÉ 3 EQUIPO TIPO CART OU ACOPLADO COMANDO DA PEDAL CADEIRA 33 CABECEIRA POSSUI REFLETOR POSSUI CUBA PORCELANACERÂMICA BERINGA TRÍPLICE   POSSUI PEÇA RETA POSSUI CONTRA ÂNGULO   POSSUI MICRO MOTOR POSSUI ANETA DE ROTAÇÃO POSSUI UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR)   POSSUI MOCHO POSSUI	Und	1	SANTAREM / PHOENIX II	R\$ 17.080,00	R\$ 17.080,00
35	Compressor Odontológico Especificação ATÉ 10 LITROS características Físicas Especificações CAPACIDADE RESERVATÓRIO: 30 A 38 L   11A   1,5HP   6 A 7 PÉS POTENCIA   CONSUMO   BENTO DE ÓLEO SEM	Und	1	CHIAPERINI / SOL	R\$ 3.453,00	R\$ 3.453,00
					TOTAL	R\$ 35.878,00

Declaro estar computado todos os custos relacionados com o fornecimento, ficando vedada qualquer alegação posterior que vise ressarcimento de custos não considerados nos preços cotados.

A empresa acima qualificada, por meio do representante supracitado, DECLARA estar de acordo com todas as normas e condições estabelecidas no edital do processo em epígrafe e que os preços indicados nesta proposta estão computados todos os custos básicos diretos, bem como encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto do certame, tais como frete, instalação (quando exigido no edital) combustível, treinamento e demais concernentes à plena e total entrega do objeto.

Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias  
 Condição de Entrega: Conforme edital  
 Condição de Pagamento: Conforme edital  
 Prazo de Garantia: Conforme edital  
 Frete: CIF ( PAGO )

Cambé, 8 de novembro de 2023.

*me*

*U*

## CARRO PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS

Confeccionado em tubo redondo de aço, prateleiras em chapa de aço com varanda de apoio em toda volta, rodas giratórias.

### MODELOS:

- LV 66 - 03 prateleiras - acabamento em pintura epóxi pó após tratamento antiferrugineo.
- LV 66I - 03 prateleiras - estrutura e prateleiras em aço inox.
- LV 128 - 04 prateleiras - acabamento em pintura epóxi pó após tratamento antiferrugineo.
- LV 128I - 04 prateleiras - estrutura e prateleiras em aço inox.

Dimensões padrão: Carro: C 1,00m x L 0,60m x A 0,90m



Carro LV 66


### OPCIONAIS:

- Para-choque de proteção em toda volta.
- Rodizos de 5" a 8".

## CARRO TÉRMICO

LV 141 - Estrutura em chapa de aço inox, e tubo quadrado de aço inox. Isolamento térmico através de lâ de vidro. Aquecimento interno realizado através de resistência elétrica. Controle da temperatura efetuado através de termostato com lâmpada analizadora ajustada entre 20 e 120°C. Capacidade para 30 bandejas de refeição 48cm x 32cm (não inclusas). Espaço entre as bandejas: 8cm. Duas portas verticais com trava. Rodizos de 3" sendo dois com freios dispostos na diagonal. Para choque de proteção em toda a sua volta.

Dimensões padrão: Carro: C 1,01m x L 0,64m x A 1,37m  
Total com para choque: C 1,26m x L 0,72m x A 1,37m.




Carro LV 141

## CARRO CURATIVO

Confeccionado em tubo redondo de aço, tempo e prateleira em aço. Alça para locomoção em tubo redondo de aço. Varanda de proteção em toda volta em treliçada. Quatro rodizos giratórios.

### MODELOS:

- LV 06: Estrutura em aço carbono com pintura eletrolítica pó (epóxi), após tratamento antiferrugineo.
- LV 75: Estrutura em aço carbono com pintura eletrolítica pó (epóxi), após tratamento antiferrugineo. Acompanha balde e bacia em aço inox.
- LV 06I: Estrutura em aço inox.
- LV 75I: Estrutura em aço inox. Acompanha balde e bacia em aço inox.

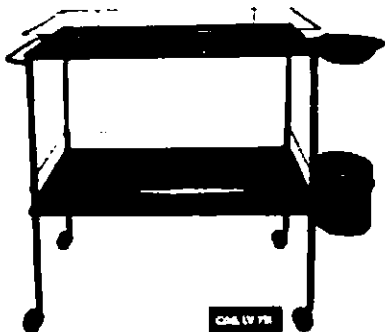


Carro LV 06

### Dimensões:


LV 06 e LV 06I: C 0,80m x L 0,43m x A 0,85m.  
LV 75 e LV 75I: C total 1,15m / tempo e prateleira 0,80m x L 0,43m x A 0,85m.

## MESA DE EXAMES, GABINETE COM PORTAS E GAVETAS

Gabinete com três gavetas, duas portas e uma prateleira interna, feito em espuma revestido em couro, cabeceira reclinável em três posições através de cremalheiras.

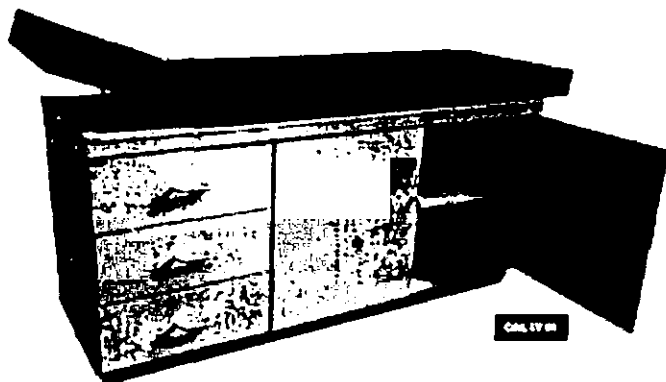

Cl. LV 64

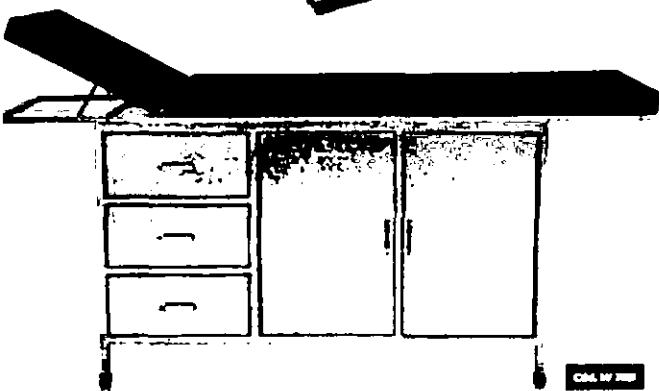

Cl. LV 200

### MODELOS:

- LV 64: Gabinete em MDF revestido internamente e estofamento em fórmica.
- LV 200: Gabinete em chapa de aço carbono em pintura eletrolítica pó (opon) após tratamento anti-ruginoso.
- LV 200i: Gabinete em chapa de aço inox.

Dimensões padrão: C 1,80m x L 0,60m x A 0,80m.

Capacidade de peso padrão: 150Kg.

Dimensões opcionais: C 1,20m a 2,80m x L 0,70m a 2,00m x A 0,48m a 1,50m.


Capacidade de peso opcionais: de 131Kg a 550Kg.

## MESA DE EXAMES

Estrutura em tubo redondo de aço e reforço em forma de H na parte inferior em tubo redondo de aço. Cabeceira reclinável em três posições através da cremalheira, pés com ponteiros de PVC antiderrapante.

### MODELOS:

- LV 119: Leto em MDF com espuma e revestido em courovin. Estrutura em pintura eletrostática pó (epóxi) após tratamento antiferrugíneo.
- LV 119: Leto em MDF com espuma e revestido em courovin. Estrutura em aço inox.
- LV 121: Leto em chapa de aço. Estrutura em pintura eletrostática pó (epóxi) após tratamento antiferrugíneo.
- LV 121: Leto em chapa de aço inox. Estrutura em aço inox.

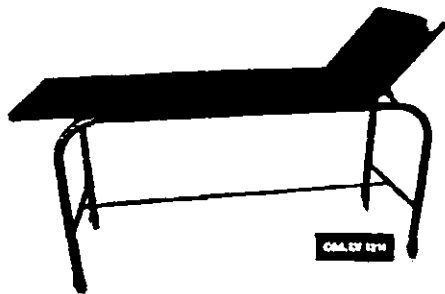

Dimensões padrão: C 1,80m x L 0,55m x A 0,80m.  
Capacidade de peso padrão: 150Kg.


Dimensões opcionais: C 1,20m a 2,00m x L 0,70m a 1,50m.  
Capacidade de peso opcionais: de 131Kg a 550Kg.

## MESA DE EXAMES INFANTIL

Estrutura em tubo redondo de aço e reforço em forma de H na parte inferior em tubo redondo de aço. Leto em MDF com espuma e revestido em courovin. Pés com ponteiros de PVC antiderrapante.

### MODELOS:

- LV 51: Estrutura em pintura eletrostática pó (epóxi) após tratamento antiferrugíneo.
- LV 51: Estrutura em aço inox.

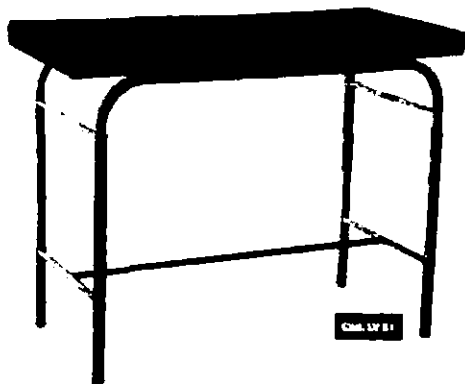

Dimensões padrão: C 1,10m x L 0,50m x A 0,65m.  
Capacidade de peso padrão: 150Kg.

Dimensões opcionais: C 1,20m a 2,50m x L 0,70m a 1,50m.  
Capacidade de peso opcionais: de 131Kg a 550Kg.

## MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO

Estrutura confeccionada em tubo redondo de aço, gaveta em chapa de aço inox para escoamento do líquido, cabecera e peixeira reguláveis através de cremalheiras. Acompanha um par de porta costas em poliuretano injetado com hastes em tubo de aço inox.

### MODELOS:

- LV 117: Leito em MDF com espuma e revestido em courovin. Estrutura em pintura eletroestática pó (epóxi) após tratamento antifúngico.
- LV 117E: Leito em MDF com espuma e revestido em courovin. Estrutura em aço inox.
- LV 20: Leito em chapa de aço. Estrutura em pintura eletroestática pó (epóxi) após tratamento antifúngico.
- LV 20E: Leito em chapa de aço inox. Estrutura em aço inox.



Dimensões padrão: C 1,90m x L 0,50m x A 0,84m.  
Capacidade de peso padrão: 150Kg.

Dimensões opcionais: C 1,20m a 2,50m x L 0,70m a 2,00m x A 0,45m a 1,50m.  
Capacidade de peso opcionais: de 131Kg a 550Kg.

## MESA PARA EXAMES GINECOLÓGICOS, GABINETE COM PORTAS E GAVETAS


Gabinete com três gavetas, duas portas e uma prateleira interna, leito em espuma revestido em courovin, cabecera e peixeira reguláveis através de cremalheiras. Gaveta em chapa de aço inox para escoamento de líquido. Acompanha um par de porta costas em poliuretano injetado com hastes em tubo de aço inox.

### MODELOS:

- LV 22: Gabinete em MDF revestido internamente e externamente em fórmica.
- LV 66: Gabinete em chapa de aço carbono em pintura eletroestática pó (epóxi) após tratamento antifúngico.

Dimensões padrão:  
C 1,90m x L 0,80m x A 0,95m.  
Capacidade de peso padrão: 150Kg.

Dimensões opcionais: C 1,20m a 2,50m x L 0,70m a 2,00m x A 0,45m a 1,50m.  
Capacidade de peso opcionais:  
de 131Kg a 550Kg.

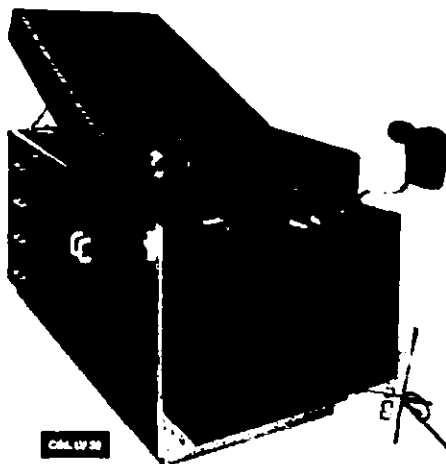

CO  
FIL  
CY  
ACAO


## MESAS DE MAYO

Estrutura em tubo redondo de aço. Haste regulável em tubo redondo de aço. Suporte para bandeja em treliçado. Bandeja em aço inox. Regulagem de altura com sistema de bucha em aço maciço (isento de porca) e manípulo, três rodízios giratórios tipo bola de 2".

### MODELOS:


- LV 16: Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática pó após tratamento antiferrugíneo. Haste regulável e suporte para bandeja em aço inox.
- LV 18: Estrutura, haste regulável e suporte para bandeja em aço inox.

Dimensões padrão: C 0,63m x L 0,45m x A 0,80m/1,20m.  
Bandeja: C 0,48 x L 0,32m.

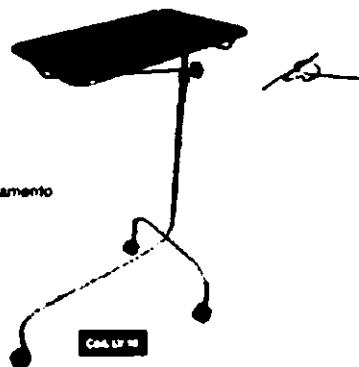

## POLTRONA RECLINÁVEL

Estrutura em tubo redondo de aço. Assento, encosto, pernas e braços estofados em espuma com 05cm de altura D-28 revestido em couvrin e acabamento em perfil PVC flexível. Movimento simultâneo de encosto e do descanso das pernas, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferrugíneo. Péa com ponteras de PVC antiderrapante.

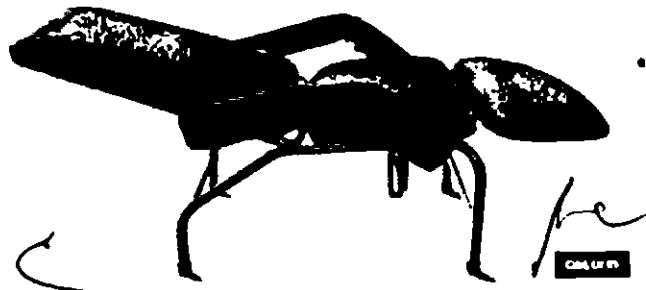

### MODELOS:

- LV 91 - Reclinável em três posições através de alavanca lateral com retorno automático à posição inicial de sentado através de molas.
- LV 91 GAS - Reclinável em várias posições através de alavanca lateral com retorno automático à posição inicial de sentado através de amortecedor a gás.

### OPCIONAIS:

- Movimento independente do encosto e descanso das pernas.
- Rodízios de 3" a 5".

Dimensões padrão: C 0,46m x L 0,70m x A 1,20m. Posição deitada: C 1,70m.  
Capacidade de peso padrão: 120Kg.



COM  
NO DE L


## MESA PARA INSTRUMENTAL

LV 1911 - Mesa inox para instrumental com tampo em chapa de aço inox, suporte removível confeccionado em tubo de aço inox com 10 ganchos em treliçada de aço inox, quatro pés em tubo de aço inox com reforço em H na parte inferior em tubo de aço inox, quatro rodízios giratórios de 3" sendo dois com freios dispostos na diagonal.

Dimensões:

C 1,17m x L 0,80m x


A tampo 0,80m/total 1,20m.

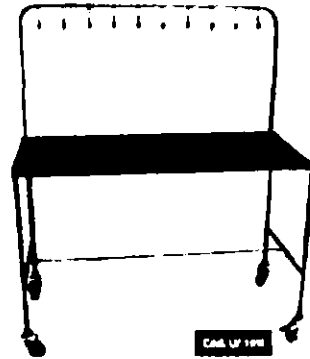

Cat. LV 1911

## POLTRONA RECLINÁVEL PARA COLETA DE SANGUE

LV 93 - Estrutura em tubo redondo de aço. Assento, encosto, pernas e braços estofados em espuma com 05cm de altura D-28 revestido em couvin e acabamento em perfil PVC flexível. Reclinável em três posições através de alavanca lateral com retorno automático à posição inicial de sentado através de molas, movimento simultâneo de encosto e do descanso das pernas. Um par de concha removíveis e reguláveis construídas em aço inox. Pintura eletrolítica pó (epóxi), após tratamento antiferrugineoso. Pés com porteras de PVC antiderrapante.

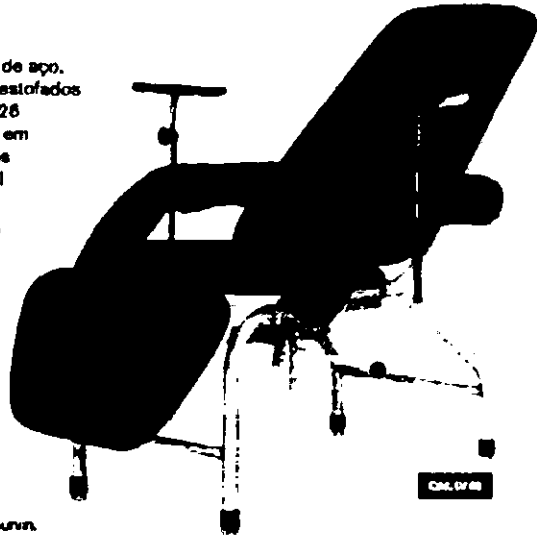

Cat. LV 93


### OPCIONAIS:

- Conchas estofadas e revestidas em couvin.
- Conchas em poliuretano revestido.
- Movimento independente do encosto e descanso das pernas.

Dimensões padrão: C 0,46m x L 0,70m x A 1,20m. Posição deitada: C 1,70m.

Capacidade de peso padrão: 120Kg.

# IL COMPROMISSO

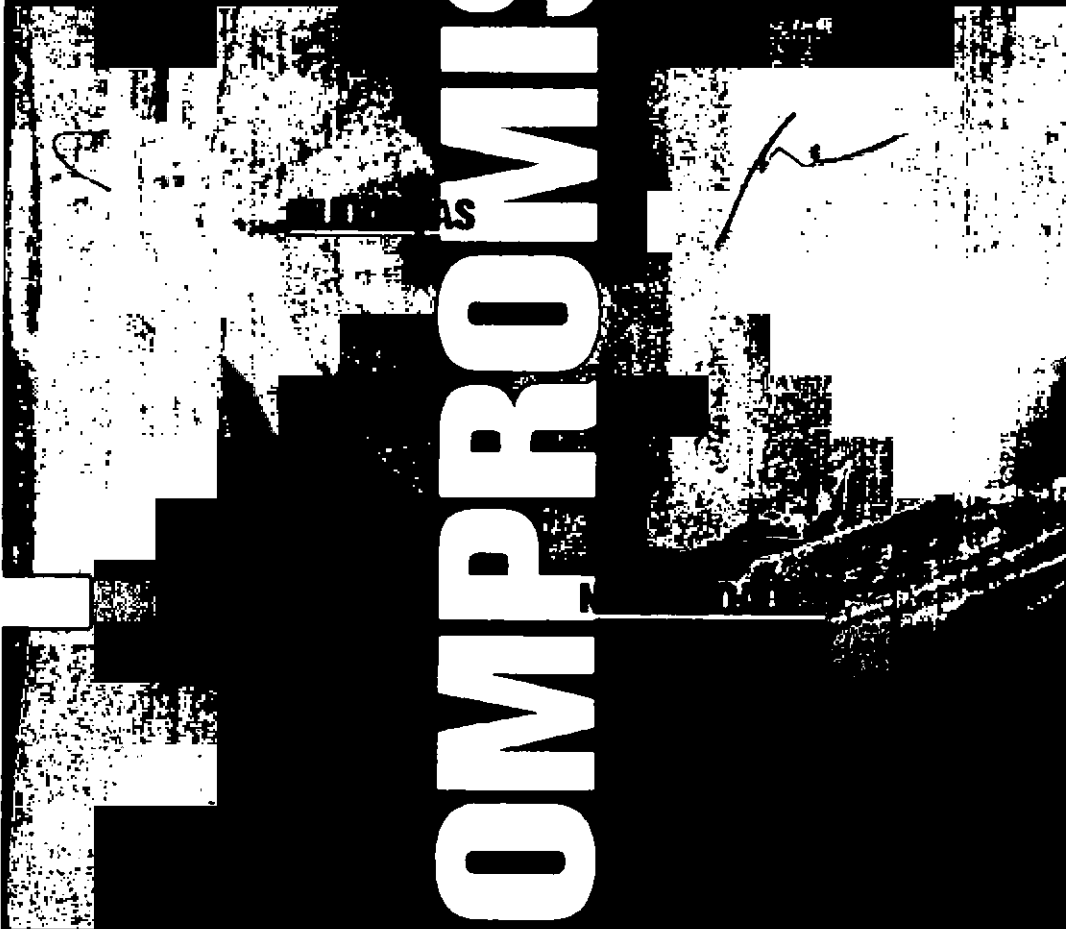



## ARMÁRIO VITRINE

Pés em tubo quadrado de aço, porta frontal em vidro 3mm com fechadura tipo Yale com chave, pintura eletrostática pó (epóxi) após tratamento antirreferruginoso, ponteiros de PVC antiderrapante.


### MODELOS:

- LV 01 - 1 porta. Teto, fundo e laterais em chapa de aço. Três prateleiras em chapa 0,80mm.
- LV 02 - 1 porta. Teto e fundo em chapa de aço. Laterais em vidro de 3mm. Três prateleiras em vidro 4mm.
- LV 03 - 2 portas. Teto, fundo e laterais em chapa de aço. Três prateleiras em chapa 0,80mm.
- LV 03 - 2 portas. Teto e fundo em chapa de aço. Laterais em vidro de 3mm. Três prateleiras em vidro 4mm.

### Dimensões padrão:

LV 01 e LV 02: C 0,50m x L 0,35m x A 1,50m.

LV 03 e LV 03: C 0,70m x L 0,35m x A 1,50m.

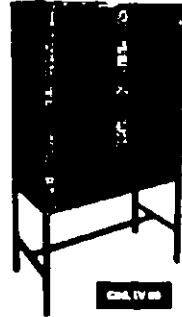


## ESCALADA DOIS DEGRAUS

Estrutura em tubo de aço 22,22mm x 1,20mm, pés com ponteira PVC antiderrapante.

### MODELOS:

- LV 111 - Estrutura em tubo de aço carbono pintada em epóxi pó após tratamento antirreferruginoso, degraus em MDF revestido em borracha antiderrapante e reforço entre eles em aço treliçado 6,35mm, acabamento em fita decorativa.
- LV 111 - Estrutura inox, degraus em MDF revestido em borracha antiderrapante e reforço entre eles em aço treliçado de aço inox 6,35mm, acabamento em fita decorativa.
- LV 139 - Estrutura em tubo de aço carbono, degraus em chapa de aço carbono 1,50mm dobrada, revestida em borracha antiderrapante e reforço entre eles em aço treliçado 6,35mm, pintada em epóxi pó após tratamento antirreferruginoso.
- LV 139 - Estrutura em tubo de aço inox, degraus em chapa de aço inox 1,50mm dobrada, revestida em borracha antiderrapante e reforço entre eles em aço treliçado de aço inox 6,35mm.
- LV 147 - Estrutura em tubo de aço carbono pintada em epóxi pó após tratamento antirreferruginoso, degraus em MDF revestido em borracha antiderrapante e reforço entre eles em aço treliçado 6,35mm, acabamento em chapa de aço inox.
- LV 147 - Estrutura inox, degraus em MDF revestido em borracha antiderrapante e reforço entre eles em aço treliçado de aço inox 6,35mm, acabamento em chapa de aço inox.
- LV 175 - Estrutura em tubo de aço carbono pintada em epóxi pó após tratamento antirreferruginoso, degraus em chapa de alumínio 1,20mm dobrada com sacos antiderrapante e reforço na parte inferior em chapa de aço inox 0,80mm, reforço entre os degraus em aço treliçado 6,35mm.
- LV 175 - Estrutura inox, degraus em chapa de alumínio 1,20mm dobrada com sacos antiderrapante e reforço na parte inferior em chapa de aço inox 0,80mm, reforço entre os degraus em aço treliçado 6,35mm.



### Dimensões padrão:

cada péso C 0,40m x L 0,20m /

total C 0,54m x L 0,40m x A primeiro degrau 0,18m / segundo degrau 0,34m.

CO  
FIS  
S  
S  
L  
P  
CAO

EDITO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, BAIXO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTAÇU - CE.

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR ITEM	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO POR ITEM	VALOR TOTAL
1	1	UNID	1	SALITAR	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	UNID. VAL. QUANTIDADE E VALOR TOTAL	R\$ 1.200,00
2	1	UNID	1	PHLEO	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00	UNID. VAL. QUANTIDADE E VALOR TOTAL	R\$ 1.840,00
3	1	UNID	1	EMITA	R\$ 14,00	R\$ 14,00	R\$ 14,00	QUANTIDADE VAL. QUANTIDADE E VALOR TOTAL	R\$ 14,00
4	1	UNID	1	GRADOM	R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00	UNID. VAL. QUANTIDADE E VALOR TOTAL	R\$ 1.860,00
5	1	UNID	1	ET BOLSONTEC	R\$ 4.840,00	R\$ 4.840,00	R\$ 4.840,00	QUANT. VAL. QUANTIDADE E VALOR TOTAL	R\$ 4.840,00
6	1	UNID	1	BRUNO	R\$ 217,00	R\$ 217,00	R\$ 217,00	QUANTIDADE E VALOR TOTAL	R\$ 217,00
7	1	UNID	1	7-40000	R\$ 1.022,00	R\$ 1.022,00	R\$ 1.022,00	UNID. VAL. QUANTIDADE E VALOR TOTAL	R\$ 1.022,00
8	1	UNID	1	MONTECARD	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	QUANTIDADE E VALOR TOTAL	R\$ 80,00
9	1	UNID	1	MOBY	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	UNID. VAL. QUANTIDADE E VALOR TOTAL	R\$ 140,00
10	1	UNID	1	540004	R\$ 211,00	R\$ 211,00	R\$ 211,00	DOS VAL. QUANTIDADE E VALOR TOTAL	R\$ 211,00
11	1	UNID	1	NOVO RICH	R\$ 68,00	R\$ 68,00	R\$ 68,00	QUANTIDADE E VALOR TOTAL	R\$ 68,00
12	1	UNID	1	OP 10007408	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	QUANTIDADE E VALOR TOTAL	R\$ 14.000,00
13	1	UNID	1	ET BOLSONTEC	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00	QUANT. VAL. QUANTIDADE E VALOR TOTAL	R\$ 1.210,00
14	1	UNID	1	MO	R\$ 1.570,00	R\$ 1.570,00	R\$ 1.570,00	UNID. VAL. QUANTIDADE E VALOR TOTAL	R\$ 1.570,00
15	1	UNID	1	PREMIUM	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00	QUANTIDADE E VALOR TOTAL	R\$ 290,00
16	1	UNID	1	PREMIUM	R\$ 181,00	R\$ 181,00	R\$ 181,00	QUANTIDADE E VALOR TOTAL	R\$ 181,00
17	1	UNID	1	PREMIUM	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	QUANTIDADE E VALOR TOTAL	R\$ 90,00
18	1	UNID	1	ANALITE	R\$ 272,00	R\$ 272,00	R\$ 272,00	QUANTIDADE E VALOR TOTAL	R\$ 272,00
19	1	UNID	1	GRADOM	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	QUANTIDADE E VALOR TOTAL	R\$ 520,00

p-2  
 p-1  
 p-3  
 p-3

p-2

p-3

p-2

Handwritten signature and initials.

PROPOSTA

20	Material de Acabamento para Esquadriação METALIZADA DE AÇO INOXIDÁVEL   COBERTURA AO ALUMÍNIO BRANCO   TPO	UNID	2	PREMIUM	R\$	378,00	TRINTA E SETE MIL E OITO REAIS	R\$	756,00	TRINTA E SETE MIL E OITO REAIS	
21	Material de Acabamento para Esquadriação METALIZADA DE AÇO INOXIDÁVEL   COBERTURA AO ALUMÍNIO BRANCO   TPO	UNID	5	PREMIUM	R\$	328,00	TRINTA E SEIS MIL E OITO REAIS	R\$	1.640,00	TRINTA E SEIS MIL E OITO REAIS	
22	Material de Acabamento para Esquadriação METALIZADA DE AÇO INOXIDÁVEL   COBERTURA AO ALUMÍNIO BRANCO   TPO	UNID	1	EPSON	R\$	1.190,00	TRÊS MIL, CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS	R\$	1.190,00	TRÊS MIL, CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS	
23	Massa Epoxídica Condutiva para Esquadriação METALIZADA   METALIZADA BRANCA   DE COBERTURA AÇO OU FERRO ENFUNDADO	UNID	1	MICROMED	R\$	1.714,00	UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS	R\$	1.714,00	UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS	
24	Massa Epoxídica Condutiva para Esquadriação METALIZADA   METALIZADA BRANCA   DE COBERTURA AÇO OU FERRO ENFUNDADO	UNID	1	MICROMED	R\$	95,00	NOVENTA E CINCO REAIS	R\$	95,00	NOVENTA E CINCO REAIS	
25	Massa Epoxídica Condutiva para Esquadriação METALIZADA   TAMPÃO AÇO OU FERRO   BRANCO   METALIZADA BRANCA   METALIZADA BRANCA   METALIZADA BRANCA	UNID	1	MOBY	R\$	163,00	CENTO E SESENTA E TRÊS REAIS	R\$	163,00	CENTO E SESENTA E TRÊS REAIS	
26	Reguladores Condutivos para Esquadriação TPO DE COBERTURA	UNID	2	PORTAL INOXIDÁVEL	R\$	2.074,00	DOIS MIL E SETENTA E CINCO REAIS	R\$	4.148,00	DOIS MIL E SETENTA E CINCO REAIS	
27	Reguladores Condutivos para Esquadriação METALIZADA   COBERTURA AO ALUMÍNIO BRANCO   METALIZADA BRANCA   METALIZADA BRANCA   METALIZADA BRANCA	UNID	1	MIKAYOS	R\$	1.612,00	UM MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS	R\$	1.612,00	UM MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS	
28	Regulador Polimérico para Acabamento para Esquadriação METALIZADA   METALIZADA BRANCA   METALIZADA BRANCA   METALIZADA BRANCA	UNID	1	MICROMED	R\$	362,00	TRINTA E DOIS REAIS	R\$	362,00	TRINTA E DOIS REAIS	
29	Regulador Polimérico para Acabamento para Esquadriação METALIZADA   METALIZADA BRANCA   METALIZADA BRANCA   METALIZADA BRANCA	UNID	1	MICROMED	R\$	137,00	TRINTA E CINQUENTA E SETE REAIS	R\$	137,00	TRINTA E CINQUENTA E SETE REAIS	
30	Regulador Polimérico para Acabamento para Esquadriação METALIZADA   METALIZADA BRANCA   METALIZADA BRANCA   METALIZADA BRANCA	UNID	1	PORTAL INOXIDÁVEL	R\$	362,00	QUARENTA E DOIS REAIS	R\$	362,00	QUARENTA E DOIS REAIS	
31	Regulador Polimérico para Acabamento para Esquadriação METALIZADA   METALIZADA BRANCA   METALIZADA BRANCA   METALIZADA BRANCA	UNID	1	MOONTRON	R\$	1.748,00	UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS	R\$	1.748,00	UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS	
32	Regulador Polimérico para Acabamento para Esquadriação METALIZADA   METALIZADA BRANCA   METALIZADA BRANCA   METALIZADA BRANCA	UNID	1	CB	R\$	6.476,00	SEIS MIL, QUARENTA E OITO REAIS	R\$	6.476,00	SEIS MIL, QUARENTA E OITO REAIS	
33	Carimbo Epoxídico Condutiva para Esquadriação METALIZADA   METALIZADA BRANCA   METALIZADA BRANCA   METALIZADA BRANCA	UNID	1	CART	R\$	17.084,00	DEZESSETE MIL E OITENTA E QUATRO REAIS	R\$	17.084,00	DEZESSETE MIL E OITENTA E QUATRO REAIS	
34	Carimbo Epoxídico Condutiva para Esquadriação METALIZADA   METALIZADA BRANCA   METALIZADA BRANCA   METALIZADA BRANCA	UNID	1	UN LPT	R\$	83,00	OTTENTA E DOIS REAIS	R\$	83,00	OTTENTA E DOIS REAIS	
35	Carimbo Epoxídico Condutiva para Esquadriação METALIZADA   METALIZADA BRANCA   METALIZADA BRANCA   METALIZADA BRANCA	UNID	1	CHAFFRIN	R\$	8.433,00	TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS	R\$	8.433,00	TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS	
36	Regulador de Aço Condutivos para Esquadriação COBERTURA AO ALUMÍNIO BRANCO   METALIZADA BRANCA   METALIZADA BRANCA	UNID	1	PLAS	R\$	2.362,00	DOIS MIL, QUARENTA E DOIS REAIS	R\$	2.362,00	DOIS MIL, QUARENTA E DOIS REAIS	
37	Regulador de Aço Condutivos para Esquadriação TPO METALIZADA BRANCA   METALIZADA BRANCA   METALIZADA BRANCA	UNID	1	MOLYTER	R\$	1.172,00	UM MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS	R\$	1.172,00	UM MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS	
38	Regulador de Aço Condutivos para Esquadriação TPO METALIZADA BRANCA   METALIZADA BRANCA   METALIZADA BRANCA	UNID	1	VONDER	R\$	16.311,00	DEZ MIL, QUARENTA E OITO REAIS	R\$	16.311,00	DEZ MIL, QUARENTA E OITO REAIS	
39	Regulador de Aço Condutivos para Esquadriação METALIZADA   METALIZADA BRANCA   METALIZADA BRANCA   METALIZADA BRANCA	UNID	1	MP HOSPITALAR	R\$	321,00	TRINTA E TRÊS MIL E UM REAIS	R\$	321,00	TRINTA E TRÊS MIL E UM REAIS	
40	Carimbo de Aço Condutivos para Esquadriação METALIZADA   METALIZADA BRANCA   METALIZADA BRANCA   METALIZADA BRANCA	UNID	1	MOVONER	R\$	1.138,00	UM MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS	R\$	1.138,00	UM MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS	
41	Carimbo de Aço Condutivos para Esquadriação METALIZADA   METALIZADA BRANCA   METALIZADA BRANCA   METALIZADA BRANCA	UNID	1	PLAT	R\$	53.953,00	OITENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS	R\$	53.953,00	OITENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS	
VALOR TOTAL									R\$	158.592,00	CENTO E NOVENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS

**PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:** Conforme o edital.  
**Prazo de entrega:** conforme o edital.  
**Condição de entrega:** Conforme o edital.  
**Condições de pagamento:** Conforme o edital.  
**Local de entrega:** Conforme o edital.  
**Modelo:** Conforme Solicitação na OF e Especificação do termo de referência.  
**Prazo de validade/paralisa:** De acordo com o fabricante.  
**Procedência:** Nacional  
**VALIDADE DA PROPOSTA:** 120 (cento e vinte) dias.  
 Declaramos para fins de direito, a qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob modalidade Pregão Eletrônico nº 1610.01/2023-005/PE instaurado pela Prefeitura Municipal de Fortim-CE  
 \* Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-se a eventuais averiguações que se façam necessárias.  
 \* Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, e compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
 \* Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incididas sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicadas durante a vigência do Contrato.  
 \* Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 1610.01/2023-005/PE realizado pela Prefeitura de Fortim-CE  
**PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DO SERVIÇO:** DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.  
 Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens ou abatimentos, impostos, transportes (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outra quaisquer que incidam sobre a contratação.  
 DECLARA, que não possui cargo, gerente e diretores, servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM e ainda cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau.  
 Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que satiza plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art.4º, VII da Lei nº 10.520/2002.

*(Handwritten signatures and initials)*

**ÓRGÃO/ CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM/CE**  
**PROCESSO LICITATÓRIO N°. 1610.01/2023 - SMS/PE**

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE.

O signatário da presente, em nome da empresa, propõe:

1) Os seguintes preços, por ITENS cotados:

ITEM	MARCA / FABRICANTE	ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	SANTA CLARA	Mesa de Exames Característica Física ESTRUTURA   MATERIAL DE CONFECCÃO Especificação COM ARMÁRIO   MADEIRA OU MDF	UNID	1	3.209,00	3.209,00 p. 2
02	CONSUL	Ar Condicionado Característica Física TIPO   CAPACIDADE   CICLO Especificação SPLIT   9000 A 12000 BTUs   QUENTE E FRIO	UNID	1	1.843,00	1.843,00 p. 2
06	ECOBIN	Balde a Pedal Característica Física Especificação MATERIAL DE CONFECCÃO   CAPACIDADE AÇO INOX   DE 30L ATÉ 49L	UNID	1	327,00	327,00 p. 2
08	SANTA CLARA	Escada com 2 degraus Característica Física Especificação DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL	UNID	3	301,00	903,00
11	SANTA CLARA	Mesa de Mayo Característica Física Especificação MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL	UNID	2	638,00	1.276,00
12	GG EQUIPAMENTOS	Colposcópico Característica Física Especificação AUMENTO   CÂMERA VARIÁVEL   POSSUI   MONITOR NÃO POSSUI	UNID	1	18.388,00	18.388,00
14	MEDPEJ	Detector Fetal Característica Física Especificação TIPO   TECNOLOGIA   DE MESA   DIGITAL DISPLAY   TAMANHO   POSSUI   DE 3 A 5 MONITOR   ALIMENTAÇÃO POL   REDE ELÉTRICA E BATERIA	UNID	1	1.576,00	1.576,00
15	PREMIUM	Esfigmomanômetro Adulto Característica Física Especificação TIPO   MATERIAL DE ANALÓGICO   CONFECCÃO DA NYLON OU TECIDO BRAÇADEIRA EM ALGODÃO	UNID	1	359,00	359,00
16	PREMIUM	Esfigmomanômetro Infantil Característica Física Especificação TIPO ANALÓGICO	UNID	1	181,00	181,00
17	PREMIUM	Esfigmomanômetro Obeso Característica Física Especificação TIPO   MATERIAL DE ANALÓGICO   CONFECCÃO DA NYLON OU TECIDO BRAÇADEIRA EM ALGODÃO	UNID	1	366,00	366,00
18	WELMY	Estadiômetro Característica Física Especificação MATERIAL DE ALUMÍNIO CONFECCÃO	UNID	1	772,00	772,00
20	PREMIUM	Estetoscópio Adulto Característica Física Especificação MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL   CONFECCÃO DO DUPLO AUSCULTADOR   TIPO	UNID	2	378,00	756,00
21	PREMIUM	Estetoscópio Infantil Característica Física Especificação MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL	UNID	1	328,00	328,00

U R

		CONFECCÃO DO DUPLO AUSCULTADOR   TIPO				
23	SANTA CLARA	Mesa Ginecológica Característica Física Especificação ESTRUTURA   MATERIAL SEM ARMÁRIO   DE CONFECCÃO AÇO OU FERRO PINTADO	UNID	1	1.714,00	1.714,00
24	MIKAT OS	Lanterna Clínica Característica Física Especificação TIPO LED	UNID	1	95,00	95,00
26	GG EQUIPAMENTO S	Negatoscópio Característica Física Especificação TIPO 02 CORPOS	UNID	1	2.075,00	2.075,00
27	MIKAT OS	Otoscópio Simples Característica Física Especificação ALIMENTAÇÃO   CARREGADOR DE ILUMINAÇÃO   MESA PARA CABO ESPECULOS RECARREGÁVEL COM BATERIA DE LÍTIU   FIBRA ÓPTICA   LED   5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS	UNID	1	1.612,00	1.612,00
28	MIKAT OS	Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) Característica Física Especificação MATERIAL DE SILICONE   POSSUI   CONFECCÃO   VÁLVULA POSSUI   POSSUI DE PEEP   VÁLVULA UNIDIRECIONAL   RESERVATÓRIO	UNID	1	302,00	302,00
29	MIKAT OS	Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu) Característica Física Especificação RESERVATÓRIO   POSSUI   SILICONE   MATERIAL DE INFANTIL   POSSUI CONFECCÃO   APLICAÇÃO   VÁLVULA UNIDIRECIONAL	UNID	1	357,00	357,00
30	SANTA CLARA	Suporte de Soro Característica Física Especificação TIPO   MATERIAL DE PEDESTAL   AÇO CONFECCÃO INOXIDÁVEL	UNID	1	593,00	593,00
32	SANTA RÉM	Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) Característica Física Especificação MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL   ATÉ 25 L	UNID	1	6.476,00	6.476,00
33	SANTA RÉM	Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) Característica Física Especificação TERMINAIS   ATÉ 3 EQUIPO   TIPO CART OU ACOPLADO COMANDO DA PEDAL CADEIRA   CABECEIRA   POSSUI REFLETOR   POSSUI CUBA   PORCELANA/CERÂMICA SERINGA TRÍPLICE   POSSUI PEÇA RETA   POSSUI CONTRA ÂNGULO   POSSUI MICRO MOTOR   POSSUI CANETA DE ROTAÇÃO   POSSUI UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR)   POSSUI MOCHO   POSSUI	UNID	1	17.084,00	17.084,00
36	SOLIDS TEEL	Destilador de Água Características Físicas Especificações CAPACIDADE ATÉ 5 LITROS   HORA	UNID	1	2.500,00	2.500,00
37	DENTMED	Fotopolimerizador de Resinas Características Físicas Especificações TIPO LED, SEM FIO, SEM RADIÔMETRO	UNID	1	1.172,00	1.172,00
39	SANTA CLARA	Braçadeira para Injeção Características Físicas Especificações MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL   CONFECCÃO   AÇO INOXIDÁVEL   ESTRUTURA E APOIO DO BRAÇO   TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	UNID	1	331,00	331,00

J  
 K

40	SANTA CLARA	Carro de Curativos Características Físicas Especificações MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL CONFECCÃO BALDE E BACIA ACESSÓRIOS	UNID	1	1.128,00	1.128,00
<b>VALOR TOTAL - R\$</b>						<b>65.723,00</b>

**VALOR TOTAL: R\$ 65.723,00 (SESSENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS)**

**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.**


Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

09 de Novembro de 2023.

J

J



A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM  
FORTIM-CE

**PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREÇO ELETRÔNICO Nº 1610.01/2023**

ABERTURA: 09/11/2023  
HORÁRIO: 11:30

PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa nº	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
12	1	UND	Colposcópio Característica Física Especificação AUMENTO I CÂMERA VARIÁVEL I POSSUI I I MONITOR NÃO POSSUI	MEDPEJ/ MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP/ PE7000/ 80127840014	18.000,00	18.000,00
14	1	UND	Detector Fetal Característica Física Especificação TIPO I TECNOLOGIA I DE MESA I DIGITAL DISPLAY I TAMANHO I POSSUI I DE 3A5 MONITOR I ALIMENTAÇÃO POL I REDE ELÉTRICA E BATERIA	JUMPER/ ShenZhen Jumper Medical Equipment Co.,Ltd./ JPD-100E/ 80901110024	1.500,00	1.500,00
15	1	UND	Esfignomanômetro Adulto Característica Física TIPO I MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA Especificação ANALÓGICO I NYLON OU TECIDO EM ALGODÃO	PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD./ BR-200 ADULTO/ 80275310022	350,00	350,00
16	1	UND	Esfignomanômetro Infantil Característica Física TIPO Especificação ANALÓGICO	PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD./ BR-200 INFANTIL/ 80275310022	180,00	180,00

✓

17	1	UND	Esfigmomanômetro Obeso Característica Física TIPO I MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA Especificação ANALÓGICO I NYLON OU TECIDO EM ALGODÃO	PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD./ BR-200 ADULTO GRANDE/ 80275310022	360,00	360,00
20	2	UND	Estetoscópio Adulto Característica Física MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR I TIPO Especificação AÇO INOXIDÁVEL I DUPLO	KINDCARE/ WENZHOU DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA/ KT-107/ 80901110021	370,00	740,00
21	1	UND	Estetoscópio Infantil Característica Física MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR I TIPO Especificação AÇO INOXIDÁVEL I DUPLO	KINDCARE/ WENZHOU DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA/ KT-108/ 80901110021	300,00	300,00
27	1	UND	Otoscópio Simples Característica Física ALIMENTAÇÃO I ILUMINAÇÃO I ESPECULOS Especificação CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGÁVEL COM BATERIA DE LÍTIO I FBRA ÓPTICA LED 1.5 A 10	DAD&SONS/ DAD&SONS SURGICAL INDUSTRY/ DNS-1003/ 81965540001	1.600,00	1.600,00
28	1	UND	Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) Característica Física Especificação MATERIAL DE SILICONE I POSSUI I CONFECÇÃO I VÁLVULA POSSUI I POSSUI DE PEEP I VÁLVULA UNIDIRECIONAL I RESERVATÓRIO	COMPOWER/ Xiamen Compower Medical Tech. CO., Ltd. - CHINA/ CP611111/ 80901110012	300,00	300,00

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



29	1	UND	Reanimador Pulmonar Manual Característica Física RESERVATÓRIO   MATERIAL DE CONFEÇÃO   APLICAÇÃO   VÁLVULA UNIDIRECIONAL Pediátrico (Ambu) Especificação POSSUI   SILICONE   INFANTIL POSSUI	COMPOWER/ Xiamen Compower Medical Tech. CO., Ltd. - CHINA/ CP612111/ 80901110012	300,00	300,00
					TOTAL	23.630,00

**Declaramos:**

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



DECLARA, que:

- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possuo 08 (oito) funcionários em minha empresa.

Pinhais, 09 de novembro de 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	V. UNITÁRIO POR EXTENSO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL POR EXTENSO	V. TOTAL
4	Armário Característica Física Especificação MATERIAL DE AÇO 1 ALTURA DE 100 CONFEÇÃO 1 A 210 CM X LARGURA DIMENSÕES 1 DE 70 A PRATELEIRAS 1 110 CM 1 03 OU 04 1 CAPACIDADE 20KG MÍNIMA DA PRATELEIRA	AMAPÁ	ARMÁRIO 90	UND	1	mil e cinquenta e seis reais	R\$ 1.056,00	mil e cinquenta e seis reais	R\$ 1.056,00
5	Computador (Desktop-Básico) Especificação Técnica especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3,0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB, interface PCIe NVMe,M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x 16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor standard. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (wide screen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.	FÁCIL COMPUTADORES	PREMIUM	UND	1	quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais	R\$ 4.624,00	quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais	R\$ 4.624,00
6	Balde a Pedal Característica Física Especificação MATERIAL DE A CONFEÇÃO 1 DE 30L CAPACIDADE ATÉ 49L	BRINOX	BALDE PEDAL 30 LT	UND	1	trezentos e vinte e sete reais	R\$ 327,00	trezentos e vinte e sete reais	R\$ 327,00
7	No-break (Para Computador/Impressora) Especificação Técnica (Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.	RAGTECH	EASY WAY	UND	1	mil e vinte e dois reais	R\$ 1.022,00	mil e vinte e dois reais	R\$ 1.022,00
8	Escada com 2 degraus Característica Física Especificação DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	TUBOMED	TM 082	UND	3	trezentos e um reais	R\$ 301,00	noventa e três reais	R\$ 903,00
9	Mesa de Escritório Característica Física Especificação MATERIAL DE MADEIRA OU MDP OU CONFEÇÃO 1 * FORMATO 1 GAVETAS {	PLENO MÓVEIS	MESA LIGHT	UND	2	seiscentos e quarenta e nove reais	R\$ 649,00	mil duzentos e noventa e oito reais	R\$ 1.298,00
10	Cadeira Característica Física Especificação MATERIAL DE A CONFEÇÃO 1 AÇ * MU FERR9 raizemde poZZIT ALTI RODÍZIOS Zopht™ 1. ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	PLENO MÓVEIS	CADEIRA SECRETÁRIA	UND	12	duzentos e dezesseis reais	R\$ 216,00	dois mil, quinhentos e noventa e dois reais	R\$ 2.592,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
16/11/2017

*[Handwritten mark]*

11	Mesa de Mayo Característica Física Especificação MATERIAL DE Aço INOXIDÁVEL	TUBOMED	TM 084	UND	2	seiscentos e trinta e oito reais	R\$ 638,00	mil duzentos e setenta e seis reais	R\$ 1.276,00
12	Colposcópico Característica Física Especificação ALIMENTO 1 CÂMERA VARIÁVEL 1 POSSUI 1 MONITOR NÃO POSSUI	GG	MOSOD VARIÁVEL + CAMERA HDMI	UND	1	dezoito mil, trezentos e oitenta e oito reais	R\$ 18.388,00	dezoito mil, trezentos e oitenta e oito reais	R\$ 18.388,00
13	Computador Portátil (Notebook) Especificação Técnica Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (Notebook) com processador que possua no mínimo 4 núcleos, 8 threads e frequência de 2.4 GHz; unidade de armazenamento sólido 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 3000 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, anti reflexo, suportar resolução Full HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 fêmea e wifi padrão IEEE 802.11 b/g/n/a, bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 10 Pro (64 bits), bateria recarregável do tipo Ion com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou Display Port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam Full HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.	SAMSUNG	SAMSUNG BOOK	UND	1	cinco mil, duzentos e vinte e seis reais	R\$ 5.226,00	cinco mil, duzentos e vinte e seis reais	R\$ 5.226,00
14	Detector Fetal Característica Física Especificação TIPO 1 TECNOLOGIA 1 DE MESA 1 DIGITAL DISPLAY 1 TAMANHO 1 POSSUI 1 DE 3 A 5 MONITOR 1 ALIMENTAÇÃO POL 1 REDE ELÉTRICA E BATERIA	MD	FD300D	UND	1	mil quinhentos e setenta e seis reais	R\$ 1.576,00	mil quinhentos e setenta e seis reais	R\$ 1.576,00
15	Esfigmomanômetro Adulto Característica Física Especificação TIPO 1 MATERIAL DE ANALÓGICO 1 CONFEÇÃO DA NYLON OU TECIDO BRACADEIRA EM ALGODÃO	ACCUMED	PREMIUM	UND	1	trezentos e cinquenta e nove reais	R\$ 359,00	trezentos e cinquenta e nove reais	R\$ 359,00
16	Esfigmomanômetro Infantil Característica Física Especificação TIPO ANALÓGICO	ACCUMED	PREMIUM	UND	1	cento e oitenta e um reais	R\$ 181,00	cento e oitenta e um reais	R\$ 181,00
17	Esfigmomanômetro Obeso Característica Física Especificação TIPO 1 MATERIAL DE ANALÓGICO 1 CONFEÇÃO DA NYLON OU TECIDO BRACADEIRA EM ALGODÃO	ACCUMED	PREMIUM	UND	1	trezentos e sessenta e seis reais	R\$ 366,00	trezentos e sessenta e seis reais	R\$ 366,00
18	Estadiômetro Característica Física Especificação MATERIAL DE ALUMÍNIO CONFEÇÃO	BALMAK	ESTADIOMETRO	UND	1	setecentos e setenta e dois reais	R\$ 772,00	setecentos e setenta e dois reais	R\$ 772,00
19	Estante Característica Física MATERIAL DE CONFEÇÃO 1 CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS 1 REFORÇO Especificação AÇO OU FERRO PINTADO 1 DE 101 A 200 KG 1 POSSUI	AMAPÁ	DUPLA FLEX	UND	1	quinhentos e vinte e três reais	R\$ 523,00	quinhentos e vinte e três reais	R\$ 523,00
20	Estetoscópio Adulto Característica Física MATERIAL DE CONFEÇÃO DO AUSCULTADOR 1 TIPO Especificação AÇO INOXIDÁVEL 1 DUPLA	ACCUMED	PREMIUM	UND	2	trezentos e setenta e oito reais	R\$ 378,00	setecentos e cinquenta e seis reais	R\$ 756,00
21	Estetoscópio Infantil Característica Física MATERIAL DE CONFEÇÃO DO AUSCULTADOR 1 TIPO Especificação AÇO INOXIDÁVEL 1 DUPLA	ACCUMED	PREMIUM	UND	1	trezentos e vinte e oito reais	R\$ 328,00	trezentos e vinte e oito reais	R\$ 328,00
22	Impressora Laser (Comum) Especificação Técnica Especificação Mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel A5, A4 carta e office; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio a rede 10/100/1000 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento	HP	4003DW	UND	1	três mil, cento e noventa e três reais	R\$ 3.193,00	três mil, cento e noventa e três reais	R\$ 3.193,00

*[Handwritten mark]*



Ac

23	Mesa Ginecológica Característica Física ESTRUTURA 1 MATERIAL DE CONFEÇÃO SEM ARMÁRIO 1 AÇO OU FERRO PINTADO	TUBO MED	TM 079	UND	1	mil setecentos e quatorze reais	R\$ 1.714,00	mil setecentos e quatorze reais	R\$ 1.714,00
24	Lanterna Clínica Característica Física TIPO Especificação LED	MD	RADIANTLITE II	UND	1	noventa e cinco reais	R\$ 95,00	noventa e cinco reais	R\$ 95,00
25	Mesa para Impressora Característica Física ESTRUTURA 1 TAMPO 1 DIMENSÕES MÍNIMAS Especificação AÇO OU FERRO PINTADO 1 MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR 1 MÍNIMO DE 50 X 40 X 70CM	PLENO MÓVEIS	MESA LIGHT	UND	1	cento e sessenta e três reais	R\$ 163,00	cento e sessenta e três reais	R\$ 163,00
26	Negatoscópio Característica Física TIPO Especificação 02 CORPOS	GG	MD400	UND	1	dois mil e setenta e cinco reais	R\$ 2.075,00	dois mil e setenta e cinco reais	R\$ 2.075,00
27	Otoscópio Simples Característica Física ALIMENTAÇÃO 1 ILUMINAÇÃO 1 ESPECULOS Especificação CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGÁVEL COM BATERIA DE LÍTHIO 1 FIBRA ÓPTICA 1 LED 1 5 A 10	MD	OMNI LED	UND	1	mil setecentos e doze reais	R\$ 1.612,00	mil setecentos e doze reais	R\$ 1.612,00
28	Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) Característica Física Especificação MATERIAL DE SILICONE 1 POSSUI 1 CONFEÇÃO 1 VÁLVULA POSSUI 1 POSSUI DE PEEP 1 VÁLVULA UNIDIRECIONAL 1 RESERVATÓRIO	MD	REANIMADOR PULMONAR	UND	1	trezentos e dois reais	R\$ 302,00	trezentos e dois reais	R\$ 302,00
29	Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu) Característica Física Especificação RESERVATÓRIO 1 POSSUI 1 SILICONE 1 MATERIAL DE INFANTIL 1 POSSUI CONFEÇÃO 1 APLICAÇÃO 1 VÁLVULA UNIDIRECIONAL	MD	REANIMADOR PULMONAR	UND	1	trezentos e cinquenta e sete reais	R\$ 357,00	trezentos e cinquenta e sete reais	R\$ 357,00
30	Suporte de Soro Característica Física Especificação TIPO 1 MATERIAL DE PEDESTAL 1 AÇO CONFEÇÃO INOXIDÁVEL	TUBOMED	TM 093	UND	1	quinhentos e noventa e três reais	R\$ 593,00	quinhentos e noventa e três reais	R\$ 593,00
31	Amalgamador Odontológico Característica Física Especificação TIPO 1 MODO DE CAPSULAR 1 DIGITAL OPERAÇÃO	SCHUSTER	VIBRAMAT CAPSULAR SPEED II	UND	1	mil setecentos e quarenta e cinco reais	R\$ 1.745,00	mil setecentos e quarenta e cinco reais	R\$ 1.745,00
32	Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) Característica Física Especificação MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL 1 ATÉ 25 L 1 CAPACIDADE	STERMAX	30AHGSFBRBLVT	UND	1	seis mil, quatrocentos e setenta e seis reais	R\$ 6.476,00	seis mil, quatrocentos e setenta e seis reais	R\$ 6.476,00
34	Caixa para Desinfecção de Limas Endodôncas Características Físicas Especificação CAPACIDADE 1 ATÉ 10 LIMAS	FAVA	CADIA DESINFECÇÃO 10 LT	UND	1	oitenta e dois reais	R\$ 82,00	oitenta e dois reais	R\$ 82,00
35	Compressor Odontológico Características Físicas Especificações CAPACIDADE 30 A 39 L 1 1 A 1,5HP 1 RESERVATÓRIO 1 6 A 7 PÉS POTÊNCIA 1 CONSUMO 1 ISENTO DE ÓLEO SIM	EVOXX	30L	UND	1	três mil, quatrocentos e cinquenta e três reais	R\$ 3.453,00	três mil, quatrocentos e cinquenta e três reais	R\$ 3.453,00
36	Destilador de Água Características Físicas Especificações CAPACIDADE ATÉ 5 LITROS 1 HORA	SOLIS STEEL	DESTILADOR 5 LT	UND	1	dois mil e quinhentos reais	R\$ 2.500,00	dois mil e quinhentos reais	R\$ 2.500,00
37	Fotopolimerizador de Resinas Características Físicas Especificações TIPO LED, SEM FIO, SEM RADÍOMETRO	SCHUSTER	EMITTER C	UND	1	mil cento e setenta e dois reais	R\$ 1.172,00	mil cento e setenta e dois reais	R\$ 1.172,00
39	Braçadeira para Injeção Características Físicas Especificações MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL 1 CONFEÇÃO 1 AÇO INOXIDÁVEL 1 ESTRUTURA E APOIO DO BRAÇO 1 TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	TUBO MED	TM 090	UND	1	trezentos e trinta e um reais	R\$ 331,00	trezentos e trinta e um reais	R\$ 331,00
40	Carro de Curativos Características Físicas Especificações MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL 1 CONFEÇÃO 1 BALDE E BACIA ACESSÓRIOS	TUBO MED	TM 075	UND	1	mil cento e vinte e oito reais	R\$ 1.128,00	mil cento e vinte e oito reais	R\$ 1.128,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 68.944,00</b>			
<b>VALOR TOTAL POR EXTENSO</b>						<b>sessenta e oito mil, novecentos e quarenta e quatro reais</b>			

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Prazo de validade da Carta Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias: /

COMISSÃO LICITAÇÃO  
 102  
 CA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fl. 1620

*[Handwritten signature]*

— FOLHA 1620

*[Handwritten mark]*



✓

✓

Prazo de entrega será de até 20 (vinte) dias úteis  
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias  
FORTIMA/CE, 09 DE NOVEMBRO DE 2023.



PROPOSTA COMERCIAL  
FORTIM / CE  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 1610.01/2023 – SMS/PE

DATA: 08/11/2023

LOTE ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	<b>Detector Fuga</b> Característica Física TIPO   TECNOLOGIA   DISPLAY   TAMANHO   MONITOR   ALIMENTAÇÃO	1	MD FD 300 D	900,00	
	Especificação DE MESA   DIGITAL   POSSUI   DE 3 A 5 POL.   REDEF ELÉTRICA E BATERIA				
18	<b>Estadiômetro</b> Característica Física MATERIAL DE CONFEÇÃO	1	Balmak INF 100 P	300,00	
	Especificação ALUMÍNIO				
27	<b>Oscópio Simples</b> Característica Física ALIMENTAÇÃO   ILUMINAÇÃO   ESPECULOS	1	MD Omni 3000 OT + Carregador	1300,00	
	Especificação CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGÁVEL COM BATERIA DE LÍTIO   FIBRA ÓPTICA   LED   5 A 10				
32	<b>Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)</b> Característica Física MODO DE OPERAÇÃO   CAPACIDADE	1	BS Digitale	4500,00	
	Especificação DIGITAL   ATÉ 25 L				
35	<b>Compressor Odontológico</b> Características Físicas CAPACIDADE RESERVATÓRIO   POTÊNCIA   CONSUMO   ISENTO DE ÓLEO	1	TK 7040 35	3000,00	
	Especificações 30 A 39 L.   1 A 1,5HP   6 A 7 PES SIM				
36	<b>Destilador de Água</b> Características Físicas CAPACIDADE	1	Matex D	900,00	
	Especificações ATÉ 5 LITROS   HORA				

Handwritten signature or mark.

Handwritten mark.



38	<b>Grupo Gerador Portátil (Até 7 KVA)</b>	1		6500,00	
	Características Físicas	Especificações			
	POTÊNCIA   TIPO DE COMBUSTÍVEL	DE 4,1 A 7 KVA   DIESEL	Motomil MDG-5000CLE		

Frete incluso.

Prazo de entrega, validade da proposta, garantia, conforme o edital .

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta.

E, em consonância aos referidos documentos, declaramos:


1 - Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta do contrato;

2- Declaramos inteira submissão às condições constantes neste edital e seus anexos e que a proposta inclui quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com terceiros.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



Empresa

Produtos

Novidades

Contato

Home > Linha Médica > Sinais Vitais > Detector Fetal



*[Handwritten signature]*


*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



## Doppler Fetal de Mesa Digital FD-300D MD

Os detectores fetais MD da linha FD-300 são práticos e versáteis, possuem transdutores de alta sensibilidade e sua bateria recarregável permite maior flexibilidade em diferentes ambientes de atendimento materno-fetal.



Empresa

Produtos

Novidades

Contato




## Descrição

- Transdutor de alta sensibilidade
- Alto-falante de alta performance
- Design ergonômico e compartimento para transdutor
- Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador
- Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático
- Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal
- Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado
- Desligamento automático após 3 minutos sem utilização
- Certificado pelo INMETRO

## Conheça Também






Empresa

Produtos

Novidades

Contato



**Monitor Fetal  
Cardiotocógrafo Gemelar  
FC1400 Bionet**

**Estetoscópio Spirit MD  
Master Lite Pediátrico  
Verde**

**Este  
Mas**

**Empresa**

- Sobre Nos
- Governança
- Compliance & Ética
- Trabalhe Conosco

**Novidades**

- Todas
- Curiosidades
- Eventos
- Novidades
- Produtos

**Contato**

- Revendas
- Hospitais & Consumidor

**Produtos**

- Linha Médica
- Linha Vet
- Exames Físicos
- Exames Gráficos
- Sinais Vitais
- Suporte à Vida

**Atendimento**

- Fale com Vendas
- Suporte ao Cliente
- Assistência Técnica

**Termos**

- Política de Cookies
- Proteção de Dados

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
05/2023 08:21  
FIS. 16.511  
REQUISIÇÃO Nº 16.511  
MacroSul

Empresa

Produtos

Novidades

Contato



Comércio de Materiais Médicos Hospitalares MacroSul Ltda.

CNPJ: 95.433.397/0001-11

Rua Julio Bartolomeu Taborda Luiz 270

CEP: 82.600-070 | Curitiba - PR

Acompanhe a MacroSul



MacroSul © 2022 - Todos os direitos reservados - Criado por Nerdweb



COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
F. 166  
R. 10  
RUBRICA

# balmak

evolução. revolução.



UNHA

## ANTROPOMETRIA

(mensuração de medidas físicas  
do corpo humano)



A BALMAK é o fabricante nacional **PREMIUM** com  
a mais completa linha de ANTROPOMETRIA para  
uso clínico, avaliação física e fitness.

São infantômetros, estadiômetros, fitas e adipômetros  
especialmente desenvolvidos combinando tecnologia de  
ponta, precisão, robustez, durabilidade e um incrível design.

Produtos que proporcionam leituras fáceis e confiabilidade  
na mensuração de medidas físicas do corpo humano e suas  
partes, como comprimento ou circunferência.

Comprove a qualidade e experiência superior que só a  
Balmak, e suas muitas soluções, podem oferecer!

**balmak**  
evolução. revolução.

LANÇAMENTO

REGISTRO

# iTec Ultrasonic

Estadiômetro automático com tecnologia ultrassônica

1260

Corpo metálico em plástico ABS



Atua tecnologia e fácil manuseio  
(medição acompanhada / desacompanhada)

## DESCRIÇÃO

**Faixa de medição:** de 30 até 200 cm

**Resolução:** em centímetros

**Graduação:** 0,1 cm

**Tolerância:** +/- 1 cm

**Dimensões:** 25x7x6 cm

**Função:** controle através de um único botão

**Utilidade:** para uso em clínicas, hospitais, consultórios, academias, e saúde pública em geral

**Garantia:** 1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de materiais e/ou fabricação

**Display LCD**

**Feedback sonoro**

**Alimentação interna recarregável**

(acompanha fonte de alimentação)

**Desligamento automático**



1260

belmak



1260

belmak



# GONIO-360

Goniômetro grande em PVC

LANÇAMENTO



## DESCRIÇÃO

**Amplitude de leitura:** Sistema de transferidor de 0° a 360°; e marcação de 0 a 36 cm (com a régua aberta)

**Resolução:** em graus e milímetros

**Graduação:** 1 grau e 1 mm


**Espessura:** 0,85 mm

**Matéria-Prima:** goniômetro transparente em PVC

**Utilidade:** para uso em clínicas, hospitais, consultórios, academias, e saúde pública em geral

**Garantia:** 1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de materiais e/ou fabricação

Goniômetro transparente e compacto para duas régua graduada e unidas por um forte rebite que permite um giro de até 360° das régua, auxiliando o profissional na medição articular.

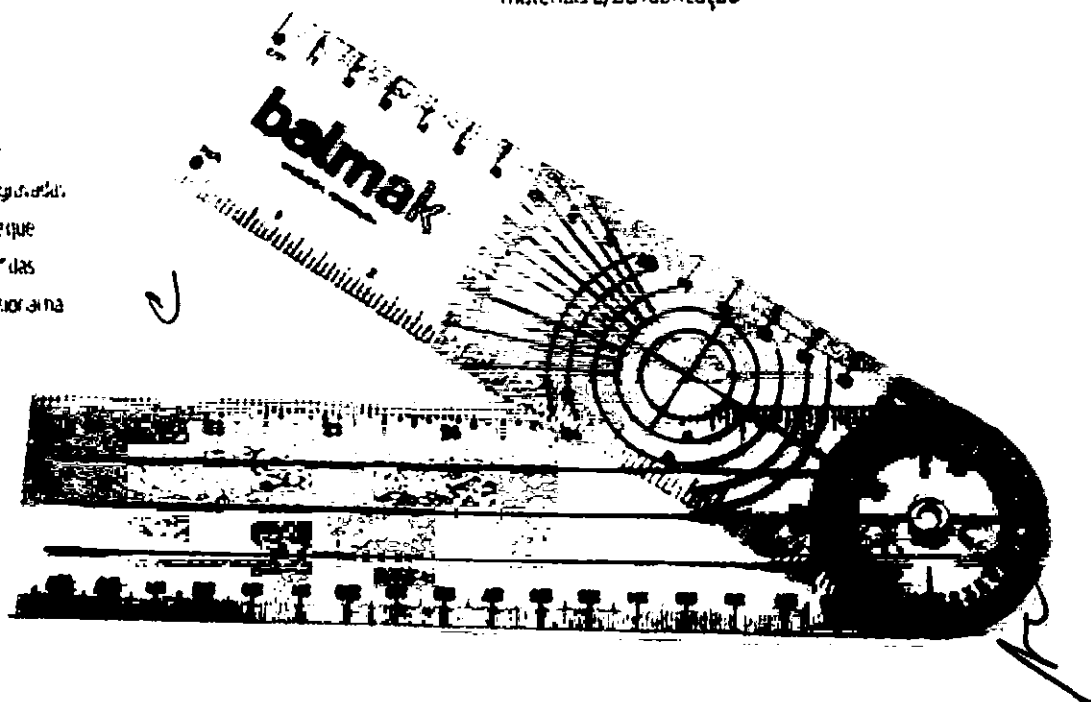


LANÇAMENTO

ACÇÃO

## CLINIC-PRO-MAX

Adipômetro científico, de uso profissional - com maleta

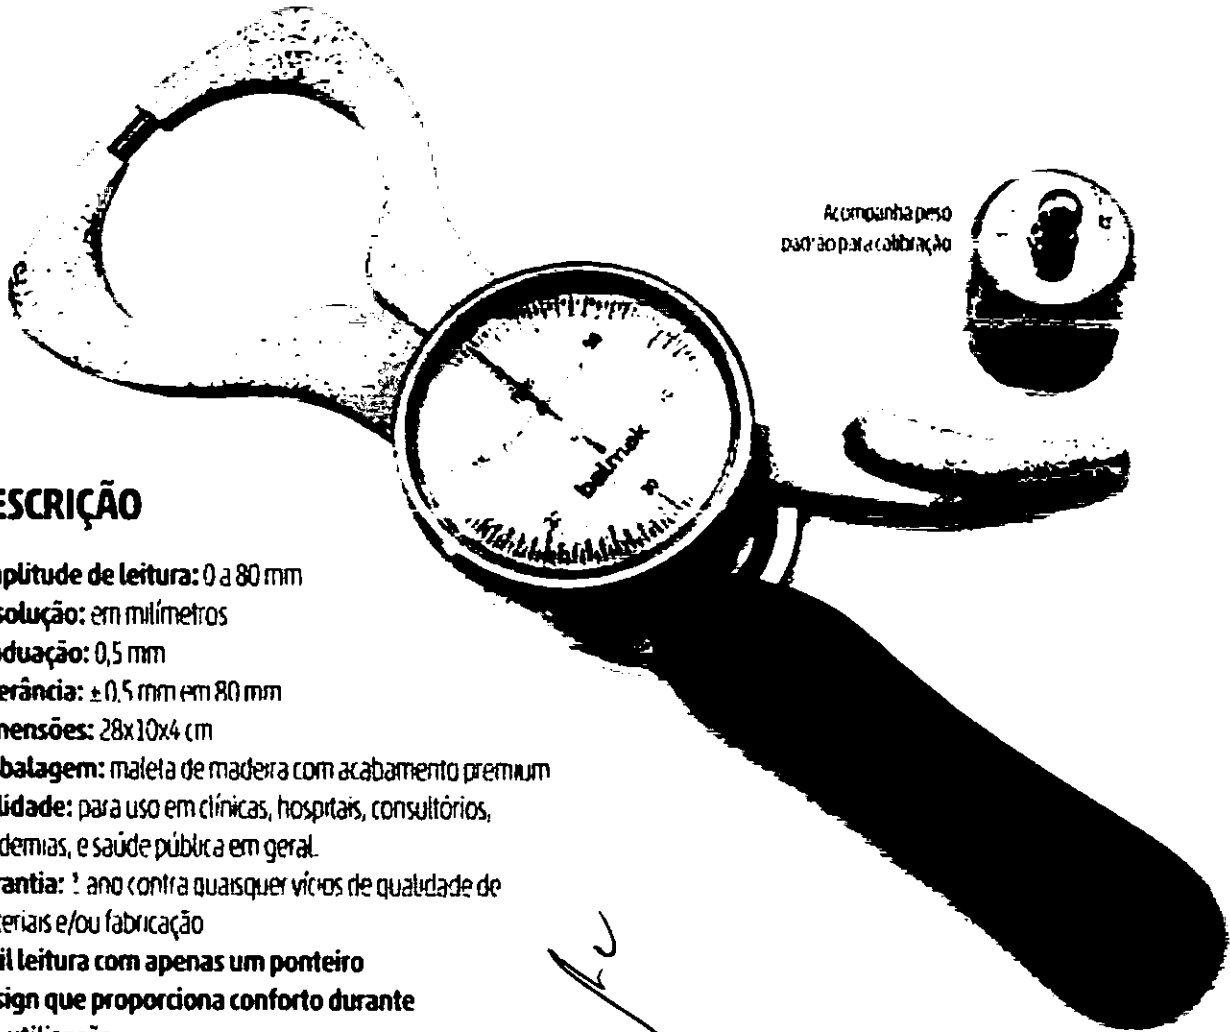

Acompanha peso padrão para calibração

### DESCRIÇÃO

**Amplitude de leitura:** 0 a 80 mm

**Resolução:** em milímetros

**Graduação:** 0,5 mm

**Tolerância:**  $\pm 0,5$  mm em 80 mm

**Dimensões:** 28x10x4 cm

**Embalagem:** maleta de madeira com acabamento premium


**Utilidade:** para uso em clínicas, hospitais, consultórios, academias, e saúde pública em geral.

**Garantia:** 1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de materiais e/ou fabricação

**Fácil leitura com apenas um ponteiro**

**Design que proporciona conforto durante sua utilização**

**Relógio de alta precisão e estabilidade dimensional**



Fácil leitura com apenas um ponteiro

Maleta de madeira com acabamento premium




# INF-100P

Infantômetro horizontal portátil para medir crianças, com paquímetro deslizadores



estado dobrado



movimento deslizante

## DESCRIÇÃO

**Faixa de medição:** de 6,5 até 99 cm

**Resolução:** em milímetros

**Graduação:** 1 mm

**Tolerância:** +/- 5mm em 99 cm.

**Matéria Prima:** Alumínio anodizado + plástico ABS injetado

**Utilidade:** Para uso em clínicas, maternidades, consultórios e saúde pública em geral

**Instalação:** Uso portátil, dispensa qualquer tipo de instalação (apresenta furação, e pode ser opcionalmente fixado em parede)

**Bolsa portátil:** Em caráter opcional, pode ser fornecido com bolsa portátil de nylon para transporte.

**Garantia:** 1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de materiais e/ou fabricação

**Peso líquido / Peso líquido com bolsa:** 660g / 800g

**Peso de embarque / Peso de embarque com bolsa:** 800g / 900g

## MODO DE OPERAÇÃO

**Movimentação**

de 6,5 até 99cm

(manter a mesma unidade de medida)



*Handwritten mark*

*Handwritten mark*




Bolsa portátil de nylon para transporte

*Handwritten mark*

## EST-221

Estadiômetro vertical, fixo de parede, para medir adultos e crianças, compacto, com fita de medição mecânica

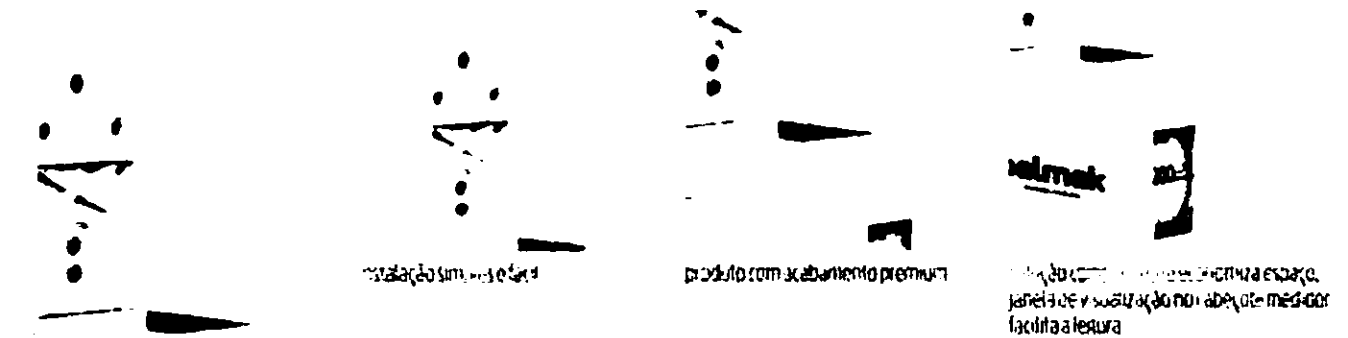

instalação simples e fácil

produto com acabamento premium

instalação compacta e econômica na parede, painel de visualização não abrange o medidor facilitando a leitura

### DESCRIÇÃO

**Faixa de medição:** de 0 até 220 cm

**Resolução:** em milímetros

**Graduação:** 1 mm

**Tolerância:** +/- 5mm em 220 cm.

**Matéria Prima:** Plástico ABS injetado, fita de medição metálica

**Utilidade:** Para uso em clínicas, maternidades, consultórios e saúde pública em geral

**Instalação:** Acompanha parafusos para fixação na parede

**Garantia:** 1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de materiais e/ou fabricação

## EST-222

Estadiômetro vertical, fixo de parede, para medir adultos e crianças



produto com acabamento premium



paquímetro deslizador



instalação simples

### DESCRIÇÃO

**Faixa de medição:** de 60 até 200 cm

**Resolução:** em milímetros

**Graduação:** 1 mm

**Tolerância:** +/- 5mm em 200 cm.

**Matéria Prima:** Alumínio anodizado + plástico ABS injetado

**Utilidade:** Para uso em clínicas, hospitais, consultórios, academias, e saúde pública em geral

**Instalação:** Acompanha parafusos para fixação na parede


**Garantia:** 1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de materiais e/ou fabricação

1694  
EST-223


Estadiômetro vertical, portátil, de piso, para medir adultos e crianças



placa com acabamento em alumínio



paquímetro deslizado



placa de base polida aplicada sobre o piso em qualquer ambiente

## DESCRIÇÃO

**Faixa de medição:** de 85 até 210 cm

**Resolução:** em milímetros

**Graduação:** 1 mm

**Tolerância:** +/- 5mm em 210 cm

**Matéria Prima:** Alumínio anodizado + plástico ABS injetado

**Utilidade:** Para uso em clínicas, hospitais, consultórios, academias, e saúde pública em geral

**Garantia:** 1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de materiais e/ou fabricação

## CLINIC-BASIC

Adipômetro/plicômetro clínico para aferição de dobras cutâneas (modelo econômico)



## DESCRIÇÃO

**Amplitude de leitura:** 0 a 70 mm

**Resolução:** em milímetros

**Graduação:** 1 mm.

**Dimensões:** 17 cm comprimento x 9,5 cm largura

**Tolerância:** +/- 5mm em 70mm

**Matéria Prima:** Plástico ABS injetado

**Impressão:** Silk screen diretamente o corpo, garantindo longa durabilidade

**Utilidade:** Para uso em clínicas, consultórios e academias e saúde pública em geral

**Garantia:** 1 ano contra quaisquer vícios de qualidade em materiais e/ou fabricação

# CLINIC-PRO

Adipômetro/plicômetro clínico para aferição de dobras cutâneas



## DESCRIÇÃO

- Amplitude de leitura:** 0 a 80 mm
- Resolução:** em milímetros
- Graduação:** 1 mm.
- Pressão da mola:** +/- 10g/mm<sup>2</sup>
- Material da mola:** aço inoxidável
- Dimensões:** 28 cm comprimento x 25 cm largura
- Tolerância:** +/- 5mm em 80mm
- Matéria Prima:** Plástico ABS injetado + alumínio anodizado
- Impressão:** Silk screen diretamente o corpo, garantindo longa durabilidade
- Utilidade:** Para uso em clínicas, consultórios e academias e saúde pública em geral
- Garantia:** 1 ano contra quaisquer vícios de qualidade em materiais e/ou fabricação



Fita de medição de circunferência ergonômica

para medição de circunferência de cabeça, peito, abdômen, etc. Material muito confortável, apresenta botão de travamento com apenas 4,7g e com medidas de abertura 8 x 5,5cm

balmak

**balmak**  
medição profissional

## DESCRIÇÃO

**Faixa de medição:** de 0 até 150 cm

**Resolução:** em milímetros

**Graduação:** 1 mm

**Tolerância:** + / - 5mm em 150 cm

**Matéria Prima:** Plástico ABS injetado, fita em PVC

**Função:** apresenta botão central para travamento e destravamento da fita.

**Utilidade:** Para uso em clínicas, hospitais, consultórios academias, e saúde pública em geral

**Garantia:** 1 ano contra quaisquer vícios de qualidade em materiais e/ou fabricação

## VANTAGENS DA LINHA ANTROPOMETRIA BALMAK



**Medições precisas do corpo humano:** cabeça, tronco, abdômen e membros




**Produto de manuseio confortável** com tecnologia de ponta, e design leve e elegante



**Mais por menos:** alto valor agregado, com a garantia de preço competitivo



A BALMAK é a indústria de pesagem, rotulagem e medidas que mais evoluiu e cresceu no Brasil na última década. Está localizada em Santa Bárbara d'Oeste a apenas uma hora da cidade de São Paulo.

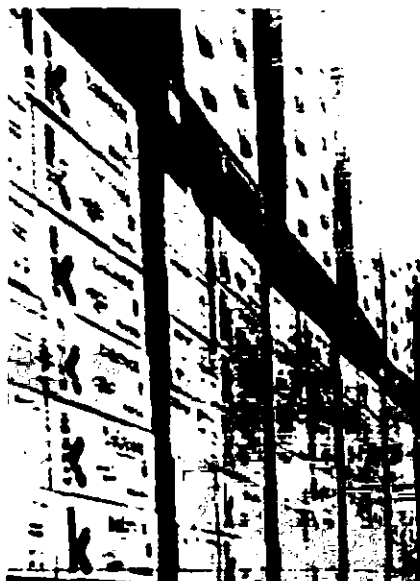





[www.balmak.com.br](http://www.balmak.com.br)

**0800 771 79 81**

[vendas@balmak.com.br](mailto:vendas@balmak.com.br)

## FALE COM NOSSOS ESPECIALISTAS

Revenda food-service, varejo, atacado, automação comercial & industrial e balanceiros

Saúde, revenda farma, revenda médico-hospitalar, pet-veterinário, fitness e bem estar

**E-mail:**

[comercial1@balmak.com.br](mailto:comercial1@balmak.com.br)

**E-mail:**

[comercial2@balmak.com.br](mailto:comercial2@balmak.com.br)

**Skype:**

comercial1.balmak

**Skype:**

comercial2.balmak

**WhatsApp:**

19 98163.0824

**WhatsApp:**

19 98936.0302



Precisa de atendimento técnico, treinamento ou orientação sobre o uso e operação do produto? Fale **GRATUITAMENTE** com nosso **DPV (Divisão Pós-Venda)** pelo telefone **0800 771 79 81** (seg - sexta das 8h às 11h30 e das 13h às 17h30, exceto feriados) ou ainda através do email [dpv@balmak.com.br](mailto:dpv@balmak.com.br)

# balmak®

evolução. revolução.

Handwritten marks: a small 'u' and a larger signature-like mark.



Empresa

Produtos

Novidades

Contato

Home > Linha Médica > Exames Físicos > Otoscópio



*Handwritten signature*



*Handwritten mark*




# Otoscópio MD 2.5V Omni 3000 LED Fibra Óptica com Estojo Macio Preto



O básico da medicina é ver os detalhes.

*Handwritten mark*


[Empresa](#)
[Produtos](#)
[Novidades](#)
[Contato](#)

[QUERO COMPRAR](#)

## Descrição

- Dispositivo de elevada performance e inigualável qualidade.
- Iluminação através de lâmpada 2.5V LED, de alta intensidade luminosa, alto CRI e temperaturas de cor apropriadas para exames precisos e confiáveis sem distorções da cor do tecido.
- Cabos ergonômicos disponíveis em duas versões de alimentação: convencional ou recarregável.
- Cabo compatível com todas cabeças diagnósticas da série OMNI MD.
- Cabeça trabalhada em aço inoxidável e uma combinação de polímeros termoplásticos robustos, conferindo altíssima resistência à impactos e corrosões e superior durabilidade.
- Clip de bolso com interruptor integrado para acionamento liga/desliga e proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso.
- Disponíveis em 6 cores: Preto / Azul / Verde / Roxo / Vermelho / Cinza

do

## Benefícios

- Iluminação LED de excelente intensidade luminosa de 50.000 Lux. com durabilidade de 50.000 horas.
- Transmissão da luz por fibra óptica, sem obstruções, sem reflexos e sem aquecimento.
- Cabeça em aço inox e ABS, proporciona melhor durabilidade, resistente a impactos e corrosões.
- Lente giratória, permite instrumentação e ampliação da imagem em 3 vezes.
- Cabo em aço inox com revestimento termoplástico reforçado, resistente a impactos e corrosões.
- Clip de bolso com acionamento on/off e desligamento automático ao ser fixado no bolso.



Empresa

Produtos

Novidades

Contato




Otoscópio MD 2.5V Omni 3000 LED  
Fibra Óptica com Estojo Macio  
Vermelho

Otoscópio MD 2.5V Omni 3000  
Fibra Óptica com Estojo Macio  
Vermelho

### Conheça Também





Macrosul

Empresa

Produtos

Novidades

Contato



Estojo CliniCase Turquesa MD

Estojo CliniCase Roxo MD

Ma

*Handwritten mark*

### Empresa

- Sobre Nós
- Governança
- Compliance & Ética
- Trabalhe Conosco

### Produtos

- Linha Médica
- Linha Vet
- Exames Físicos
- Exames Gráficos
- Sinais Vitais
- Suporte à Vida

### Novidades

- Todas
- Curiosidades
- Eventos
- Novidades
- Produtos

### Atendimento


- Fale com Vendas
- Suporte ao Cliente
- Assistência Técnica

### Contato

- Revendas
- Hospitais & Consumidor

### Termos

- Política de Cookies
- Proteção de Dados

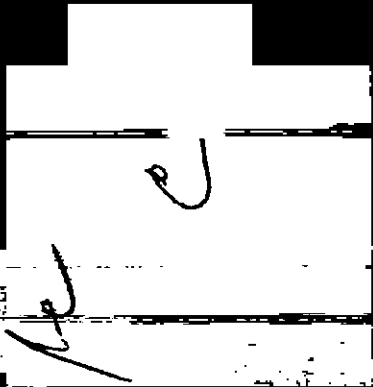



Empresa

Produtos

Novidades

Contato



Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda.

CNPJ: 95.433.397/0001-11

Rua Julio Bartolomeu Taborda Luiz 270

CEP: 82.600-070 | Curitiba - PR

Acompanhe a Macrosul



Macrosul © 2022 - Todos os direitos reservados - Criado por Nerdweb

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*




*Handwritten mark*

## AUTOCLAVE DE MESA DIGITALE

### 100 % Configurável – PREVISTO NO MANUAL DA ANVISA

Uso profissional Toda em metal

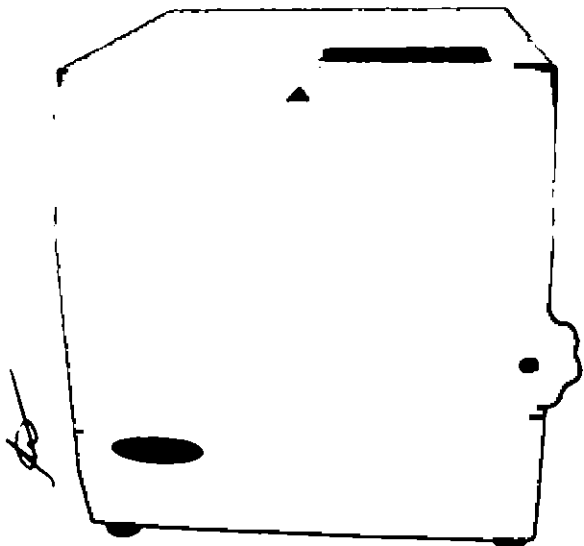

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Alimentação: 127 / 220 V~  
 Frequência: 50/60 Hz  
 Proteção elétrica: Fusíveis  
 Potência: Configurável de 600 a 8000 Watts  
 Pressão Máxima de Trabalho: 2,2 kg/cm<sup>2</sup>  
 Pressão de Esterilização 1,7 a 1,9 kgf/cm  
 Alarmes : 18 níveis configuráveis Bips Sonoros  
 Temperatura 128° a 135°C (configurável)  
 Tempo Configurável  
 Temperatura máxima 150° - Termostato Incluído  
 Tanque de pressão: Aço Inoxidável /aluminio  
 Anel de vedação da porta: Silicone –  
 acionado no excesso de pressão  
 Sistema eletrônico: Microcontrolado  
 Água: Inserção automática  
 Proteção sobrepessão: Válvula de alívio  
 Proteção subpressão: Válvula de antivácuo  
 Sistemas de segurança: 24 (configurável) Bips Sonoros  
 Indicação para monitoramento: Digital com auto diagnostico à distância  
 Painel de comando – Teclado membrana: Posicionado na parte frontal (indica  
 operações / teclas de comando)  
 Abertura da porta: Fuso em aço inox com triplo estagio  
 Comunicação RS 232 USB  
 Tamanho compacto  
 Validade: Indeterminada  
 Origem: Brasil

**Anvisa 80360560002**

- Painel digital alfanumérico com tecnologia LCD ( Led Custon Display )
- Porta Barreira Simples inox e alumínio
- Transdutor pressão
- Sensor PT 100 – Sensor 1
- Sensor de porta aberta ( micro switch )com indicação no painel
- Desaeração e despressurização automática – sensor de pressão.
- Porta dupla laminada inox com 6 pontos de apoio
- Funcionamento com a porta fechada
- Reservatório de água - Abastecimento automático com indicação do término de água no reservatório.- Capac. 3 litros(OPCIONAL)
- Controle de Nível: para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d'água – sensor abastecimento.
- 1 a 99 (Configurável) ciclos que atende as principais necessidades .com mensagens sonoras e visuais
- Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura configurável –sensor 2 e 3
- Baixo consumo de água e energia (menor que as 12 litros)
- Não precisa de copo dosador
- Chave geral no painel
- Em AÇO INOX opcional em alumínio
- Capacidade: 07, 12, 21, 25, 30,40, 42, 45, 50, 54, 55, 60, 65, ou 75 litros
- Possui filtros – filtro de ar
- Vácuo Pulsing Alto vácuo
- Possui entrada exclusiva para validação.
- Estrutura em aço A36
- Abastecimento com água da rede comum desde que devidamente destilada.
- Simples manutenção
- Suporte on line
- Auto diagnostico à distância
- Até 5 bandejas opcional
- Possui entrada de bomba de secagem para procedimento de porta fechada.
- Secagem aberta e fechada com resfriamento
- Secagem programavel , até 10 ciclos secagem programaveis
- Secagem extra - ciclo independente
- Touch screen – Tecla Anula
- Teste Bowie & Dick
- Conforme ISO 9001 e 14001
- Desligamento automático ao final do ciclo.
- Trava de triplo estágio

**BS Equipamentos**  
 04709243/0001-54  
 (35) 3221-1080



**Tekna**<sup>®</sup> (<https://teknapower.com.br>)



Início (<https://teknapower.com.br>) / Compressores de ar (<https://teknapower.com.br/categoria-produto/compressores-de-ar/>) / Compressor de Ar – CPSD7040

# Compressor de Ar – CPSD7040



COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
FM  
ASU  
K. R. R.

**Tekna**<sup>®</sup> (<https://teknapower.com.br>)

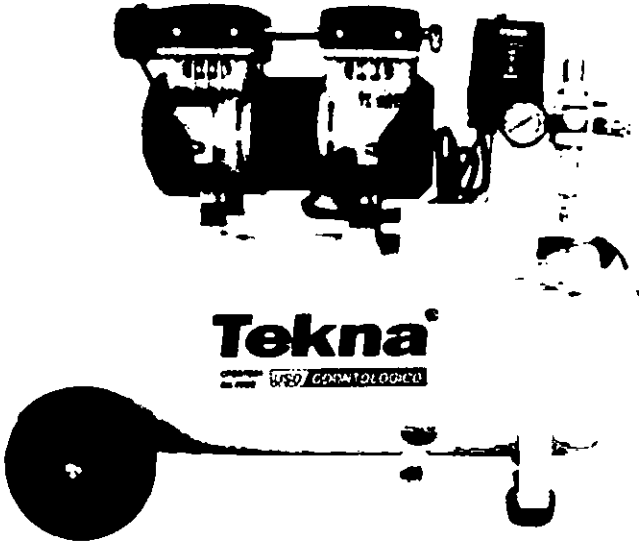

Código: 1012106



O Compressor de Ar CPSD7040 possui motor elétrico com 1,8 HP de potência, um reservatório de ar de 35 litros, que alcança pressão de operação máxima de 116 lbf/pol<sup>2</sup>.



- Silencioso
- Pressão automática
- Motor silencioso

# Tekna®

(<https://teknapower.com.br>)




## Informações Adicionais

Com um motor silencioso, o compressor CPSD7040 é a escolha perfeita para uso odontológico. Esse compressor é isento de óleo, evitando contaminação cruzada, possui válvula de segurança, facilitando o trabalho no dia a dia. Além disso, ele conta com filtro regulador de ar, que elimina impureza e partículas.


- Potência do motor de 1,8 HP
- Pressão máxima de 116 lbf/pol<sup>2</sup>
- Deslocamento Teórico de 6,4 pés<sup>3</sup>/min
- Tensão 220 V

## Você também pode gostar de...

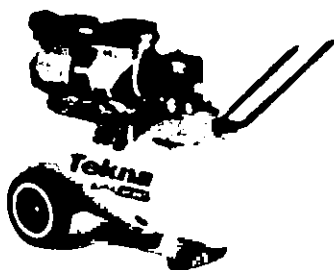

Compressor de Ar – CPS7050-1

(<https://teknapower.com.br/produto/compressor-de-ar-cps7050-1/>)

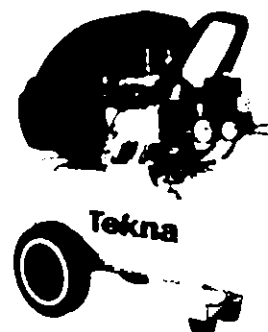

Compressor de Ar Tekna – CP8525-1C

(<https://teknapower.com.br/produto/compressor-de-ar-cp8525-1c/>)

# Ficid **Tekna**<sup>®</sup> de nossas novidades!

(<https://teknapower.com.br>)



Digite aqui seu e-mail

INSCREVER

(htt  
 (htt ps:/  
 ps:/ /br.l  
**Tekna** (<https://teknapower.com.br>)  
 ww inke  
 ps:/ w.in din.  
 /ww stag com  
 +55 (41) 3595-9600 contato@nordtech.com.br  
 w.fa ram /co  
 ceb .co mp  
 bokom/many  
 co ekn /tek  
 m/T aofi na-

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*


COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 144

IMPORTADO POR

sulservices  
HEALTHCARE

*[Handwritten signature]*

# DESTILADOR DE ÁGUA 220V

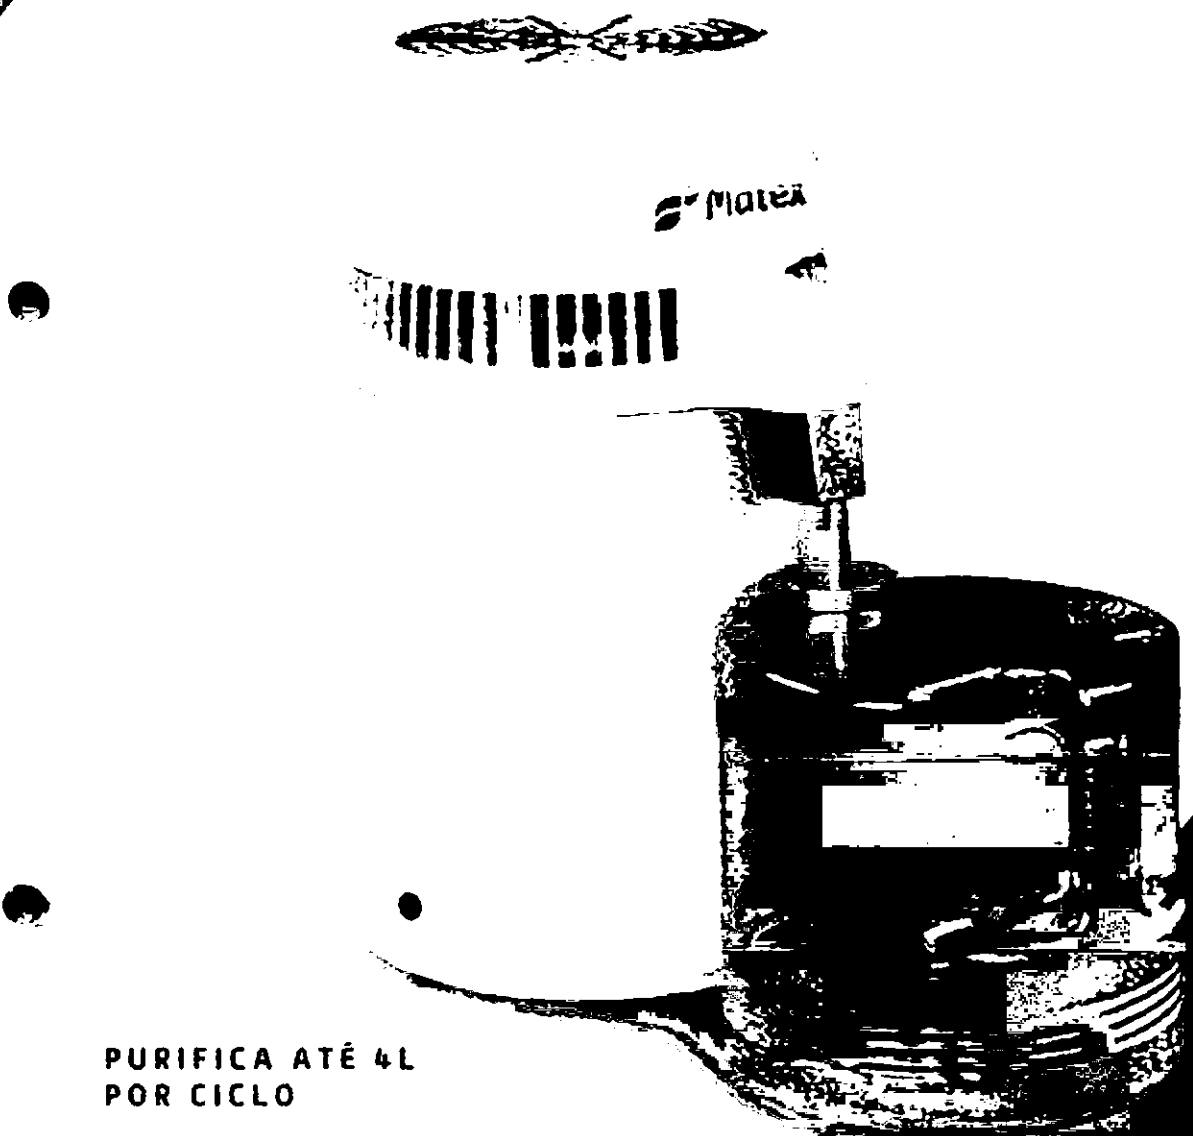

PURIFICA ATÉ 4L  
POR CICLO

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

*[Handwritten checkmark]*



**Matex**



Purifica a água, eliminando 99,9% das impurezas

- Praticidade de obter a quantidade de água necessária para determinados procedimentos;
  - LED indicador de funcionamento;
  - Partes internas de aço inoxidável garantindo melhor resistência e durabilidade;
  - Sensor para desligamento automático quando a água câmara se finda;
  - Portátil, design moderno e inovador;
- Confeccionado em material de fácil limpeza;
- Filtro de carvão ativado, para eliminar os traços de sabor e odor;
  - Garrafa plástica para coleta de água.

## Características

Tensão de alimentação: 110 ou 220 V (NÃO É BIVOLT)

Frequência: 50/60 Hz

Consumo de energia 750 W/h

Produção: 1 L/hora

Capacidade máxima: 4 L

Temperatura: 160° C

Dimensões do produto: 230 x 230 x 390 mm (C x L x A)

Dimensões do produto embalado: 285 x 260 x 470 mm (C x L x A)

Peso do produto embalado: 4,4 Kg

Duração Filtro de Carvão Ativado: 6 meses ou 4000 L

Registro na ANVISA: Isento (Não necessário)

Garantia: 2 anos

IMPORTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO  
AUTORIZADO

[www.sul.services](http://www.sul.services)

[51] 3237-1255 | [falecom@sul.services](mailto:falecom@sul.services)




 **Matex**



HOME > PRODUTOS > MOTOMIL > GRUPO GERADORES

## GERADOR À DIESEL - MDG-5000CLE

GRUPO GERADORES

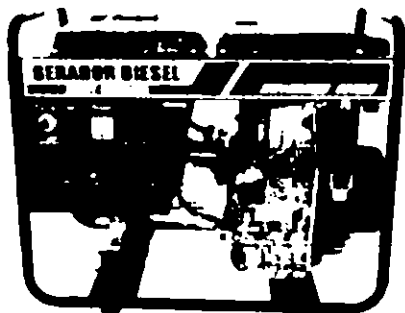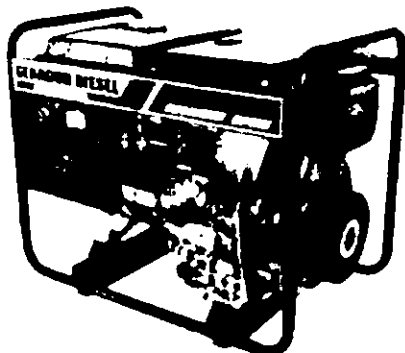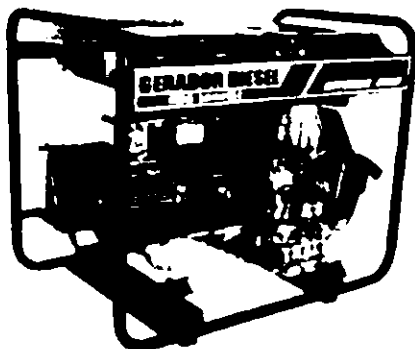

### DESCRIÇÃO

#### GERADOR À DIESEL

Potente, eficaz e robusto, uma solução prática para abastecer energia elétrica.

#### Dados Técnicos

Tensão/Código: 115/230V (Cód.: 6261.5)

Tipo do motor: 4T

Potência do motor: 10 HP / 7.5KW

Sistema de partida: Manual/Elétrico.

Sistema de lubrificação: Bomba de Óleo

Tipo de Gerador: AVR com Escovas.

Frequência: 60 Hz

Potência partida (W): 5000

Potência trabalho (W): 4300

Número de fases: Monofásico

Cap. Tanque: 12.5

Consumo: 2.2 L/H



**GOVERNO DO CEARA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM**  
**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**  
**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 1610.01/2023-SMS/PE**  
**Abertura das Propostas: 08:30 horas do dia 09/11/2023**

Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde, junto a Secretaria de Saúde do Município de Fortim-CE.

**PROPOSTA COMERCIAL**

Prezados (a) senhores (a); declaramos que esta proposta tem validade conforme edital, contados da data de abertura da mesma, e que concordamos com todas as condições estabelecidas no edital e seus respectivos anexos.

Declaramos de que nos preços propostos estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com os Serviços do objeto da presente licitação.

Declaramos de que conhecemos e aceitamos todas as regras contidas neste Edital.


Declaramos: Que, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para participar de licitações ou de contratar com qualquer órgão da Administração Pública, bem como, para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste pregão, acatando todas as estipulações consignadas no edital, conforme abaixo:

**PROPOSTA COMERCIAL**

Item	Descritivo	Unid	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
31	<b>AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO</b> Característica Física Especificação TIPO   MODO DE OPERAÇÃO CAPSULARI DIGITAL.. MODELO: DENTMIX - 110V OU 220V MARCA: DENTEMED EQUIP. ODONT. FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)	UND	01	R\$1.745,00 mil setecentos e quarenta e cinco reais	R\$1.745,00 mil setecentos e quarenta e cinco reais
32	<b>AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA</b> (até 75 litros) Característica Física MODO DE OPERAÇÃO   CAPACIDADE Especificação DIGITAL   ATÉ 25 L. MODELO: AUTOPRIME 21 - BIVOLT MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED (INOVA INOX) PROCEDÊNCIA NACIONAL. REGISTRO DA ANVISA: 80349600006	UND	01	R\$6.476,00 seis mil quatrocentos e setenta e seis reais	R\$6.476,00 seis mil quatrocentos e setenta e seis reais
33	<b>CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA.</b> (Equipo/ sugador/ refletor) Característica Física Especificação	UND	01	R\$17.000,00 dezessete mil reais	R\$17.000,00 dezessete mil reais

*[Handwritten signature]*

	<p>Terminais   ATÉ 3          EQUIPO   TIPO CART OU ACOPLADO          COMANDO DA   PEDAL          CADEIRA            CABECEIRA   POSSUI          REFLETOR   POSSUI          CUBA   PORCELANA/CERÂMICA          SERINGA TRÍPLICE   POSSUI          PEÇA RETA   POSSUI          CONTRA ÂNGULO   POSSUI          MICRO MOTOR   POSSUI          CANETA DE ROTAÇÃO   POSSUI          UNIDADE DE AUXILIAR (SUGADOR)   POSSUI          MOCHO   POSSUI.</p> <p>"Produto Fabricado Conforme RDC Nº 27 de 21 de Junho de 2011 (ANVISA), portaria nº 350 de 06 de Setembro de 2010 (INMETRO), ABNT NBR ISO 6875 e 9680 (ABNT), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2006 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016 e Diretiva 93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e 98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)".</p> <p>MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME CART (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na íntegra da especificação do edital, conforme segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cuba Porcelana/ Cerâmica (Unidade Auxiliar)</li> <li>2. Mocho Magnus Prata Anatômico</li> <li>3. 01(Uma) Caneta de Alta Rotação Prime CX207 PB - RMS: 80349600009</li> <li>4. 01(Um) Micromotor Prime Cx235 (Refrigeração externa) - RMS: 80349609006</li> <li>5. 01(Um) Contra Ângulo Prime Cx235 (Refrigeração externa) - RMS: 80349609005</li> <li>6. 01(Uma) Peça Reta Prime Cx235 (Refrigeração externa) - RMS: 80349609007</li> </ol> <p>COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR          MARCA: DENTEMED          FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT.          PROCEDÊNCIA NACIONAL          REGISTRO ANVISA: 80349600007          CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO          CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "CE"</p>				
35	<p><b>COMPRESSOR ODONTOLÓGICO</b></p> <p>Característica Física   Especificação          CAPACIDADE   30 A 39 L   1 A 1,5HP            RESERVATÓRIO   6 A 7 PÉS          POTÊNCIA   CONSUMO            ISENTO DE ÓLEO   SIM.          MODELO: PRIME AIR 40 - 110V OU 220V          MARCA: DENTEMED          FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL          RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)"</p>	UND	01	R\$3.453,00 três mil quatrocentos e cinquenta e três reais	R\$3.453,00 três mil quatrocentos e cinquenta e três reais
36	<p><b>DESTILADOR DE ÁGUA</b></p> <p>Características Físicas   Especificação          CAPACIDADE   ATÉ 5 LITROS   HORA</p>	UND	01	R\$2.500,00	R\$2.500,00

*Handwritten marks:* A large stylized signature or mark resembling 'fc' and a smaller mark resembling 'u' below it.



	<b>MODELO: DESTILADORA PRIME- 110V OU 220V</b> <b>MARCA: DENTEMED</b> <b>FABRICANTE: DENTEMED</b> <b>PROCEDENCIA NACIONAL</b> <b>RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)</b>			dois mil e quinhentos reais	dois mil e quinhentos reais
37	<b>FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA</b> Características Físicas Especificação <b>TIPO LED, SEM FIO, SEM RADIOMETRO.</b> <b>"MODELO: PRIME LED</b> <b>MARCA: DENTEMED</b> <b>FABRICANTE: DENTEMED</b> <b>PROCEDÊNCIA NACIONAL</b> <b>REGISTRO DA ANVISA: 88349609084"</b>	UND	01	R\$1.100,00 mil e cem reais	R\$1.100,00 mil e cem reais

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 32.274,00 (TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS)**

**CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:**

Validade da proposta:	60 (SESSENTA) DIAS CONFORME EDITAL
Condições de pagamento	CONFORME EDITAL
Prazo de entrega:	CONFORME EDITAL
Local de entrega:	CONFORME EDITAL
Garantia	CONFORME EDITAL
Frete / impostos:	INCLUSOS
Assistência técnica	CONFORME EDITAL.
Prazo de vigência:	CONFORME EDITAL

sob as penas da Lei:

- ❖ O pleno conhecimento das exigências e das obrigações constante no edital de pregão eletrônico e seus respectivos anexos, submetendo a todas as condições nele estipulada, principalmente sendo vencedor da licitação.
- ❖ Que os produtos são de qualidade, fabricados conforme ABNT e ANVISA - (agência nacional de vigilância sanitária), garantindo o cumprimento a legislação sanitária quanto às normas. Garantindo a qualidade, através de bateria de testes para aprovação, feita pela equipe técnica de fábrica, e vistoriada pelo nosso engenheiro técnico pra averiguação e conformidade dos produtos conforme exigência da ANVISA e da ABNT, o mesmo registrado sob o CREA-MG de nº 5976.
- ❖ Sob penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada pela empresa proponente para participar da licitação que trata o presente edital, foi elaborada de maneira independente pela empresa proponente, que deverá vir no mesmo envelope das propostas.
- ❖ Sob as penas da Lei, que o material ofertado atende todas as especificações exigidas no edital e seus anexos.

*M U*

❖ O comprometo-me a manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na presente licitação e que a validade da proposta será de 60 (SESSENTA) dias, conforme solicitado no edital e que a garantia será por um período de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, depois de efetuada sua entrega.

❖ Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital e que entregamos os produtos conforme a solicitação determinada pelo setor de compras e garantimos a entrega em local determinado pelo setor de compras.

❖ Os preços propostos contemplam todas as despesas necessárias para execução do contrato conforme edital de licitação, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado.

Declaro que estou habilitado e em condições legais para prestar o serviço a partir da imediata assinatura do contrato.  
Declaramos que a Validade do registro de preço e de 12 (doze) meses

Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na contratação do objeto desta Licitação.

Declaramos que Há pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

BELO HORIZONTE/MG, 09 DE NOVEMBRO DE 2023

ATENCIOSAMENTE,



# CATÁLOGO DE PRODUTOS

## Linha Prime Tradição e Excelência em Odontologia



# Linha 1 Consultórios Odontológicos Magnus Prime Flex ou Cart



Refletor Led, com sensor e intensidade gradual.

Braço do equipo com travamento Pneumático ou Manual (Manopla).

Unidade auxiliar para até 3 sugadores de alta potência e seringa tríplice.

Estofamento em poliuretano injetado de alta densidade.

Joystick

Posições de trabalho, volta zero e Trendelenburg


Exclusivo sistema de instalação com caixa de ligação integrada (Interna) ou Externa a estrutura da cadeira.

Regulagem externa de ar e água para comodidade do profissional

## TAMBÉM NA OPÇÃO CART

Opcional: Pedal multifuncional externo ou acoplado com todas as funções da cadeira

Consulte opcionais disponíveis conforme sua necessidade



RMS Anv. nº 349600007



# Características Principais: Consultório Odontológico Magnus Prime Flex ou Cart + Opcionais e/ou Acessórios Dentemed

**ABO**  
MEDICINA

COMISSÃO DE LICENÇA  
FIS. 185  
PÚBLICA

**Cadeira Odontológica Prime:** Base da cadeira fabricado em chapa de aço maciço. Sistema pantográfico de elevação, encosto e base do assento fabricado em vergalhões e chapas de aço, lâmina do encosto de cabeça polida e guias da lâmina fabricadas em aço, todas as superfícies metálicas com banho de proteção contra oxidação e pintura lisa nas superfícies aparentes. Botão ON/OFF. Pedal de comando multifuncional com design integrado a base da cadeira, acionamento por joystick da movimentação subida e descida do encosto e do assento, 01 botão de acionamento e ajuste da intensidade do refletor, 01 botão de acionamento de volta zero, 01 botão para acionamento das 03 programações de trabalho e a última posição acionada (Trendeleburg -5°). Sistema de elevação eletromecânico acionado por motorreductores, sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem de 24 volts. Sistema tipo pantográfico de elevação com capacidade de elevação de até 200 kg (Paciente + Acessórios + Opcionais). Sistema incorporado de segurança com amortecedor, antiesmagamento. Placa com revestimento em material com isolamento elétrico, proteção UV, anti-umidade e grau máximo de proteção antichama (UL94 V-0). Placa com sistema full range garantindo segurança elétrica mesmo em lugares com alta oscilação de energia. Tensão de alimentação 90 a 240 Vac - 50/60Hz. Braços de apoio para paciente, com estrutura interna de metal com opção escamoteável. Encosto de cabeça (cabeceira) anatômico, removível, com regulagem de altura e com opção biarticulado (regulagem de altura com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca). Estofamento de espuma injetada de alta densidade, revestida em PVC material laminado, sem costura ou dobras. Caixa de ligação compacta construída em ABS com cantos arredondados com opção com caixa de ligação incorporada com tubulação embutida e sem mangueira corrugada exposta.




## Equipo odontológico Prime:

Tipo Flex acoplado a cadeira, com braços articuláveis com movimento horizontal e movimento vertical com travamento manual (acionado por manopla localizada sob o braço) ou travamento pneumático "Arm Lock" (acionado por botão localizado sob corpo do equipo) proporcionando liberdade aos movimentos travamento e do equipo.

ou

Tipo Cart sobre rodas, pedestal em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno, móvel com quatro rodízios. Mesa projetada com alma estrutural em aço, corpo e capas em ABS de 4 mm (base de poliuretano de alto impacto resistente), com proteção UV, que evita o amarelamento das peças. Suporte dos instrumentos integrado à mesa e escalonado, com angulação de 45°, encaixe preciso o qual evita a queda involuntária dos instrumentos e facilita a limpeza. Suporte dos instrumentos com inclinação de 45°, que facilita o manuseio e ergonomia do profissional. Suporte para até 05 terminais sendo com 01 terminal com uma seringa triplice com bico giratório, removível e autoclavável, 01 a 03 terminal (ais) bordem refrigerado para alta rotação e 01 ou 02 terminal(ais) bordem para micromotor pneumático. sistema de BAP (bloco de acionamento pneumático. A regulagem da água e do ar spray dos instrumentos é realizada de forma prática e rápida pelo próprio dentista, sem a necessidade de chamar um técnico. Pedal progressivo para acionamento das peças de mão. Bandeja em alumínio anodizado, removível e autoclavável. Puxadores bilaterais. Mangueiras tipo oblate lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Reservatório de água transciclado acoplado ao equipo ou a unidade auxiliar de 500 ou 1.000 ml.

**Unidade Auxiliar Odontológica Prime:** Acoplada à cadeira com estrutura interna em aço com pintura epóxi. Cuba da cuspidora, em PBT ou porcelana ou cerâmica, removível para desinfecção e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Unidade com corpo revestido em plástico de alto impacto. Com um sugador com diâmetro 6,5 mm tipo venturi e/ou outro sugador alta potência ou para bomba à vácuo e/ou com uma seringa triplice. Separador de detritos na mangueira e/ou na caixa de comando. Suporte dos sugadores com acionamento automático pneumático. Pintura na cor gelo, com tratamento anticorrosivo. Acionamento da água manual ou elétrico por pedal, ou por botão ou por sensor de proximidade ou por comando PAD. Mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias.

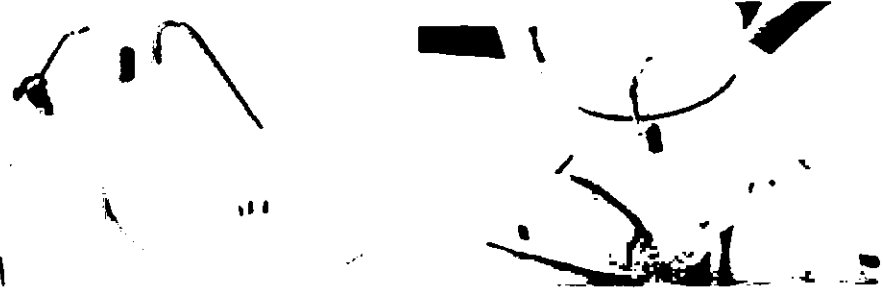

**Refletor Odontológico Prime:** Fonte de luz fria, não gera calor no campo operatório. Multifocal iluminação por LED, com 04 intensidades de luz regressiva com a máxima de 40.000 LUX e a mínima de 3.000 (isenta de ondas polimerizantes evitando a fotoativação indesejada), com variação de +/-20%, numa distância da fonte de luz 700 MM. Acionamento por sensor de proximidade e no pedal da cadeira. Temperatura de cor: 5.000 - 5.300°K. Cabecote em material resistente, estrutura em polímero injetado, possui alta durabilidade e permite ampla mobilidade em diversas posições com giro 620° horizontal, vertical e orbital. Espelho multifacetado com sistema de iluminação LED por reflexo (luz indireta) que evita sombras durante trabalho (Cada faceta é microfacetada para obter luz natural de alta qualidade, absolutamente sem sombra). Dupla proteção do espelho em material transparente. Protetor frontal removível, construído em policarbonato transparente. Braço multiarticulado balanceado com mola e articulações metálicas. Puxadores bilaterais removíveis e autoclaváveis em forma de alça.

**Dentemed**  
Soluções em Saúde

# Consultório Odontológico Magnus Prime X8

+ Opcionais inclusos

Refletor Prime HL-100  
com Led multifacetado  
com led alta potência e  
sensor de aproximação

Braço do equipo com  
travamento pneumático

Unidade Auxiliar com  
cuba profunda removível  
e com suporte para 3  
suctores.

Estofamento em poliuretano  
injetado de alta densidade.

Joystick

Pedal multifuncional com  
todas as funções da cadeira,  
água da cuba e do refletor.

Sistema de instalação com caixa de ligação  
integrada interna (Tubulação Embutida)  
ou Caixa de ligação independente Externa

Optional Comando PAD  
(Panel Digital) com  
teclado de membrana e  
visualização das funções  
acionadas da cadeira e  
do refletor.



Dentemed possui opcionais disponíveis acoplados de fábrica conforme necessidade do cliente:




Cliente Público:  
Secretaria Municipal  
de Saúde de  
Gabriel Monteiro - SP



Cliente Público:  
Secretaria Municipal  
de Saúde de  
Belo Horizonte - MG

Cliente Público:  
Secretaria Municipal  
de Saúde de  
Vespasiano - MG



RMS Arvis | 8034960007

Dentemed

# Características Ofertadas para o Consultórios Odontológicos Dentemed



**Cadeira Odontológica Prime:** Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Articulação central em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base com desenho ergonômico, construído em aço com tratamento anticorrosivo, totalmente protegida por debrum antiderrapante, perfeita estabilidade, não precisa ser fixada ao piso. Altura do assento em relação ao solo mínima de 450mm máxima de 900mm. Pintura rigorosa por processo garantindo atendimento as normas de sustentabilidade e biossegurança. Processo de fabricação monitorado, realizado por máquinas de última geração atendendo todas normativas internacionais. Botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira. Comando na base da cadeira realizado nos pés por pedal com 12 funções, composto de 10 movimento sendo 04 individuais e 06 automáticos, acionamento por joystick da movimentação subida e descida do encosto e do assento, 01 botão de acionamento e ajuste da intensidade do refletor, 01 botão de acionamento da posição volta zero, 03 botões para acionamento das 03 posições de trabalho programáveis pelo dentista(s), 01 botão de acionamento da posição de cuspir/retorno a última posição e 01 botão de acionamento da posição trendelemburg -5°. 01 Botão Vermelho Emergencial com sistema de Bloqueio dos movimentos da cadeira (IEC 60601). Sistema de elevação eletromecânico acionado por motorreductores de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem de 24 volts. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço. Sistema incorporado de segurança com amortecedor, antiesmagamento e sem interferência para aparelhos de marca passo. Motor e caixa de comando com tecnologia alemã Dewer Okin, líder em atuadores e sistema de acionamento para área da saúde, do grupo Phoenix Mecano (Mais de 02 milhões de atuadores fornecidos). Motores testados em conformidade a IEC 60601, com testes rigorosos que garantem carga de até 540 kg. Tecnologia incorporada e certificada seguindo normas IEC 60601, CE, ISO 9001:2015 e ISO 13.485/2016. Placa com revestimento em material com isolamento elétrico, proteção UV, anti-umidade e grau máximo de proteção antichama (UL94 V-0). Placa com sistema full range garantindo segurança elétrica mesmo em lugares com alta oscilação de energia. Placa com sistema de alta tecnologia com software de última geração, garantindo posições de trabalho programáveis, posição trendelemburg (anti-hipotímia) e STOP EMERGENCIAL (IEC 60601). Tensão de alimentação 90 a 240 Vac - 50/60Hz. Estofamento amplo, em PVC ou Couro, com opção sistema easy fix, que permite rapidez e facilidade na remoção do encosto para higienização. Braço de apoio para paciente, com opção rebatível (articulável) em 90°, com estrutura interna de metal. Encosto de cabeça anatómico, removível, com regulagem de altura com opção biarticulado com regulagem ântero-posterior e a possibilidade para atendimento a cadeirantes. Caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório, de fácil instalação e manutenção. A carga de Trabalho de Segurança (Carga Máxima de levantamento da cadeira) é de 200 kg (Paciente + acessórios e partes acopladas).

**Opcionais que podem ser inclusos:** 1. Tubulação totalmente embutida e/ou 2. Caixa de comando independente e/ou 3. Pedal Móvel Multifuncional e/ou 4. Encosto de cabeça biarticulado / multiarticulado e/ou 5. Braço rebatível / escamoteável com abertura

**Equipo odontológico Prime:** Tipo Flex acoplado a cadeira com braços articuláveis com movimento horizontal e movimento vertical com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Produzido em ABS injetado, Mesa com proteção UV e com suporte dos instrumentos com angulação de 45°. Suporte para até 05 terminais sendo com 01 terminal com uma seringa tríplice (bico giratório, removível e autoclavável), 01 ou 02 terminal(is) bordem refrigerado para alta rotação e 02 terminal(is) bordem para micromotor pneumático (baixa rotação) com opção refrigerado(spray). Sistema com acionamento pneumático individual e automático para acionamento nos terminais(pontas). Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Bandeja/Tampo de inox removível e autoclavável. Puxadores bilaterais. Mangueiras lisas, arredondadas leves e flexíveis. Reservatórios translúcidos de fácil visualização e reposição, com 500 ml para água das peças de mão e seringa tríplice.

**Opcionais que podem ser inclusos:** 1. Braço flex com travamento pneumático e/ou 2. Puxador Frontal e/ou bilateral e/ou 3. Terminal extra para alta rotação e/ou 4. Terminal de baixa rotação com sistema de refrigeração e/ou 5. Teclado de membrana Pad Led acoplado e/ou 6. Bandejas autoclaváveis e/ou 7. Negatoscópio de LED acoplado e/ou 8. Fotopolimerizador de LED acoplado e/ou 9. Reservatório de água com filtro de água e/ou 10. Reservatório de água de 1.000 ml (1L) e/ou 11. Sistema desinfecção com válvula antirretroação e/ou 12. Jato de bicarbonato com reservatório Instalado e/ou 13. Ultrassom Piezoelétrico com regulador - Instalado;

**Unidade Auxiliar Odontológica Prime:** Unidade de água que permita trabalho a 4 (quatro) mãos, acoplada à cadeira rebatível em até 180°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Unidade produzida em ABS injetada. Cuba da cuspeira, profunda removível para assepsia e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Sistema de regulagem da vazão da água. Acionamento por sensor de presença e por posição de cuspir no pedal e teclado do equipo que aciona automaticamente o fluxo de água na cuspeira, proporcionando maior praticidade, conforto para o paciente, segurança e economia de água. Suporte em peça única composto de 01 tipo suctor de saliva a ar (sistema venturi), Suporte dos sugadores com acionamento automático e pneumático. Mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias, composto de filtro de engate rápido com tela de aço.



**Opcionais que podem ser inclusos:** 1. Porta-copo incorporado e/ou 2. Segundo sugador de alta potência e/ou 3. Segundo sugador elétrico p/ bomba de vácuo e/ou 4. Seringa tríplice incorporada e/ou 5. Braço assistente com giro até 180° e/ou 6. Rebatimento com giro de até 180° e/ou 7. Acionador temporizado para água no pedal e/ou 8. Acionador temporizado para água por sensor de presença e/ou 9. Sistema de aquecimento da Seringa tríplice e/ou 10. Cuba translúcida e/ou 11. Cuba Porcelana/ Cerâmica e/ou 12. Fotopolimerizador de LED acoplado;

**Refletor odontológico Prime:** Monofocal iluminação por led, com quatro intensidades de luz variável sendo mínima de 3.000 (isenta de ondas polimerizantes evitando a fotoativação indesejada) e máxima 40.000 LUX (com variação de +-10%) numa distância da fonte de luz 700 MM. Acionamento por sensor de proximidade e no pedal da cadeira. Temperatura de cor: 5.000 - 5.300°K. Cabeçote em material resistente, estrutura em polímero injetado, possui alta durabilidade e permite ampla mobilidade em diversas posições com giro orbital. Espelho multifacetado com sistema de iluminação LED por reflexo (luz indireta) que evita sombras durante o trabalho (Cada faceta é microfacetada para obter luz natural de alta qualidade, absolutamente sem sombra). Protetor frontal removível, construído em policarbonato transparente. Fonte de luz fria não gera calor no campo operatório. Braço multiarticulado balanceado com mola e articulações metálicas. Puxador bilateral removível e autoclavável em forma de alça.

**Opcionais que podem ser inclusos:** 1. Refletor Odontológico 6 Leds Modelo CX-249-23 ou 2. Refletor Odontológico 12 Leds Modelo CX-249-24.

# Consultório Odontológico Magnus Prime X12

+ Opcionais inclusos

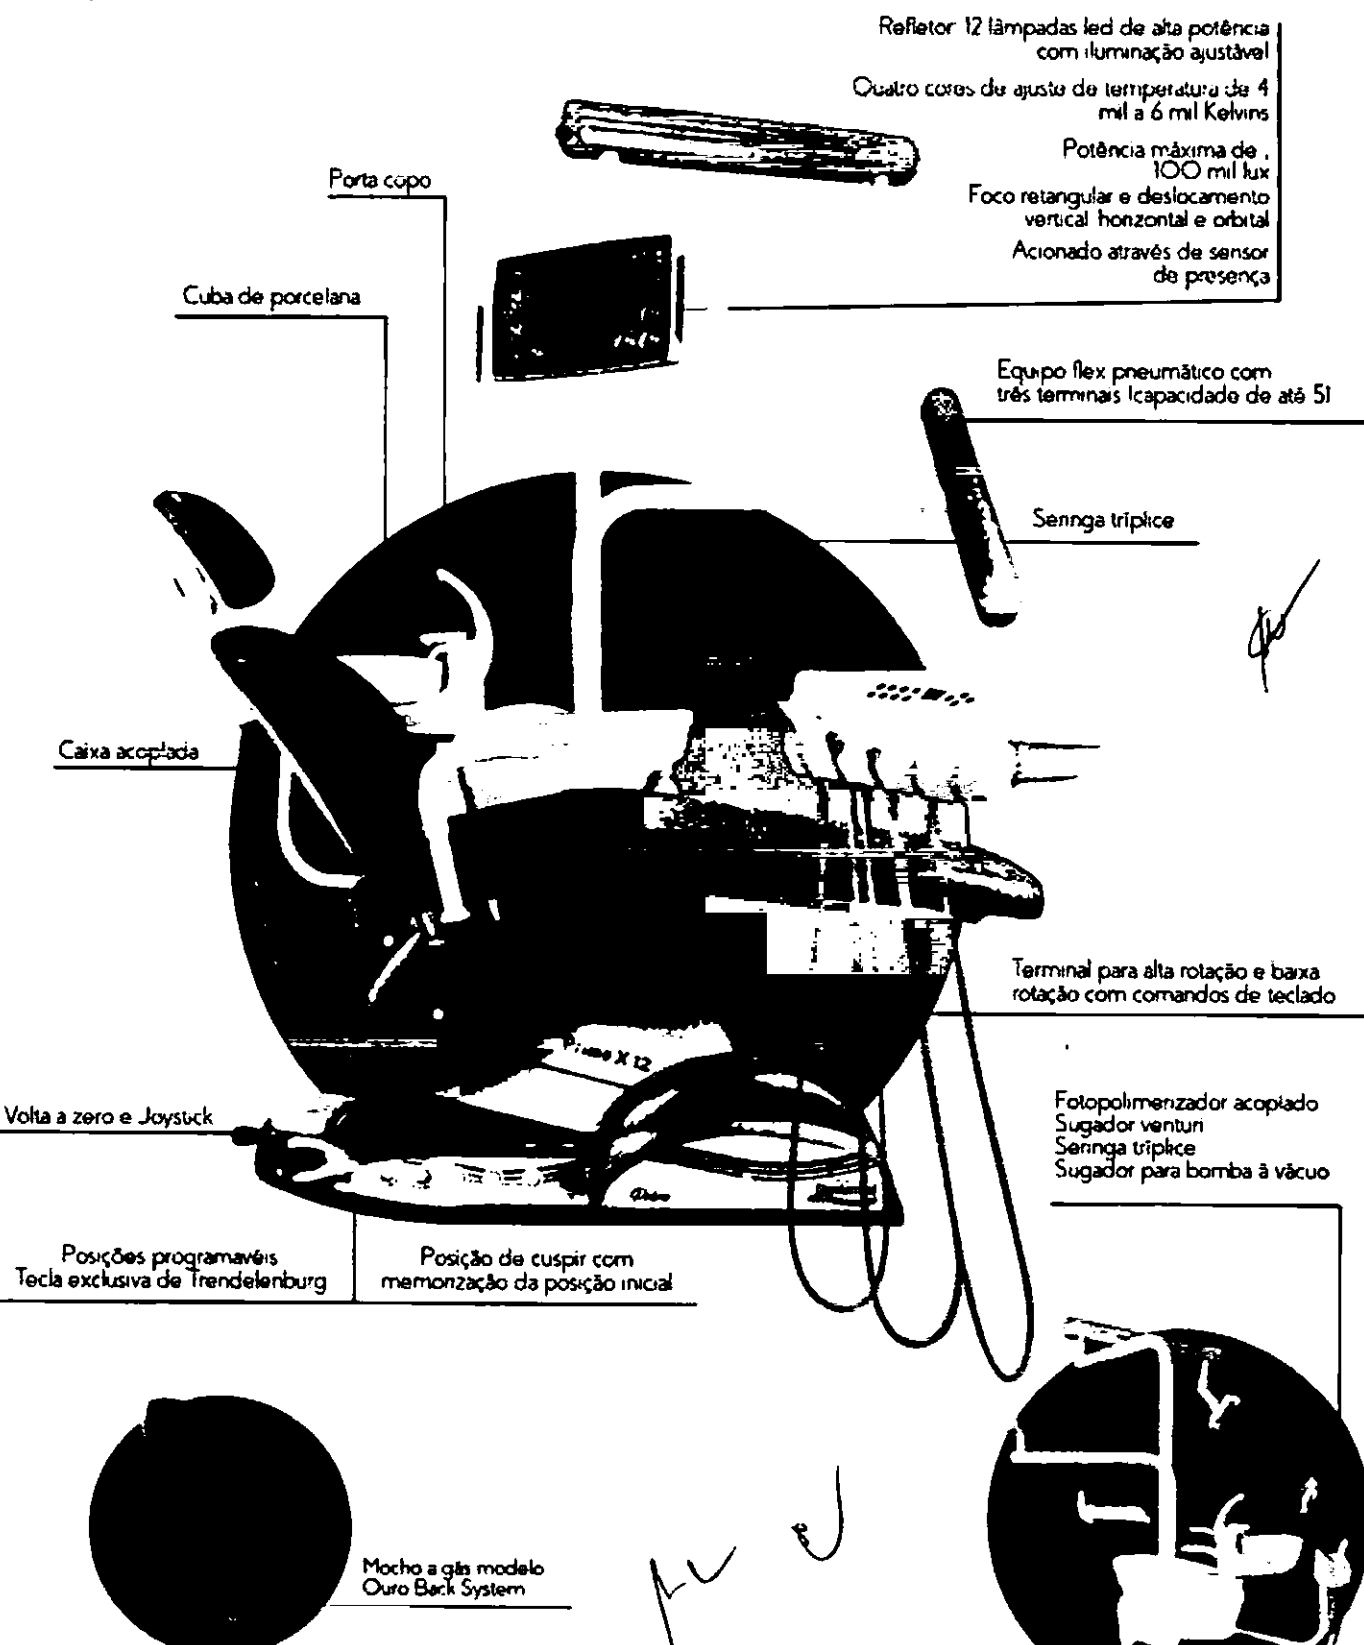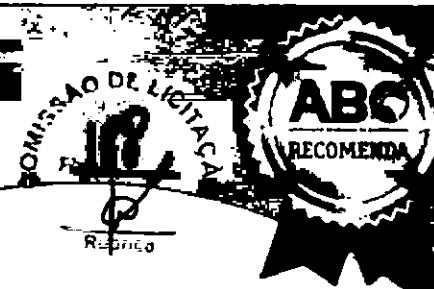

Refletor 12 lâmpadas led de alta potência com iluminação ajustável  
Quatro cores de ajuste de temperatura de 4 mil a 6 mil Kelvins  
Potência máxima de 100 mil lux  
Foco retangular e deslocamento vertical horizontal e orbital  
Acionado através de sensor de presença

Equipo flex pneumático com três terminais (capacidade de até 5l)

Seringa triplíce

Terminal para alta rotação e baixa rotação com comandos de teclado

Fotopolimerizador acoplado  
Sugador venturi  
Seringa triplíce  
Sugador para bomba à vácuo

Porta copo  
Cuba de porcelana

Caixa acoplada


Volta a zero e Joystick

Posições programáveis  
Tecla exclusiva de Trendelenburg

Posição de cuspir com memorização da posição inicial

Mochô a gás modelo Ouro Back System

RMS Anvisa 80349600007

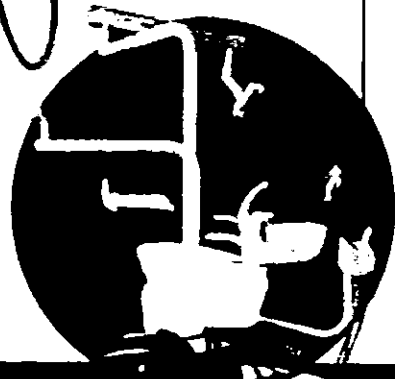



# Opcionais



COM Fis. 189  
Pneumática  
INSTAÇÃO




Braço Flex com travamento pneumático.




Bandejas autoclaváveis em inox.



Cabeceira Multiarticulada com posição infantil, PCD e cadeirante



Braços laminados rebatíveis e escamoteáveis com abertura completa



Pedal multifuncional fixo ou móvel com todas as funções da cadeira, incluindo peças de mão, refletor e cuspeira.



01 ou 02 Terminal(s) extra de alta rotação ou Terminal Baixa rotação refrigerado (Com Spray)




Exclusivo sistema de instalação com cana de coleta acoplada ou externa (conforme necessidade do local)




Filtro Detritos Incorporado na caixa de comando e de ligação




Acionamento da água da cuspeira eletrônico temporizado no pedal ou através de sensor.



Acionamento temporizado da água da cuspeira por botão ou sensorizado por aproximação.




Reservatório de água potável e líquido bactericida de 1.000ml (1l)tro




Sistema de assepsia e desinfecção do equipo com válvula antiretração



Rebatimento da unidade auxiliar com movimentos de até 180 graus.



Braço assistente para até 3 sugadores, seringa triplex e ou bomba de vácuo




Cuba em louça, porcelana, cerâmica, translúcida ou PBI super resistente.




Puxadores laterais ou puxador frontal incorporados.




Fotopolimerizador e negatoscópio acoplado, com radiômetro incorporado.




Ultrassom piezoelétrico com luz de led e jato de bicarbonato incorporado



Negatoscópio de LED acoplado.




Sistema exclusivo de aquecimento de água da seringa triplex.




Equipo com teclado e visor digital de função acionada




Manômetro incorporado.



Tubulação totalmente embutida com cana de coleta incorporada ou externa



Segundo sugador e seringa triplex incorporados à unidade auxiliar




Sensor de aproximação com temporizador eletrônico de alta sensibilidade.




Terminais extras e kits para bomba de vácuo.




Porta copos com regulagem automática



Refletor Prime CX249-24 com 12 (doze) LEDs de alta potência (100.000 lux) 04 cores de ajuste de temperatura - de 4000 a 6000k. (Coe amarela).



Refletor Prime CX249-23 com 06 (Seis) Leds de alta potência (45.000 lux) com 07 ajustes de intensidades (lux)



Filtro regulador de ar com drenagem automática.

## Mocho PRATA

- 01 (uma) alavanca sublaterais (regulagem longitudinal do assento).
- Encosto anatômico e assento com rebaxamento nas pernas e giratório
- Revestimento do assento e encosto estofados anatomicamente e totalmente sem costuras.
- Base com 5 rodízios duplos.
- Capacidade até 135 Kg.

Opcional com estrutura na cor cinza





## Mocho OURO

- 02 (duas) alavancas sublaterais, (regulagem longitudinal do assento e do encosto quanto a inclinação)
- Encosto anatômico e assento com rebaxamento nas pernas e giratório
- Revestimento do assento e encosto estofados anatomicamente e totalmente sem costuras.
- Base com 3 rodízios duplos.
- Capacidade até 135 Kg.


Opcional com braços reguláveis

## Mocho OURO CROMADO

- 02 (duas) alavancas sublaterais, (regulagem longitudinal do assento e do encosto quanto a inclinação)
- Encosto anatômico e assento com rebaxamento nas pernas e giratório
- Revestimento do assento e encosto estofados anatomicamente e totalmente sem costuras
- Base cromada com 5 rodízios duplos de alicone.
- Capacidade até 250 Kg.

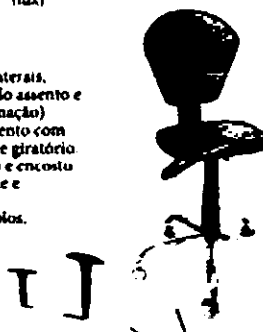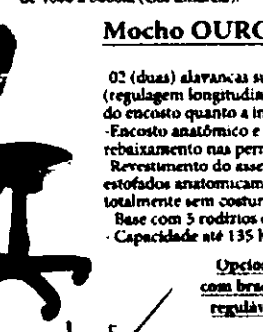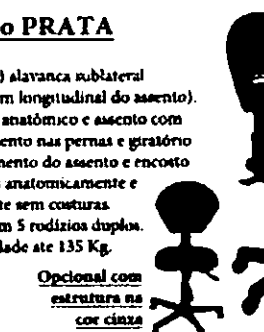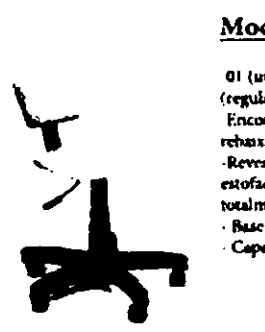

# Características Principais: Refletor Odontológico 12 Leds RModelo CX-249-24 Dentemed

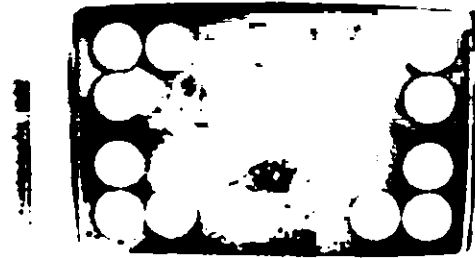

O painel de espelho pode ser facilmente observado por médicos ou pacientes

## Funcionalidade:


- 1-Há 4 cores podem ajustar a temperatura, de 4000 a 6000K
- 2- Existem 12 luzes LED de alta potência com iluminação ajustável e a iluminação máxima pode chegar a 100000lux
- 3-Use o cordão da lâmpada LED com 90 ORL para restaurar a autenticidade da cor
- 4-Concluir tecla de toque e interruptor de controle duplo com toque
- 5- Ambos os lados têm o mesmo painel de teclas, o que é conveniente para as duas mãos operarem
- 6- Alça removível, esterilização a álcool ou esterilização a alta temperatura
- 7-O painel do espelho pode ser facilmente observado por médicos ou pacientes
- 8-O perfeito para nenhum efeito de sombra

Fonte de alimentação: AC24V  
Consumo de energia: 6W-36W  
Luz LED: 12 PCS

Intensidade da luz (lux): > 100.000 LUX  
Dimensão do padrão: 80X160mm (no 700mm)  
Temperatura de cor: 4000K-6000K  
CRI : >90Ra  
hadow(solução) : <Φ8mm  
Intensidade do olho (lux): <600lux  
Faixa de interação: 20-80mm  
Dimensão da junta: ø22  
Peso (kg)/PCS: 2kg




Existem 12 luzes LED de alta potência com iluminação ajustável e a iluminação máxima pode chegar a 100000lux

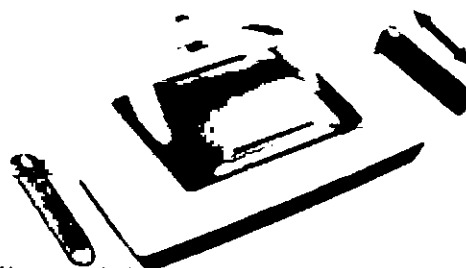

Alça removível, esterilização a álcool ou esterilização a alta temperatura




Ambos os lados têm o mesmo painel de teclas, o que é conveniente para ambas as mãos operarem

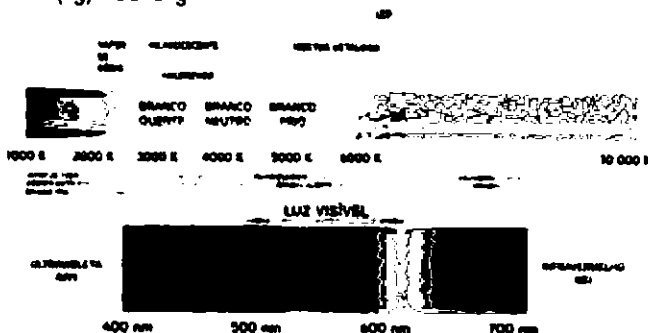

O ponto do feixe é retangular e o tamanho é moderado. (80x160mm a 700mm)E nenhuma luz ofuscante ao redor

# Características Principais: Refletor Odontológico 06 Leds Modelo CX-249-23 Dentemed

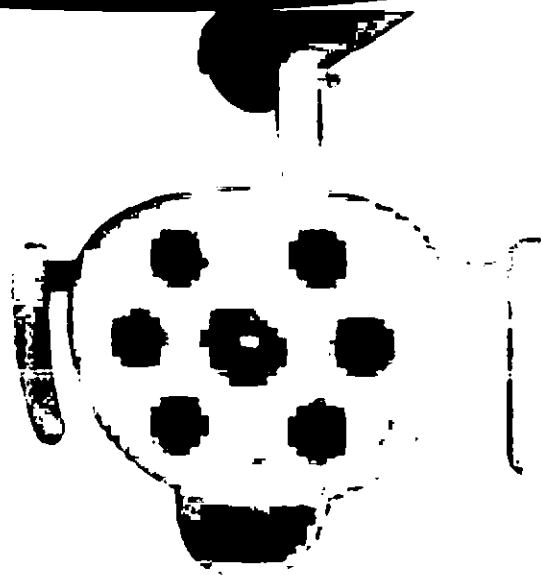



1- A luz é suave, não machuca os olhos, o adpot CRI torna o rosto brilhante mais realista.

2- Sem separação de cores: a cor e a temperatura de cor para todo o ponto de luz são as mesmas, reduzem muito a separação de cores através da lente, bem como o efeito para o material sensível light.


3- A eficiência da luz é maior: A iluminância pode atingir mais de 45.000 lux quando a potência é de 6W. O modo de reflexão pode alcançar mais de 500001x.

4- A lâmpada dental do diodo emissor de luz pode alcançar stepless ajustável.

Fonte de alimentação: AC12-24V  
Consumo de energia: 6W  
Luz LED: 1 PCS  
Intensidade da luz máxima: 45.000L UX  
Dimensão do padrão: 80X160mm (a 700mm)  
Temperatura de cor: 5000-5300k  
CRI: 85%  
Sombra (solução): <math>\phi</math> 12mm  
Intensidade do olho (lux): <math><200</math>lux  
Faixa de interação: 20-80mm  
Dimensão da junta:  $\phi$ 22  
Peso (kg)/PCS: 1,1 kg

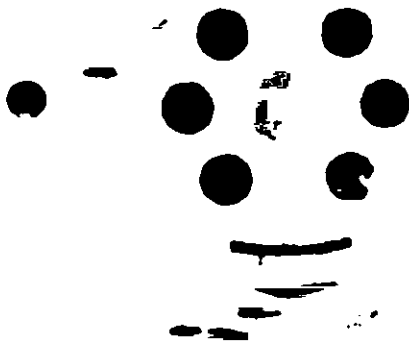

Puxador bilateral tipo aças removíveis e esterilizáveis



6 LEDs de alta potência com espaço reservado com pequeno espelho



Iluminação ajustável por sensor. Temperatura do calor na faixa de 5 000k e 5300K. Como uma luz natural, reduz os danos aos olhos durante a operação de longo tempo.



Movimento livre de 3 eixos, posicionando a luz onde quiser




Sistema triplo de acionamento com 07 intensidades (Ajuste por Sensor, por interruptor e pelo pedal da cadeira)




A temperatura de calor e calor para todo o ponto de luz é a mesma, reduz bastante a separação de calor através da lente, bem como o efeito no material sensível à luz.

Desenho partes e eixos de movimentação:

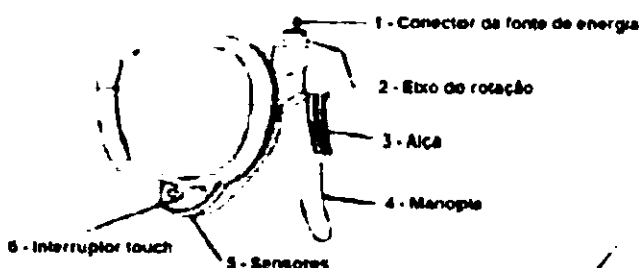

3 eixos de rotação



# Linha 1 Consultórios Odontológicos - Conjunto Transportátil

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
F. 192  
JURIDICA

- 01 Cadreira Odontológica Transportável para paciente, peso de aproximadamente 5 kg, dobrável, 05 posições, composta de assento, pé dianteiro, traseiro, apoio lombar e apoio para pés, apoia braços com seletor de posições. Possui estrutura construída em alumínio tubular redondo 7/8" x 1,00mm liga 6063, com reforço em alma tubular de aço carbono 3/4" com parede 1,2mm nas peças dos pés dianteiro, traseiro e encosto. Encosto com desenho triangular na extremidade superior, facilitando o atendimento odontológico. Todas extremidades dos tubos devem possuir acabamento com pontas plásticas injetadas em polipropileno, bem como sapatinhas plásticas aderentes nos pés dianteiro e traseiro. Reclina 100% na última posição. O apoio dos pés possui articulação e se mover de acordo com a posição do apoio lombar, tornando necessário apenas a escolha da posição desejada no seletor de posições. Possui dobradiças de alumínio, possui revestimento base de tecido em poliéster 100% revestido com PVC soldado, revestimento superior em estofado de nápa, preenchido com espuma densidade 23 com fixação por encaixe superior e inferior e cinta de amarração com conector plástico, que possibilita com facilidade a retirada e troca do mesmo para higienização ou substituição. Medidas aberta: comprimento 102cm x 62cm largura x 121cm altura aberta na posição 01. Medidas fechada: comprimento 62cm x 15cm largura x 125cm altura fechada (sem pé). Capacidade máxima de carga indicada: 120kg.
- 01 Equipamento odontológico transportável, fabricado em caixa tipo mala em material leve, resistente e com rodízios e alças que facilitam o transporte. Estrutura estável proporciona ergonomias absoluta para posicionamento ideal do cirurgião dentista, caretagem construída em poliestireno com cantos lisos. Sistema de movimentação através de rodízios em silicone. Mala com equipo composto de Seringa Triplice, terminal borborete refrigerado de Alta e Baixa rotação e sugador de alta potência tipo Venturi. Suporte de pontas com acionamento automático. Pedal de comando progressivo. Reservatório de água limpa com capacidade de 500ml. Alimentado por ar de compressor odontológico portátil, com acionamento ao retirar a peça de mão do suporte, pressionar o pedal de comando para acionamento. Painel com os seguintes instrumentos: 01 suporte para caneta de alta rotação com corte contínuo e homogêneo, 01 suporte para caneta de baixa rotação (micromotor com contra balança e peça reta), 01 suporte com uma seringa triplice e 01 suporte com um sugador. Pedal para controlar a velocidade das canetas de alta e baixa rotação permitindo que o profissional selecione a velocidade necessária dependendo do tipo de intervenção que irá fazer. O acionamento das canetas é feito pelo pedal de comando. Painel do equipamento protegido pela porta frontal. Compressor odontológico portátil embutido com o equipo com capacidade de 09 litros, acionamento de óleo. Potência máxima de 01 HP - 750 watts 6,2pcms Alimentação 110V ou 220V.
- 01 Refletor odontológico Transportável retrátil com tripé e haste flexível de 56 cm, haste cromada mede 48cm, altura fechada 1,18 metros, altura aberto chega até 1,67 metros e lâmpada de led's branca fria com duração de 2.000 horas.
- 01 Banqueta (mocho) dobrável portátil para c.d. com encosto de metal, assento de courovin odontológico, dimensões altura 62cm, dimensões do assento: 28x28cm, estrutura metálica.



Banqueta



Refletor

Acessibilidade em locais de difícil acesso e atendimento home care.

Equipo com 4 terminais



Compressor Embutido 9 Litros

## Mochos a Gás

Material resistente, encosto com regulagem longitudinal, estofado ergonômico.



Prata - 1 alavanca sublateral, regulagem longitudinal.



Ouro - 2 alavancas sublaterais, regulagem longitudinal e de inclinação.



Ouro Cromado - 2 alavancas sublaterais, regulagem longitudinal e de inclinação, pés cromados



e encosto estofados com espuma injetada em poliuretano resistente e anatômico com densidade D33 e anti-deformante, revestido em PVC laminado e expandido ou couro sintético, anatomicamente e ergonômico sem costuras, revestido em filme odonto, garantindo maior resistência e durabilidade com resistência a luz e rasgos de fácil limpeza e desinfecção. Assento anti-deformante com estofamento anatômico, pouco espesso, com borda anterior arredondada com rebaixamento das pernas para maior facilidade da circulação sanguínea. Encosto ergonômico tipo concha, de espaldar alto, com encosto de altura mínima de 25 cm e comprimento mínimo de 34 cm e espessura de 3 cm com espaldar médio com estofamento anatômico e côncavo com amplo preenchimento da parte lombar com grande conforto ao profissional. Encosto reforçado anatômico com regulagem quanto à inclinação, oscilante com movimentos regulares de afastamento e aproximação, com movimentos de inclinação em torno de 7° para frente e 18° para trás, através de uma alavanca abaixo do assento e regulagem longitudinal com fácil ajuste (Modelo Ouro). Assento anatômico com movimentos acionados através de alavanca sub-lateral com o movimento de descida impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de uma mola, amortecidos por sistema de gás pressurizado (pneumático) que permitem movimentos suaves e o posicionamento na altura desejada. Encosto reforçado anatômico com regulagem longitudinal com fácil ajuste. Base giratória em nylon com cinco rodízios duplos, e resistentes ou Silicone (OURC CROMADO) proporcionando melhor estabilidade e movimentação, fixados nas extremidades da base de sustentação revestida em poliestireno de alto impacto. Estrutura em material tubo de aço, acabamento da estrutura pintura eletrostática em epóxi, revestido com capa telescópica do pedestal em polipropileno que permite melhor acabamento, na cor prata ou cinza Ou Base em metal cromado. Capacidade de carga 135 kg. Largura = 430 mm. Comprimento = 440/480 mm. Altura do assento = 410/500 mm. Altura do encosto = 420 mm.

Estofamento disponível em mais de 20 cores

# Linha 2 Compressores Odontológicos Isentos de óleo.



Compressores são isento de óleo. Capacidade: 1, 2, 3 ou 4 consultório(s). Reservatório com capacidade de 40, 50, 65 ou 120 litros. Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática). Possui abertura na parte inferior. Motor com potência 1.5, 2.0, 3.0 ou 4.0 Hp e 2 ou 4 cabeçotes. Baixo nível de ruído a um metro de distância. Dispositivos de Segurança com pressostato com chave geral liga/desliga, com válvula de segurança, dispositivo de alívio do excesso de pressão e rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão) protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva. Unidade com dois manômetros, um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída do ar. Filtro de ar com drenagem automática (retém a unidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar. Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de fácil acesso. Ventoinha de refrigeração nos motores. Filtro de aspiração (entrada de ar no reservatório). Mangueira do motor metálica e flexível. Válvula de alívio (solenoide) cuja função é a despressurização dos cabeçotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforço. Alimentação: 110 ou 220V - monofásico. Pressão Máxima de trabalho: 120psi (0,83 Mpa) Frequência de cada motor de 60 Hz. Velocidade de rotação de 1.750 RPM em cada motor. Com 1 ou 2 motor(es). Os compressores DENTEMED são auditados com Boas Práticas de Fabricação e controle na ANVISA (RDC 16/2013), ISO 9001 / ISO 13485 e OCP INMETRO UL-BR 20.0905



## **PRIME AIR 40**

Atende 1 consultório.  
Reservatório de 40 Litros.  
Fluxo de ar: 7,8 pés  
220 l/min.  
04 polos, 02 cabeçotes  
e 01 motor.  
Nível Ruído de 52 Db.  
Potência: 1,5 Hp / 1275W



## **PRIME AIR 50**

Atende 1 consultórios sem  
bomba a vácuo e 2 com  
bomba a vácuo  
Reservatório de 50 Litros.  
Fluxo de ar: 11,4 pés  
320 l/min  
04 polos, 02 cabeçotes e 01  
motor.  
Nível Ruído de 55 Db.  
Potência: 2,0 Hp / 1.500W



## **PRIME AIR 65**

Atende 2 consultórios  
sem bomba a vácuo e 3  
com bomba a vácuo  
Reservatório de 65 Litros.  
Fluxo de ar: 15,7 pés  
440 l/min.  
08 polos, 04 cabeçotes  
e 02 motores.  
Nível Ruído de 58 Db.  
Potência: 3,0 Hp / 2550W



## **PRIME AIR 120**

Atende 3 consultórios sem  
bomba a vácuo e 4 consult.  
com bomba a vácuo  
Reservatório de 120 Litros.  
Fluxo de ar: 22,8 pés  
640 l/min.  
08 polos, 04 cabeçotes  
e 02 motores.  
Nível Ruído de 65 Db.  
Potência: 4,0 Hp / 3.000W




# Linha 3 Peças de mão Alta rotação




O kit de peças de mão Dentemed é completo para as necessidades do cirurgião-dentista, com o melhor custo-benefício. Ele é composto por uma alta rotação, micromotor, peça reta e contra-ângulo, e ainda conta com bolsa para transporte e óleo lubrificante de alta performance

Peças com modelos de alta e baixa rotação com característica que atende a necessidade do cliente.

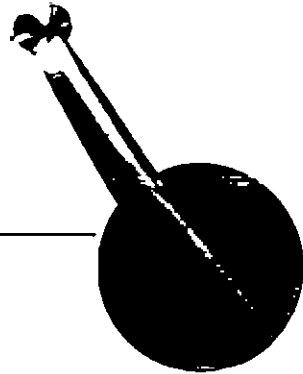

As canetas Prime Led CX207-W-2, Prime CX207-W-2 PB-Push Button e Prime CX207-W-2 FG - Friction Grip de alta rotação da DENTEMED possuem rolamentos com esferas de cerâmica, tecnologia de microbalanceamento digital, garantindo maior vida útil à peça.

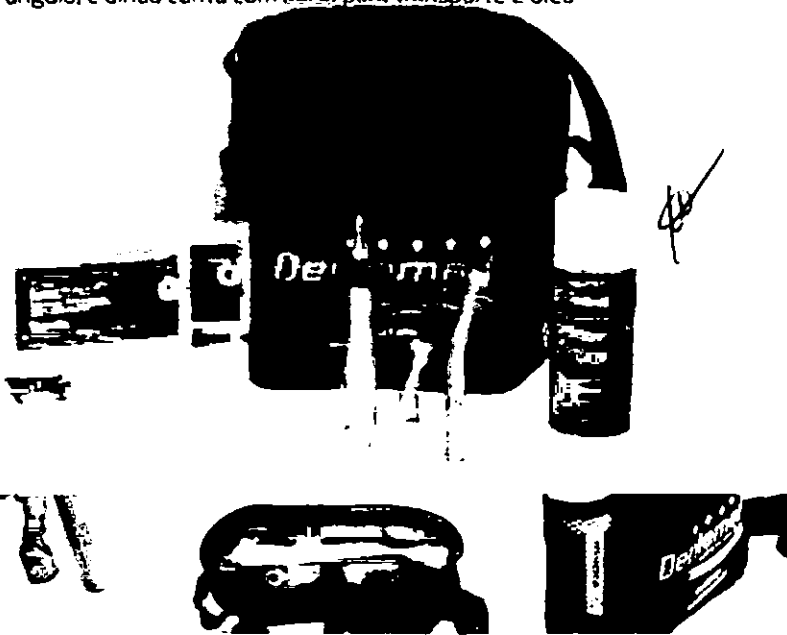


Apresentam design arrojado, são mais leves, anatômicas e confortáveis para o cirurgião-dentista, além das seguintes características:


- Autoclavável até 135° C por mais de 1.000 ciclos;
- Spray triplo (03 furos) distribuído simetricamente em direção à ponta da broca, projetado para refrigerar a região de corte da broca, em qualquer posição de trabalho, evitando o superaquecimento das peças de mão e reduzindo a possibilidade de interrupção do spray por entupimento dos orifícios;
- Sistema friction grip, saca-broca (tipo FG); ou
- Sistema Push Button, pressão por botão na cabeça (Tipo PB);
- Fixação da broca de forma fácil, prática e segura.
- Fresas recomendadas: FG 19-26mm;
- Rotação com velocidade de 280.000 a 450.000 rpm;
- Alto (Extra torque) torque com 0,13 N.cm e potência de 13W;
- Rolamentos com esferas de cerâmica e turbinas micro balanceadas que eliminam as vibrações aumentando assim a vida útil dos rolamentos.
- Sistema de rolamentos apoiados em anéis de borracha auxiliando assim o baixo nível de ruído de 64 decibéis;
- Fabricada em alumínio com tratamento anodizado, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. Formato ergonômico com ranhuras antiderrapantes, extremidade inclinada, peso de apenas 30g;
- Encaixe Bordem Universal (ISO 9168) acoplável a todos os modelos;
- Sistema de tratamento de enrijecimento da camada superficial que assegura a durabilidade da rosca;
- Pressão de ar de trabalho entre 32 e 35 libras (psi).
- Consumo de ar: 34-37 l/min;
- Gerador de luz com iluminação LED com sistema de Luz com conexão Bordem entre o gerador e o equipo (Prime Led CX207);



**Prime Led CX207-W-2 PB (Push Button)**  
Gerador de luz com iluminação por LED

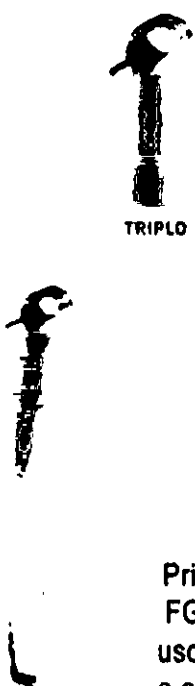

**Prime CX207-W-2 PB (Push Button)**  
com Spray Triplo

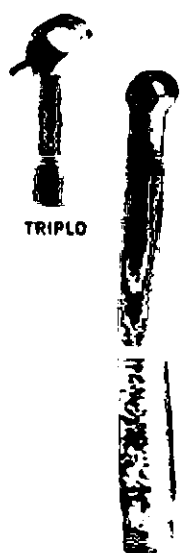

**Prime CX207-W-2 FG (Friction Grip)**  
uso de Saca Broca e com Spray Triplo






# Linha 3 Peças de mão Baixa rotação

195  
+95  
OV 20  
LUBRIFICA



Accessório (Opcional).  
Lubrificante odontológico  
tipo óleo mineral, spray  
com adaptador para  
caneta de alta e baixa  
rotação, sem CFC,  
embalagem de 200ml.

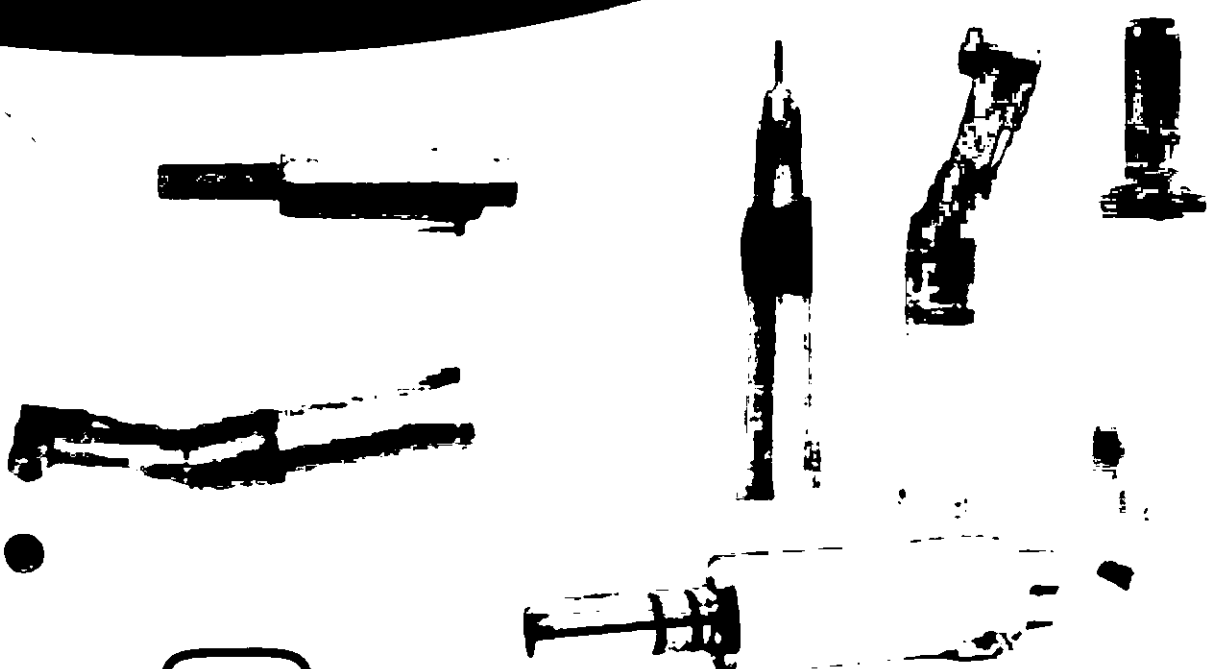

Apresentam design arrojado, são mais leves, anatômicas e confortáveis para o cirurgião-dentista, além das seguintes características:

### Contra Angulo Prime CX235-1F


- Acoplamento por sistema INTRA em aço inox com giro livre de 360° (ISO 3964);
- Sistema de spray externo, composto por trava com cano condutor e mangueira de silicone externa que permite a condução da água do micromotor até a extremidade da ponta ativa, eliminando a possibilidade de entupimento e possibilitando a substituição da mangueira de passagem de água, beneficiando assepsia e evitando o risco de contaminação cruzada, refrigerando a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho, evitando o superaquecimento da mesma;
- Esterilização em autoclave até 135° C por mais de 1.000 ciclos;
- Velocidade com rotação máxima de 25.000 rpm com torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1;
- Ângulo de 20 graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça;
- Corpo em alumínio e latão, com camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. Peso de apenas 49 gramas.
- Cabeça em liga metálica maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas.
- Baixo Ruído de Trabalho, minimizando o estresse do operador e do paciente.
- Sistema de lâmina para fixação das brocas - por meio da Lâmina Trava na cabeça do contra ângulo. Resistente a uma tração superior a 45 N. Utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de Alta Rotação de 1,6mm (com mandril).
- Pressão ar: 60 a 80 (psi), consumo de ar: 65 (l/min).

### Micromotor Prime CX235-3F

- Confeccionado em metal com design arrojado com linhas arredondadas com corpo em alumínio anodizado com tratamento cromado acetinado, pesando apenas 90 gramas;
- Ranhuras antiderrapantes e indicação de sentido no anel de com regulagem de rotação/inversão no corpo.
- Spray interno por condução interna pelo terminal bordem e saída por niple de encaixe para mangueira;
- Encaixe Bordem Universal (ISO 9168) com Rosca da conexão com tratamento eletroquímico;
- Velocidade com rotação de 3.000 a 25.000 rpm com transmissão de 1:1 de alto torque e potência 11W / 2,2 Bar;
- Acoplamento por sistema INTRA (Intramatic) com giro livre de 360° (ISO 3964)
- Baixo nível de ruído (65 dB) e vibração que gera menos estresse para o dentista e paciente;
- Esterilização em autoclave até 135° C a 2,2 bar por mais de 1.000 ciclos
- Consumo de ar de 65,0 l/min e pressão de trabalho de 60 a 80 Libras (PSI).
- Acompanhado de borracha de vedação da conexão e/ou óleo lubrificante.

### Peça Reta Prime CX235-2A

- Peça com formato ergonômico e anatômico com corpo confeccionado em alumínio anodizado com camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. Pesando 43 gramas.
- Peça reta com sistema de troca brocas por fecho por giro de anel;
- Acoplamento por sistema INTRA (Intramatic) com giro livre de 360° (ISO 3964)
- Sistema de refrigeração spray único externo padrão;
- Esterilização em autoclave até 135° C por mais de 1.000 ciclos;
- Velocidade com rotação entre 3.000 a 25.000 rpm com transmissão de 1:1 por um conjunto eixo e engrenagens;


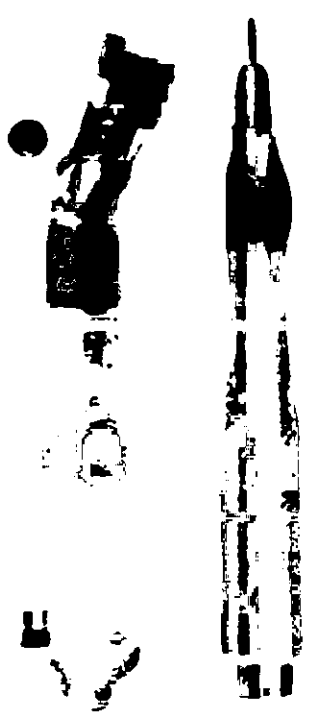


# Linha 3 Peças de mão Kit acadêmico



O kit de peças de mão Dentemed é completo para as necessidades do cirurgião-dentista, com o melhor custo-benefício. Ele é composto por uma alta rotação, micromotor, peça reta e contra-ângulo, e ainda conta com bolsa para transporte e óleo lubrificante de alta performance.

Podem ser customizados com modelos de alta e baixa rotação conforme a necessidade do cliente

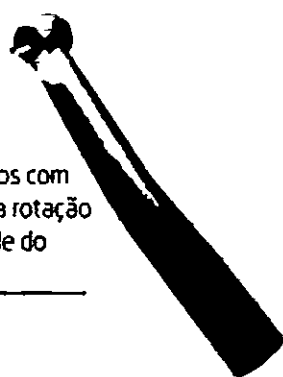

# Linha 4 Fotopolimerizadores

Altíssima potência, última geração. Modelo com e sem fio

## FOTOPOLIMERIZADOR PRIME LED

WIRELESS

Aparelho com a peça sem fio por wireless. Confeccionado em termoplástico injetado (ABS) moderno e resistente e de fácil higienização. Intensidade luminosa por LED de alta potência até a 1.500 mw/cm<sup>2</sup>. Ponteira condutora de transmissão de luz, distribuição óptica por condutor de fibra óptica 100% coerente autoclavável a 134°C. Feixe de luz colimado promovendo uma ótima potência ótica, prevenindo a formação de áreas de luz heterogêneas, sem perdas na qualidade da intensidade luminosa. Controle de operação com botões na própria caneta com acionamento tipo gatilho. Ajuste do tempo de ativação por tempo de operação programável 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 segundos. Sinal sonoro BIP a cada 5 segundos. Seleção do modo de aplicação em 03 modos programáveis de aplicação: - Contínuo: Máxima luminosidade do início ao fim da polimerização; - Rampa: gradual crescente nos primeiros 5 segundos; - Pulsado: potência máxima pulsante com intervalos de 1x1 segundo; Base de descanso com carregador de bateria e radiômetro externo para verificação da intensidade da potência de luz (Baixa e alta); Com LED indicador de carga da bateria. Sistema stand-by, desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização. Bateria com sistema inteligente que se desliga em caso de sub tensão, garantindo a foto ativação. Bateria de alta performance, com mais de 600 aplicações de 15 segundos com carga cheia. Sistema de segurança que desliga automaticamente em caso de subtensão, garantindo uma fotoativação segura. Sem necessidade de descarregar completamente para efetuar nova recarga. Alimentação multitenção: 100 - 240 Vac 50/60Hz Potência de entrada: máxima 8 VA Bateria: Litium 3,7 V - 1.400 mAh; Comprimento de onda: 435 - 485 nm; Acessórios que acompanham produto: 01 Peça de mão, 01 ou 02 Condutores de luz fibra ótica, 01 ou 02 Ponteira clareamentos dentes (opcional), 01 Protetor ocular, 01 Base carregadora e 01 Fonte de alimentação.



RMS Anvisa 80349609004

Dentemed  
CORPORATE S.A.




# Linha 5 Profilaxia

O ultrassom DENTEMED está disponível em duas versões, com a função ultrassom + jato de bicarbonato com água da rede ou função ultrassom + jato de bicarbonato com água do reservatório sistema Pump. Ambos compactos, leves e de fácil posicionamento para o trabalho. Material corpo plástico ABS. Indicado para a realização de procedimentos de profilaxia em odontologia. Possui regulagem precisa de potência e volume do fluxo irrigante e sua peça de mão é mais leve e anatômica, permitindo uma melhor sensibilidade tátil. Aparelho conjugado de ultrassom piezoelétrico para profilaxia do cálculo e jato de bicarbonato de sódio para remoção do biofilme não mineralizado. Com design vertical, oferece resistência estrutural e equilíbrio. Circuito Eletrônico localizado atrás do painel frontal, fica isolado dos demais componentes do aparelho, preservando sua vida útil. Com estabilizador de frequência, não permite que as oscilações comuns da rede elétrica interfiram no padrão de vibração ultrassônica do equipamento. Painel de Controle do sistema ergonomicamente desenhados, facilita a visualização e manuseio dos comandos do aparelho. Display indicativo de qual função está acionada Ultrassom Perio, Ultrassom Endo, Ultrassom Geral (Dentística), bomba peristáltica ou jato de bicarbonato - e qual potência está habilitada. Teclados tipo membrana seletora das funções, para configuração da vazão do líquido irrigante e diminuição ou aumento da potência em 10 níveis (Potências Baixa, Média e Alta), teclas de memórias por função e teclas + e - para configuração e seleção da função. Peça de Mão do Ultrassom leve e de formato anatômico, de fácil empunhadura, permite precisão no trabalho de raspagem e melhor sensibilidade tátil para completa remoção do cálculo, pois não é a força aplicada que fará a remoção, mas a vibração ultrassônica aplicada ao dente. Transdutor Cerâmico Piezoelétrico: Com quatro pastilhas de cerâmicas montadas intermitentes uma a outra, que trabalham sob altíssima pressão, gerando vibrações ultrassônicas entre 24 a 35 kHz com a mesma amplitude e frequência. Duas capas protetoras do transdutor, rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave até 135°C. Elimina a contaminação cruzada e não submete o transdutor à autoclavagem, preservando sua vida útil, pois é sabido que esterilizações frequentes do transdutor cerâmico comprometem seu rendimento.


Bomba Peristáltica (Exclusivo Prime Pump) com micromotor elétrico com eixo central que gira três roletas que pressionam a mangueira contra o cabeçote impulsionando o líquido. A velocidade da rotação do micromotor possibilita a regulagem da vazão do líquido irrigante. Tanque do reservatório de líquido irrigante acoplado e removível faz o aparelho ser independente de fontes de abastecimento de água, facilitando o deslocamento do equipamento para outro local de trabalho. Confeccionado em policarbonato transparente, fácil visualização do nível do líquido, permite o uso de água destilada, soro fisiológico ou de soluções antissépticas que potencializam o efeito ultrassônico e a ação antibacteriana pela ação cavitacional. A remoção e o formato do tanque facilitam na sua higienização. Com 04 níveis de rotação da bomba peristáltica, reservatório de água incorporado ao aparelho e ponteiros.

Especificações técnicas: Altura com reservatório da bomba peristáltica 13,2cm. Dimensões: largura 21,8cm, comprimento 24cm. Peso líquido: 3,00 kg. Peso bruto: 4,00 kg. Volume do reservatório da bomba peristáltica 500ml. Frequência do ultrassom: 32.000 hz. Pressão de entrada de ar: 60 psi a 80 PSI. Alimentação: bvol 127V/220V. Frequência: 50/60 hz - fusível: 1A 127V/220V. Potência: 60 VA. Consumo: 0,45A.

## APARELHO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO

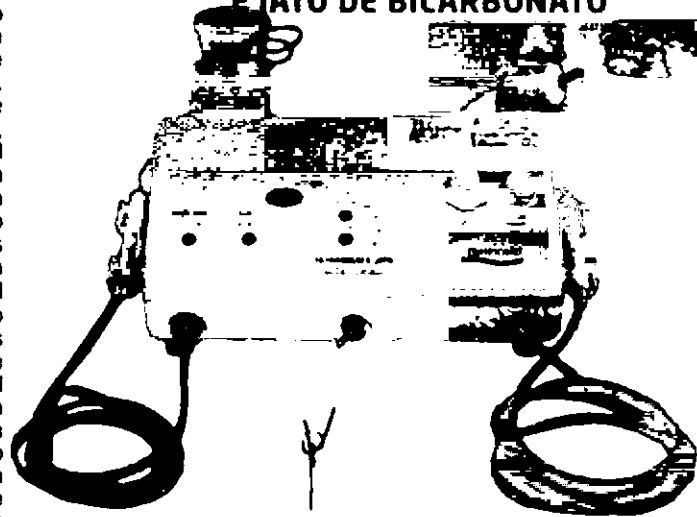


### OPÇÃO COM BOMBA PERISTÁLTICA

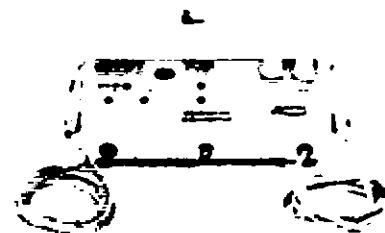


## Scaler Magnus

Peça de mão para remoção de tártaro, que oferece excelente acabamento superficial, facilitando assepsia e desinfecção com baixo nível de ruído. Cavidade Sônica com encaixe/conexão bordem universal. Movimento elíptico da ponta, eficiente na remoção de cálculo dental. Seu desenho estabilizado, cabo anatômico que facilita limpeza e fácil visibilidade no equipo, e baixo peso reduzem o cansaço em tratamentos longos. Sistema de refrigeração proporciona à superfície a ser tratada uma temperatura amena e constante. Chave extratora foi desenvolvida de modo a proteger os inserts no momento da troca. Fácil instalação. Pressão correta indicada: 40-60 PSI ou 2,2-4 bars. Consumo de ar: 10-26 l/min. Nível de som: 66 db. Frequência: 5,2 a 8 KHz. Peso leve de 52g. Não necessita de lubrificação. Esterilizado em autoclave a 135°C por 10 minutos após cada utilização. Acompanha 3 ponteiros (Universal - Perio - Sicile) e chave com torquímetro. ANVISA: 80349609003

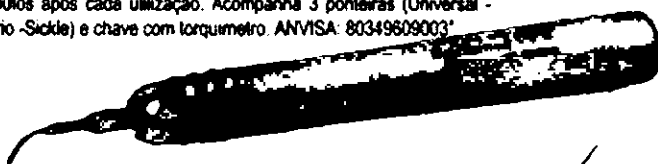

## Jet Magnus JATO DE BICARBONATO BORDEN

Com sistema borden para remoção de placa bacteriana.

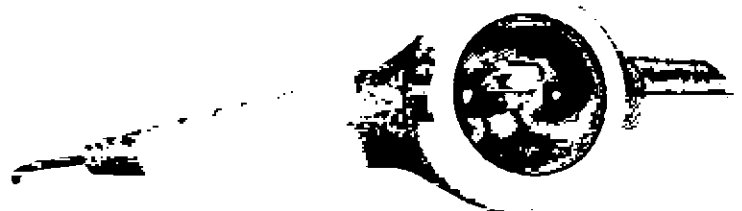

Jato de bicarbonato com design ergonômico e agilidade no manuseio, leve com 125g. Ponteira autoclavável. Facilidade na desobstrução. Corpo em Alumínio / plástico / borracha. Encaixe/conexão: Padrão Borden (02 furos). Esterilizado em autoclave a 135°C por 10 minutos após cada utilização. Pressão exercida de ar: 2.3 a 3.2 bars. Consumo de bicarbonato: 2.4 g a 3.2 g/min. Consumo de água: 30 ml / min. Capacidade do reservatório: 10 g. Dimensões: 160 mm / 55mm/40mm. ANVISA: 80349609002

# Linha 6 - Amalgamador Restauração

COMISSÃO DE LICITACÃO  
FR 198  
[Assinatura]

## AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL DENTMIX


**CAPSULAR DIGITAL - DENT MIX** foi projetado para o sistema de trituração em cápsula. Moderno, seguro, rápido e preciso na programação do tempo de trituração, permitindo regulagem do tempo entre 0 a 99 segundos, com memorização do último tempo. Possui garra de aço inox para fixação da cápsula, apresentando facilidade de colocação e renovação da cápsula e dispositivo automático de segurança, micro chave/switch de segurança na tampa. Chave geral.

O movimento é interrompido, instantaneamente, nos casos de abertura acidental da tampa de proteção. Design moderno com cantos arredondados, confeccionado com material resistente.

- Maior durabilidade.
- Facilita a limpeza e desinfecção.
- Melhor integração com outros componentes do consultório.
- Pannel de comando com seletor em membrana e mostrador de tempo digital.
- Facilidade de manuseio com ótima visualização do display.
- Ajuste do tempo de trituração.
- Maior amplitude, possibilitando o trabalho com outros materiais (ex: ionômeros de vidro).
- Repetição do tempo anterior.
- Assegura a precisão e economia de tempo nas programações.
- Ao selecionar a opção 127V, o aparelho poderá trabalhar normalmente na faixa de alimentação de 114 a 140 V~.
- Ao selecionar a opção 220V, o aparelho poderá trabalhar normalmente na faixa de alimentação de 198 a 242V~.
- Sistema eletrônico de baixa tensão.
- Maior segurança ao operador.
- Maior durabilidade dos componentes eletro-eletrônicos.
- Motor Bosch.
- Baixo nível de ruído.
- Baixo índice de manutenção.
- Alimentação: 127 OU 220 V
- Frequência: 50/60 Hz.
- Número de fases: Monofásico.
- Frequência de vibração: 4600/min.
- Máxima amplitude de oscilação: 25 mm.
- Potência de entrada: 90 VA.
- Fusíveis de proteção: F1 e F2 ..... 1.
- Consumo: 0,7A - 127 V~ / 0,4A - 220 V~.
- Peso: 3,86 Kg.
- Altura: 21,20 cm X Largura: 22,00 cm X Comprimento: 26,00 cm.
- Garantia: 1 ano

# Autoclave Horizontal AutoPrime 21L

A Autoclave 21L da Dentemed garante uma esterilização eficiente dos instrumentais. Ela é fabricada com materiais resistentes, de longa durabilidade e conta com dispositivos de segurança contra aumento excessivo de pressão e temperatura. Além dos mecanismos de proteção durante o manuseio do equipamento, a autoclave ainda tem funções padrões pré-programadas para facilitar a rotina do cirurgião-dentista. Painel de comando simples e de fácil acesso. Visor digital que indica e acompanha todas as funções. Confeccionada em aço inox, sem risco de oxidação. Eficiência baseada em três fatores: temperatura do vapor saturado da água, tempo de exposição e pressão. Sensor de aquecimento que desliga a resistência caso a temperatura ultrapasse o limite ajustado.


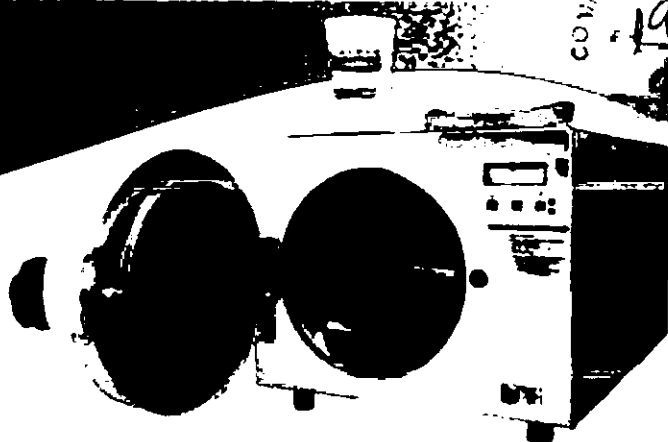


- Contem:
- 01 Cabo de alimentação AC;
  - 01 Suporte para bandejas;
  - 02 ou 03 Bandejas;
  - 01 Copo dosador;
  - 01 Mangueira;
  - 01 Manual de Instruções de uso.




40

Característica / Especificações Técnicas	Modelo Auto Prime 21 Litros
Tensão de Alimentação	Bivolt automático 127VAC - 220VAC / 50Hz - 60Hz
Frequência	50/60 Hz
Potência Máxima de Consumo	1.600 W
Capacidade	21 Litros
Proteção contra choque elétrico	Classe I
Faixa de temperatura de trabalho	+ 5 °C a 40 °C
Faixa de umidade de trabalho	Máx. UR 80% até 31 °C decaindo linearmente para 50% a 40 °C
Altitude máxima de operação	3.500 m
Moderação de operação	Contínuo
Pressão de Operação	1,1 bar e 2,1 bar
Temperatura de esterilização	121 °C e 134 °C
Consumo de água durante o processo	250 ml
Temperatura da água drenada	100 °C
Válvula de segurança de pressão	3 bar
Termostato de Segurança	300 °C
Grau de Poluição	2
Grau de Proteção IP	IP00
Nível de ruído	62 dB a 1,0 m
Dimensões internas da câmara (vaso de pressão) (D x P)	25 x 47 cm
Dimensões externas da autoclave (L x A x P)	38 x 37 x 67 cm
Dimensões das bandejas (L x A x P)	24 x 9 x 43 cm
Categoria do Vaso	V
Certificação do Vaso de Pressão	Nº Certificado INMETRO 005.2019.VPS.02 (Nova Inox)
Registro da ANVISA	80349600006

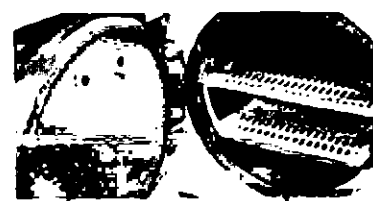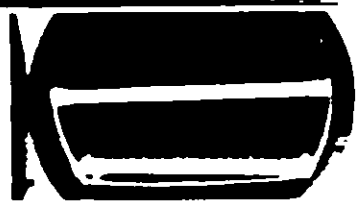

# Linha 07 - Máscara Prime KN95 - Betaniamed EPI




Respirador KN95 (PFF - Peça Facial Filtrante) apresenta-se como importante elemento de proteção no combate contra o Corona Virus (COVID 19).

Recomendado para proteção das vias respiratória dos trabalhadores da área da saúde contra exposição de agentes biológicos causadores de tuberculose, rubéola, SRAG/SARG, varicela, sarampo, gripes (H1N1, HSN1), etc. Exposição de fumaças provenientes de cirurgia a laser e bisturi eletroeletrônico. Este respirador oferece EFB - Eficiência de Filtração Bacteriológica >95% e resistência à penetração de sangue e outros fluidos corpóreos. Poeiras, névoas e fumos, até 10 vezes o limite e exposição ocupacional.

O Respirador KN95 (PFF2) não tem manutenção. Confeccionado com 05 (cinco) camadas externas de tecidos: Camada externa em NT PES (Não tecido a base de polipropileno); elemento filtrante, composto por microfibras de polipropileno tratadas eletrostaticamente com a finalidade de retenção de partículas. Possui um clipe nasal e elásticos de látex para ajuste. Cor Branca na face, branco na face interna e elástico branco. Altura: 150mm (MEDIDA DO QUEIXO AO NARIZ). Largura: 110mm (MEDIDA DE ORELHA A ORELHA). Eficiência acima: 95% (PFF). Peso Aproximado: 9 g.

\*Produto Certificado CE 1463 FFP2 - Fabricado de acordo com a EN 149: 2001+A1: 2009 Filtragem da peça facial e respiradores de partículas - (Recomendação da União Europeia 2020/403). Registro no FDA M20619 (Respirator Surgical - Disposable Protective Mask KN95 - N95 Mask. Testado conforme norma GB2626-2006 - Equipamento de proteção respiratória - respirador sem partículas para purificação do ar.\*




*[Handwritten signature]*

Selo CA 45.072 que qualifica este Produto como um E.P.I.


Filtragem comprovada de laboratório acima de 99%.

A máscara que garante sua proteção e segurança.

Registro ANVISA 80478410002



Embalagem individual com todos dados técnicos do produto e da empresa e toda instruções de uso. (NR 6 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI)



ANVISA

Peça com identificação na máscara




# Linha Destilador Prime - Dentemed



## Diferenciais e Benefícios

- Eficiente: purifica a água, eliminando 99,9% das impurezas;
- Prático: oferece praticidade, sem a necessidade de instalação hidráulica;
- Compacto: design moderno cromado e compacto, de fácil manuseio;
- Automático: sensor de desligamento automático quando acabar a água da câmara;
- Produção: 1000 ml/h, tempo reduzido que oferece vantagem ao profissional;
- Filtro: de carvão ativado que elimina odor e sabor;
- Motor: baixo nível de ruído;
- Coleta: acompanha garrafa para coleta da água.

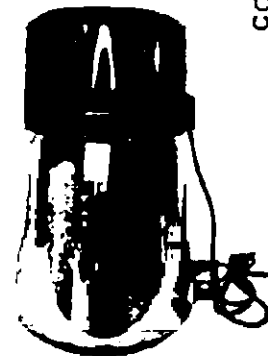

As principais diferenças entre a água destilada, bidestilada e a deionizada residem em seus processos. O grau de pureza do líquido também está envolvido na diferença dessas duas categorias de líquidos: a água destilada é considerada a água mais pura que se pode obter.

A deionização (ou desmineralização) é, na verdade, um processo de remoção de íons (cátions/ânions) através de um sistema de resinas trocadoras de íons. Ela pode ser parcial ou total de acordo com os métodos de eliminação escolhidos e o grau de remoção necessário. Quando apenas os íons forem retidos nas resinas, a água deionizada ou desmineralizada obtida retém suas substâncias orgânicas e inorgânicas sem carga elétrica. Portanto, o líquido não é puro. Nesta forma, a água é utilizada nas indústrias como água de processo. Mas a água para fins médicos precisa passar por um filtro biológico para purificá-la completamente e torná-la estéril.

Já a água destilada não contém elementos orgânicos. A parte inorgânica fica no resíduo da destilação. Assim, a água destilada quase sempre é pura. Seu pH é da ordem de 7, mas, se exposta ao ar, tende a ficar um pouco ácida devido ao CO<sub>2</sub> dissolvido (pH em torno de 5.5). O método de destilação não é complicado e o equipamento é denominado destilador. A água destilada é estéril enquanto estiver protegida do ar ambiente.

A água bidestilada, como o próprio nome já diz, é a água que passa pelo processo de destilação duas vezes. Uma vez que a água é destilada, separa-se dela uma boa parte dos sais minerais; no entanto, mesmo depois do processo de destilação comum, a água ainda não fica completamente livre da presença de sais. Para isso, é preciso que ela seja submetida a um novo processo, após o qual passa a ser chamada de bidestilada.

## Conservação

Use água comum (água potável fornecida pelo sistema de abastecimento urbano) ou filtrada;

Mantenha o destilador limpo. O recipiente de ebulição deve ser limpo depois de cada ciclo de destilação;

A limpeza externa deve ser realizada diariamente com pano macio e úmido;

É importante limpar as peças internas do destilador (resistência, filtro e bandeja de ebulição) regularmente. O uso contínuo do destilador resultará no acúmulo de resíduos minerais nessas áreas que podem fazer com que o destilador pare de funcionar ou funcione incorretamente se o aparelho não for limpo periodicamente;

Certifique-se que as entradas e saídas de ar na parte de cima e nos lados do destilador não estejam obstruídas durante o funcionamento.

## Contraindicações

A água destilada não deve ser consumida.

## Itens Inclusos

01 Destilador de Água Cromado - Dentemed;

01 Jarro;

01 Tampa do Jarro;

01 Protetor do bico do jarro;

01 Cabo de energia;

01 Manual de instrução de uso.

## Especificações Técnicas

Destilador de Água;

Potência: 750W;

Produção: 1000 ml/hora;


Capacidade máxima: 4 litros;

Temperatura: 160°C;

Voltagem: 110V ou 220V (escolher no momento da compra).

Dimensões do produto: 230 x 230 x 390 mm (C x L x A).

Dimensões do produto embalado: 285 x 260 x 470 mm (C x L x A).

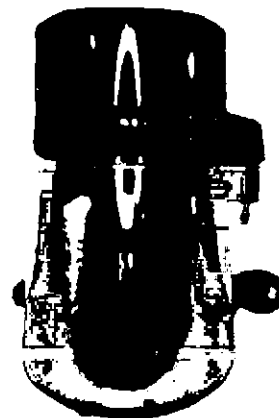

# LINHA PRIME DENTEMED RECOMENDAÇÕES BÁSICAS



A DENTEMED industrializa seus equipamentos dentro dos mais rigorosos padrões de qualidade, ergonomia e biossegurança e preparou essas recomendações básicas para auxiliar na tranquilidade e sucesso da instalação de sua clínica ou do seu consultório odontológico.

1-O primeiro item a se observar é o PONTO da instalação. De acordo com o posicionamento estratégico de acordo com o mercado que irá atender deve-se observar. Tamanho do imóvel, regularidade de licenciamento e sanitária, custo de aquisição/aluguel, facilidade de acesso, estacionamento, pontos de ônibus /metro próximos, localização geográfica;

2-O segundo item a se observar é o projeto arquitetônico. O projeto deve contemplar sala de espera, recepção, salas clínicas, sala de esterilização, espaço (preferencialmente externo e obrigatoriamente ventilado) para instalação dos compressores e da bomba a vácuo. O projeto deve incluir instalações elétricas, hidráulicas, pneumáticas, condicionamento de ar e de construção civil.

3-No projeto arquitetônico a DENTEMED disponibiliza uma Planta Baixa para definir todas as medidas que devem ser seguidas e observadas. É importante observar que a cadeira deve preferencialmente ter seus pés voltados para a janela (aproveitando a iluminação externa natural), sendo posicionada o mais próximo da parede à esquerda, aumentando a área de circulação (entrada e saída do paciente) e com as costas da cadeira para a porta de entrada preservando a privacidade do paciente no curso do tratamento odontológico

4-A qualidade do ar comprimido pode influenciar diretamente na segurança e no desempenho dos equipamentos, portanto os equipamentos DENTEMED obrigatoriamente devem trabalhar com compressores isentos de óleo, que devem ser drenados diariamente garantindo um ar puro e seco. A contaminação do ar por óleo pode prejudicar a saúde de pacientes que ficam expostos ao ambiente inapropriado. Além disso, de acordo com a Resolução Normativa RDC nº 50 de 21/02/2002, a utilização de compressores lubrificados a óleo é proibida.

5-A DENTEMED atende toda a linha de equipamentos nas tensões de alimentação 110/127 e 220 volts sendo recomendado se possível que as instalações elétricas para os compressores, bomba a vácuo e autoclaves sejam 220 volts para reduzir a corrente elétrica aplicada por fase assim como a seção (bitola) do cabeamento elétrico, diminuindo o consumo de energia e aumentando a vida útil dos equipamentos.

6-A instalação dos equipamentos deve ser sempre realizada por técnicos credenciados DENTEMED e após instalados devem ser ajustados/regulados na seguinte ordem:  
Regulagem da válvula reguladora de saída do compressor para 80 Psi, regulagem da válvula reguladora do equipo para 20 Psi (reservatório de água), regulagem da válvula pneumática da pressão da alta rotação 30/35 Psi, regulagem do spray da alta rotação;

7- Após cada trabalho, recomenda-se a remoção e esterilização das brocas/fresas e instrumentos rotativos para evitar contaminação cruzada;


8-A carga de Trabalho de Segurança (Carga máxima admissível sobre a cadeira, composto de peso do paciente mais acessórios) é 200 kg

9-Recomenda-se não submeter as partes plásticas do equipamento a contato com substâncias químicas, utilizadas nas rotinas do tratamento odontológico, tais como ácidos, mercúrio, líquidos acrílicos, amalgamas etc.

10-Refletor LED DENTEMED tem ajuste de intensidade de luz por sensor ou através do interruptor localizado na traseira do equipamento. Este ajuste de intensidade pode ser utilizado para ajustes compatíveis com materiais restauradores ativados por Luz conforme especificações técnicas destes materiais restauradores.

11-Os materiais aplicáveis dos equipamentos que entram em contato com o paciente são biocompatíveis com o organismo humano.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
203  
Fili  
Revisão

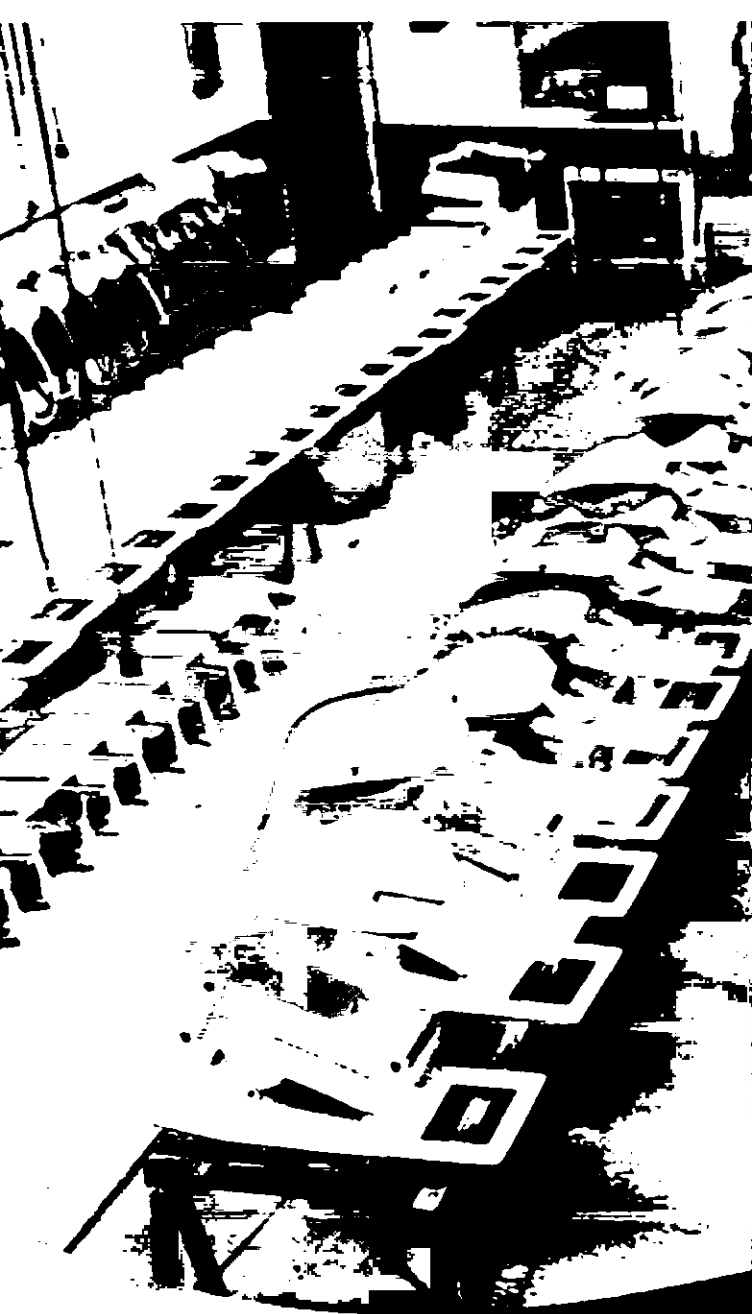




Autorizado Dentemed



Todos os produtos possuem certificados do Inmetro e número de registro na Anvisa tendo as suas especificações técnica no SGQ ( sistema de gestão da qualidade), dentro do departamento de engenharia no controle da informação documentada

    
@dentemedbrasil

 Rua Antonio Gravata, 136, A, Betânia  
Belo Horizonte/MG - CEP 30570-040

 [www.dentemed.com.br](http://www.dentemed.com.br)  (31) 2527-8294  (31) 99822-4806





# ABO RECOMENDA SELO DE QUALIDADE

CERTIFICADO DE CONCESSÃO


DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

A Associação Brasileira de Odontologia concede à Dentemed Equipamentos Odontológicos LTDA CNPJ: 07.897.039/0001-00, Rua Antônio Gravatá, 136-A - Cinquentenário - CEP: 30570-040 - Belo Horizonte - MG, licença de uso do SELO RECOMENDA segundo os requisitos estabelecidos no regulamento do Programa da Qualidade da ABO, para o seguinte produto:

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DENTEMED

Harrison de Almeida

Departamento de Avaliação  
Produtos Consumíveis - Associados - Médicos e Odontológicos.  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA

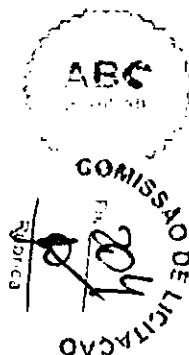

DATA: OUT/2022

VAL: OUT/2024



# DIFERENCIAIS APROVADOS

## SELO DE QUALIDADE

### DIFERENCIAIS APROVADOS

- 1- Design moderno e funcional;
- 2- Equipamento seguro, de fácil manuseio e operação, com versatilidade de modelos;
- 3 Motor de tecnologia alemã.
- 4 Sistema full range de 90V/260V;
- 5- Disponível em tecido náutico - resistente a qualquer intempérie;
- 6- Fonte de alimentação chaveada Plug & Play - Blindagem eletrostática e compatibilidade eletromagnética certificada;
- 7- Posições de trabalho programadas e programáveis;
- 8- Peças metálicas em aço resistente a esforços com tratamento de superfície e pintura eletrostática;



*Paulo Roberto de Souza*

Presidente ABO Nacional



## LAUDO TÉCNICO SELO ABO RECOMENDA

**Empresa:** Dentemed Equipamentos Odontológicos LTDA  
**CNPJ:** 07 897.039/0001-00

**Motivo:** Concessão - SELO ABO RECOMENDA

**Produto:** Consultório Odontológico Dentemed

Atesto que as avaliações em epigrafe foram julgadas por três comissões: Técnica; Comercial e Administrativo, *in loco*. As análises foram realizadas com o Projeto Executivo da ABO Nacional, que faculta o mérito do SELO ABO RECOMENDA a empresas dos setores de: Médicos - Odontológicos - Fármacos - Consumíveis - Comestíveis (Zero Açúcares) & Associados, em consonância com as normas do setor, especificações técnicas, recomendações de mercado e de profissionais, questionário dos diferenciais do objeto em questão, condições técnicas, material de embalagem e *merchandising*, manual do produto, *status* de aprovação pela ANVISA, informações técnicas divulgadas no Diário Oficial, regulamentação de órgãos, cronograma interno de julgamento e outros parâmetros (se houver) para compor a RATIFICAÇÃO e CHANCELA a que a entidade se propõe.

A Associação Brasileira de Odontologia (ABO NACIONAL) constituiu uma comissão denominada DAPO (Departamento de Avaliação de Produtos Consumíveis - Associados - Médicos e Odontológicos) e validou, por meio do documento Laudo Técnico e Administrativo, sendo parte do processo de recomendação dirigida pela entidade e também pelo Certificado de Recomenda, que as avaliações do citado Produto / Equipamentos encontram-se:

**100 % CONCLUÍDAS e APROVADAS.**

São Paulo, 27 de outubro 2022



Comissão - DAPO

DAPO (Departamento de Avaliação de Produtos Consumíveis - Associados - Médicos e Odontológicos)



# ABO RECOMENDA SELO DE QUALIDADE

CERTIFICADO DE CONCESSÃO

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

A Associação Brasileira de Odontologia concede à Dentemed Equipamentos Odontológicos LTDA CNPJ: 07.897.039/0001-00, Rua Antônio Gravatá, 136-A - Cinquentenário CEP: 30570-040 Belo Horizonte MG, licença de uso do SELO RECOMENDA segundo os requisitos estabelecidos no regulamento do Programa da Qualidade da ABO, para o seguinte produto.


KIT PEÇAS DE MÃO DENTEMED  
(ALTA ROTAÇÃO - CONTRA ÂNGULO - PEÇA RETA E MICROMOTOR)

Harrison de Almeida

Departamento de Avaliação  
Produtos Consumíveis - Associados - Médicos e Odontológicos.  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA

DATA: OUT/2022

VAL: OUT/2024



# DIFERENCIAIS APROVADOS

## SELO DE QUALIDADE

### DIFERENCIAIS APROVADOS

- 1- Sistema de balanceamento computadorizado da turbina e rolamentos, garantindo alta confiabilidade para uso das brocas;
- 2- Peças leves, ergonômicas a anatómicas. Proporcionando conforto e segurança para o paciente, e melhor usabilidade do dentista;
- 3- Totalmente autoclaváveis;
- 4 Sistema de troca de broca por Push Button, proporcionando rapidez, velocidade e qualidade na troca/- substituição das brocas;



Presidente ABO Nacional



## LAUDO TÉCNICO SELO ABO RECOMENDA

**Empresa:** Dentemed Equipamentos Odontológicos LTDA  
**CNPJ:** 07.897 039/0001-00

**Motivo:** Concessão - SELO ABO RECOMENDA

**Produto:** Kit Peças de Mão Dentemed (Alta Rotação – Contra Ângulo – Peça Reta e Micromotor)

Atesto que as avaliações em epígrafe foram julgadas por três comissões. Técnica, Comercial e Administrativo, *in loco*. As análises foram realizadas com o Projeto Executivo da ABO Nacional, que faculta o mérito do SELO ABO RECOMENDA a empresas dos setores de. Médicos - Odontológicos - Fármacos - Consumíveis - Comestíveis (Zero Açúcares) & Associados, em consonância com as normas do setor, especificações técnicas, recomendações de mercado e de profissionais, questionário dos diferenciais do objeto em questão, condições técnicas, material de embalagem e *merchandising*, manual do produto, *status* de aprovação pela ANVISA, informações técnicas divulgadas no Diário Oficial, regulamentação de órgãos, cronograma interno de julgamento e outros parâmetros (se houver) para compor a RATIFICAÇÃO e CHANCELA a que a entidade se propõe.

A Associação Brasileira de Odontologia (ABO NACIONAL) constituiu uma comissão denominada DAPO (Departamento de Avaliação de Produtos Consumíveis - Associados - Médicos e Odontológicos) e validou, por meio do documento Laudo Técnico e Administrativo, sendo parte do processo de recomendação dirigida pela entidade e também pelo Certificado de Recomenda, que as avaliações do citado Produto / Equipamentos encontram-se.

**100 % CONCLUÍDAS e APROVADAS.**

São Paulo, 27 de outubro 2022.



Comissão - DAPO

DAPO (Departamento de Avaliação de Produtos Consumíveis - Associados - Médicos e Odontológicos)





A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM  
À CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTIM  
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 1616.01/2023 - 0003/PE  
DIA E HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08 DE NOVEMBRO DE 2023 às 09h30 horas  
DIA E HORÁRIO DA SESSÃO DE DEPUTA DE LANCES: 08 DE NOVEMBRO DE 2023 às 11h30 horas

AL Sr.(a) Pregoeiro (a)  
Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta de Escrita, relativa ao objeto do referido prego, bem como as informações especificações e as condições abaixo descritas

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE.

P-1

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	V. UNITÁRIO	EXTENSÃO DESCRITIVA	V. TOTAL	EXTENSÃO TOTAL
1	Mesa de Exames Característica Física ESTRUTURA   MATERIAL DE CONFECÇÃO (Especificação COM ARMÁRIO   MADEIRA OU MDF	UND	1	SANTA CLARA	R\$ 3.717,50	três mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 3.717,50	três mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$ 3.717,50	
três mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos								

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação que nossa Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do Edital, supracitado e seus anexos.

Declaramos que objeto cotado atende todas as exigências do edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Outrossem declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços da proposta inicial, digital ou anexa, ou ofertados por meio de lances, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos, sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive margem de lucro.

Caso nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

a) Validade da proposta: 60 (SESENTA) dias, contados da sessão de abertura das propostas;

b) Prazo de entrega: 20(VINTE) dias úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Compra.

08 de Novembro de 2023.

Handwritten marks and signature at the bottom of the page.



AO(A) PREGOEIRO (A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM, ESTADO DO CEARÁ

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1610.01/2023-SMS/PE

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM.

P-4

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1	Mesa de Exames Característica Física ESTRUTURA 1 MATERIAL DE CONFECCÃO Especificação COM ARMÁRIO 1 MADEIRA OU MDF	1	TUBOMED	RS 3.209,00	três mil, duzentos e nove reais	RS 3.209,00	três mil, duzentos e nove reais
VALOR TOTAL DO ITEM						RS 3.209,00	três mil, duzentos e nove reais

PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS, CONFORME ESTABELECIDO EM EDITAL E CONTRATO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

DECLARAMOS QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA DESTA EDITAL.

DECLARAMOS QUE OS PREÇOS CONTIDOS NA PROPOSTA INICIAL APRESENTADA E NAQUELES QUE, PORVENTURA, VIEREM A SER OFERTADOS POR MEIO DE LANCES ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO: VANTAGENS, ABATIMENTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, FISCAIS E COMERCIAIS, QUE EVENTUALMENTE INCIDAM SOBRE A OPERAÇÃO OU, AINDA, DESPESAS COM TRANSPORTE OU TERCEIROS, QUE CORRERÃO POR CONTA DA VENCEDORA.

DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE AS TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

OS PREÇOS JÁ ESTÃO INCLUSOS AS REMUNERAÇÕES, OS ENCARGOS SOCIAIS, TRIBUTÁRIOS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A CONTRATAÇÃO LICITADA, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO, NÃO CABENDO NENHUM OUTRO ÔNUS QUE NÃO O VALOR ESTIPULADO NA REFERIDA CARTA PROPOSTA.

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE PARTICIPAÇÃO NESTA LICITAÇÃO, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS, E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTES A HABILITAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA SÃO AUTÊNTICOS.

DECLARAMOS PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DA PRESENTE LICITAÇÃO, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

I) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE POR NÓS E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

II) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

III) QUE NÃO TENTAMOS, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

IV) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

V) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO ÓRGÃO LICITANTE ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

VI) QUE ESTAMOS PLENAMENTE CIENTES DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMA-LÁ.

08 DE NOVEMBRO DE 2023

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Fls. 212  
Pública

# TUBOMED

MÓVEIS HOSPITALARES

## CATÁLOGO

de Produtos





# **TUBOMED**

**MÓVEIS HOSPITALARES**

Na busca constante por inovação e aperfeiçoamento, a  
**TUBOMED MÓVEIS HOSPITALARES**  
visa proporcionar bem estar aos seus clientes,  
agregando; **QUALIDADE, CONFORTO e PRATICIDADE** aos  
ambientes Clínicos e Domiciliares, que utilizam  
móveis médico-hospitalares.



# ÍNDICE

ARMÁRIOS

BERÇOS

CAMAS

CARROS

CADEIRAS & POLTRONAS

MESAS & MACAS

DIVERSOS

OPÇÕES DE CORES DO COURVIN  
PARA MÓVEIS COM ESTOFADO



**TOQUE**

NA SEÇÃO QUE DESEJA VISUALIZAR

COMISSAO DE LICITACAO  
Nº 2134  
RUBRICA

# ARMÁRIOS

**TUBOMED**  
MODEIS HOSPITALARES



## ARMÁRIO VITRINE COM 1 PORTA

REF: TM 100

- Estrutura em chapa de aço;
- Porta e prateleiras em vidro 3mm;
- Fechadura tipo Yale cromada;
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;

### DIMENSÕES:

1,45 X 0,50 X 0,35 m

### - OPCIONAIS:

- Laterais em vidros.
- Variação nas dimensões.
- Variação na espessura de chapas e vidros.
- Quantidade de prateleiras.

ANVISA: Não é considerado produto para saúde

## ARMÁRIO VITRINE COM 2 PORTAS

REF: TM 101

- Estrutura em chapa de aço;
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Portas e prateleiras em vidro 3mm;
- Fechadura tipo Yale cromada;


### DIMENSÕES:

1,45 X 0,85 X 0,40 m

### - OPCIONAIS:

- Laterais em vidro.
- Variação nas dimensões.
- Variação na espessura das chapas e vidros.
- Quantidade de prateleiras.


ANVISA: Não é considerado produto para saúde

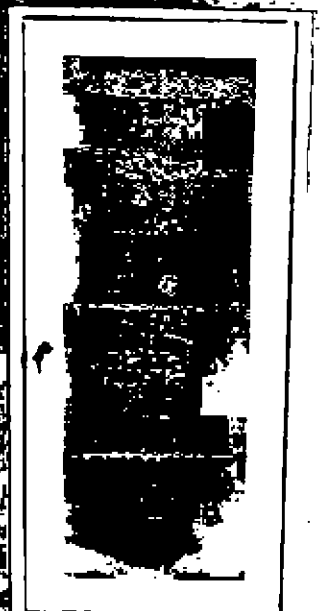

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
R. 2140.

# CAMAS

**TUBOMED**  
MÓVEIS HOSPITALARES

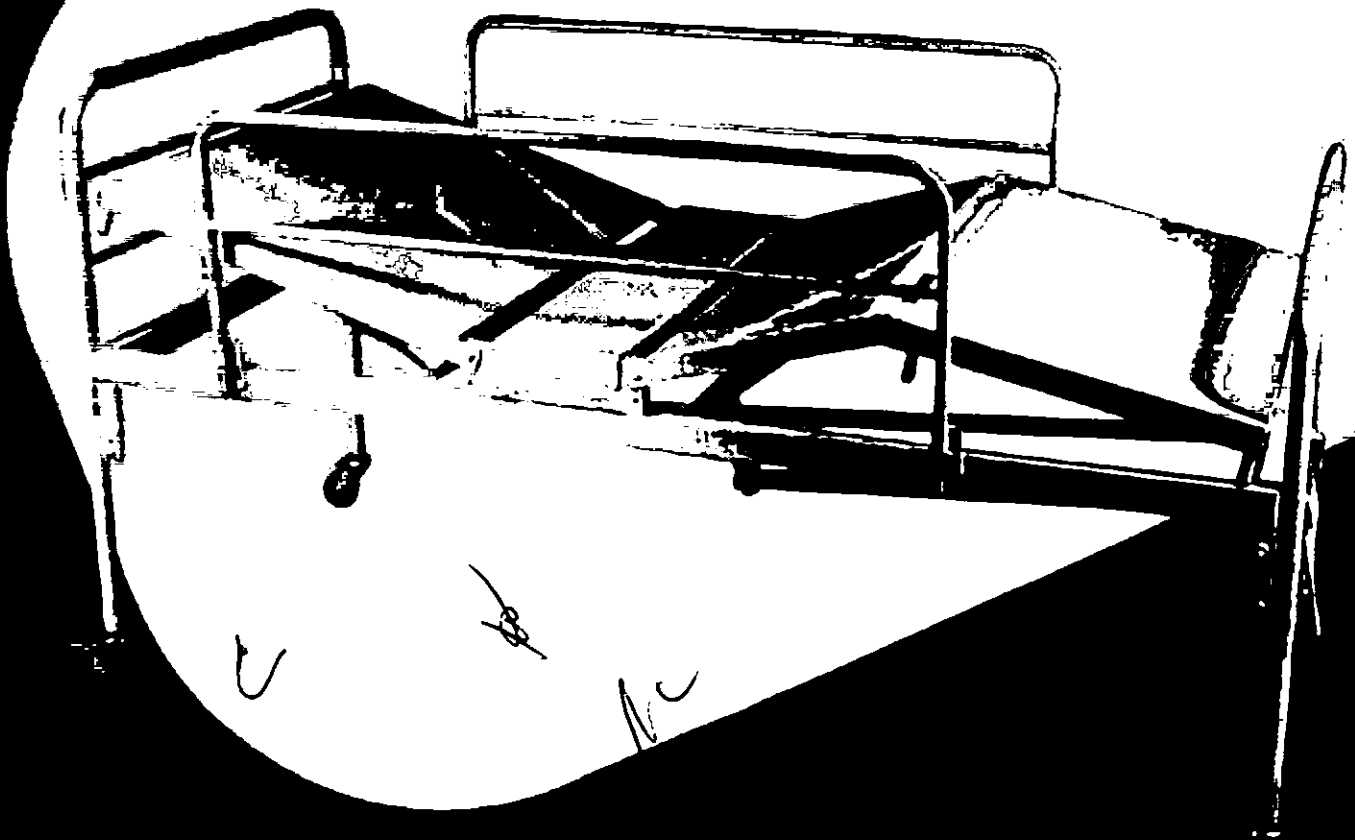


# CAMAS HOSPITALARES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
215  
Fis  
Fabrica

## CAMA HOSPITALAR COM CABECEIRA MÓVEL

REF: TM 300

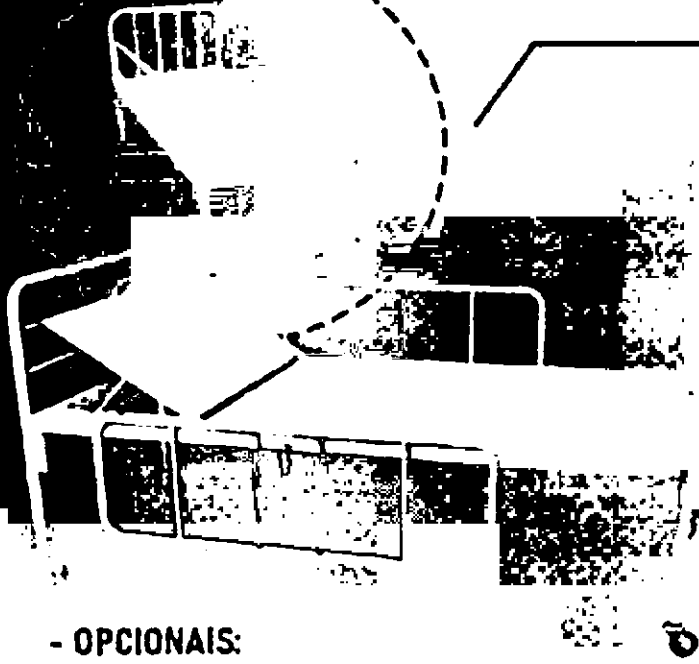

- Construída em tubos e chapas de aço carbono esmaltado;
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Cabeceira e pesseira desmontáveis;
- Cabeceira regulável através de cremalheira;
- Grades laterais reguláveis;
- Pés com rodízios com freios em diagonal;
- Capacidade de peso: 150kg;

### DIMENSÕES:

1,90 X 0,90 X 0,65m

ANVISA N° DE CADASTRO (RUC:RW64002)


### - OPCIONAIS:

- Suporte para soro.
- Pés com ponteiros plásticos.
- Variação nas dimensões.
- Variação do diâmetro dos rodízios.
- Variações nas espessuras e diâmetros de chapas e tubos.

- Leito inoxidável.
- Leito totalmente fixo.
- Leito perfurado.
- Modelos de grades.
- Capacidade de peso.
- Cabeceira e pesseira com acabamento em MDF.

## CAMA FAWLER COM 2 MANIVELAS

REF: TM 301

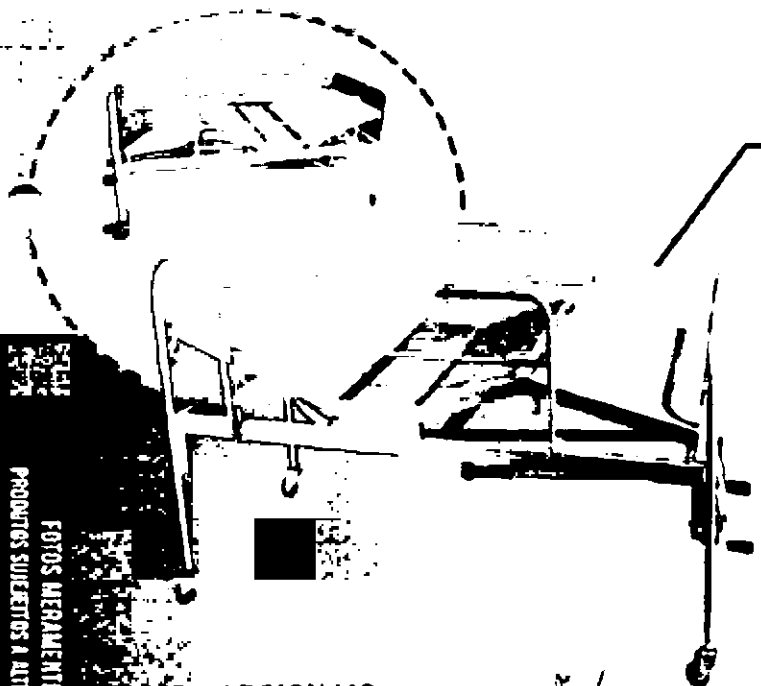

- Construída em tubos e chapas de aço carbono;
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Cabeceira e pesseira desmontáveis;
- Movimentos: dorso, fowler, flexão de joelhos vascular;
- Grades laterais de tombar;
- Pés com rodízios com freios em diagonal;
- Capacidade de peso: 120kg;

### DIMENSÕES:

1,90 X 0,90 X 0,65m

ANVISA. N° DE CADASTRO (RUC:RW64001)

### - OPCIONAIS:

- Capacidade de peso.
- Modelos de grades.
- Leito inoxidável.
- Leito perfurado.
- Suporte para soro.

- Cabeceira e pesseira com acabamentos em MDF.
- Pés com ponteiros plásticos.
- Variação nas dimensões.
- Variação do diâmetro dos rodízios.
- Variações nas espessuras e diâmetros das chapas e tubos.



## CAMA FAWLER COM 2 MANIVELAS GRADES EM POLIETILENO

REF: TM 302

- Construída em tubos e chapas de aço carbono;
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Cabeceira e pesseira removíveis em material termoplástico injetado;
- Movimentos: dorso, fawler, flexão de joelhos, vascular;
- Grades laterais em material termoplástico injetado. Dois pares de grades laterais, sendo um par no dorso e um par nas pernas, de atuação independente;
- Pés com rodízios com freios em diagonal;
- Capacidade de peso: 120kg;

### DIMENSÕES:

1,90 X 0,90 X 0,65 m

ANVISA: Nº DE CADASTRO (80589440001)

- Suporte para soro.
- Pés com pontelas plásticas.
- Variação nas dimensões.
- Variação do diâmetro dos rodízios.
- Variações nas espessuras e diâmetros das chapas e tubos.

### OPCIONAIS:

- Capacidade de peso.
- Cabeceira e pesseira com acabamentos em MDF.
- Leito inoxidável.
- Leito perfurado.
- Grades em aço carbono ou em aço inoxidável.

## CAMA FAWLER INFANTIL COM 2 MANIVELAS

REF: TM 303

- Construída em tubos e chapas de aço carbono;
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Cabeceira e pesseira em tubos de aço carbono;
- Movimentos: dorso, fawler, flexão de joelhos, vascular;
- Grades laterais reguláveis em aço carbono;
- Pés com rodízios com freios em diagonal;
- Capacidade de peso: 90kg;

### DIMENSÕES :

1,50 X 0,60 X 0,60 m

ANVISA: Nº DE CADASTRO (80589440001)

- Suporte para soro.
- Pés com pontelas plásticas.
- Variação nas dimensões.
- Variação do diâmetro dos rodízios.
- Variações nas espessuras e diâmetros das chapas e tubos.

### OPCIONAIS:

- Capacidade de peso.
- Grades em aço inoxidável.
- Leito inoxidável.
- Leito perfurado.
- Suporte para soro.
- Cabeceira e pesseira em aço inoxidável, material termoplástico injetado, acabamentos em MDF.



## CAMA FAWLER COM 3 MANIVELAS ELEVAÇÃO DE ALTURA

REF: TM 304

- Construída em tubos e chapas de aço carbono;
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Cabeceira e peseira removíveis em material termoplástico injetado;
- Movimentos: dorso, fawler, flexão de joelhos, vascular, elevação do leito;
- Grades laterais em aço inoxidável;
- Para-choques nos quatro cantos da cama para proteção de parede;
- Pés com rodízios com freios em diagonal;
- Capacidade de peso: 130kg;

### DIMENSÕES:

1,90 X 0,90 X 0,65m

### ALTURA:

0,50m ( Mínima ) - 0,75m ( Máxima )

ANVISA N.º DE CADASTRO (BOSBYVIG 01)

- Leito inoxidável.
- Leito perfurado.
- Suporte para soro.
- Pés com ponteiros plásticos.
- Variação nas dimensões.
- Variação do diâmetro dos rodízios.
- Variações nas espessuras e diâmetros das chapas e tubos.

### - OPCIONAIS:

- Capacidade de peso.
- Grades em aço carbono
- Grades em material termoplástico injetado.
- Grades em toda extensão do leito.
- Cabeceira e peseira tubulares com acabamentos em MDF.

## CAMA FAWLER COM 2 MANIVELAS LEITO EM AÇO INOXIDÁVEL

REF: TM 305

- Construída em tubos de aço carbono, leito em aço inoxidável;
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Cabeceira e peseira removíveis com acabamentos em MDF;
- Movimentos: dorso, fawler, flexão de joelhos, vascular;
- Grades laterais de tombar em aço inoxidável;
- Pés com rodízios com freios em diagonal;
- Capacidade de peso: 120kg;

### DIMENSÕES :

1,90 X 0,90 X 0,65m

ANVISA: N.º DE CADASTRO (BOSBYVIG 01)

- Variação do diâmetro dos rodízios.
- Variações nas espessuras e diâmetros das chapas.
- Cabeceira e peseira em aço carbono, aço inoxidável, material termoplástico injetado.

### - OPCIONAIS:

- Capacidade de peso.
- Modelos de grades.
- Leito em aço carbono.
- Leito Perfurado.
- Suporte para soro.
- Pés com ponteiros plásticos.
- Variação nas dimensões.



## CAMA HOSPITALAR PPP PRÉ-PARTO, PARTO, PÓS-PARTO

REF: TM 306

- Construída em tubos e chapas de aço carbono;
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Movimentos: elevação dorsal através de cremalheira;
- Grades em material termoplástico injetado;
- Cabeceira e peseira removíveis em material termoplástico injetado;
- Apoios de pernas removíveis.
- Porta coxas em material termoplástico injetado;
- Barra de esforço em aço inox;
- Apoios de calcanhares estofados;
- Suporte para soro;
- Coletor de líquidos em aço inoxidável;
- Colchão tripartido com revestimento em couro impermeável;
- Pés com rodízios com freios em diagonal;

### DIMENSÕES:

1,90X 0,80 X 0,60m

### OPCIONAIS:

- Variação de altura.
- Capacidade de peso.
- Lado mobilizar!
- Variação nas dimensões.
- Variação do diâmetro dos rodízios.
- Variação nas espessuras e diâmetros das chapas e tubos.

## OPCIONAIS DE CABECEIRAS E PESEIRAS



REF TM 920



**CABECEIRA - PESEIRA  
PARA CAMA HOSPITALAR  
COM ESPILHO EM MOB**  
Produzida em Aço Inoxidável  
C x L x A (mm) 820 x 41 x 700

REF TM 921




**CABECEIRA - PESEIRA  
PARA BERÇO HOSPITALAR**  
Produzida em PEAD  
(Polietileno de Alto Densidade)  
C x L x A (mm) 820 x 41 x 700

REF TM 922



**CABECEIRA - PESEIRA  
PARA CAMA HOSPITALAR**  
Produzida em PEAD  
(Polietileno de Alto Densidade)  
C x L x A (mm) 820 x 66 x 830

REF TM 923

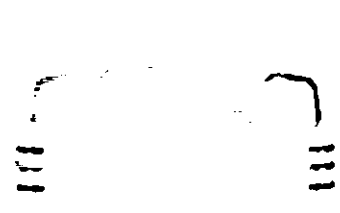

**CABECEIRA - PESEIRA PARA  
CAMA HOSPITALAR**  
Produzida em PEAD  
(Polietileno de Alto Densidade)  
C x L x A (mm) 820 x 422 x 41,0

REF TM 924

## OPCIONAIS DE GRADES PARA CAMAS




**GRADE PARA CAMA DE ABAIXAR**  
Produzida em PEAD  
(Polietileno de Alto Densidade)  
C x A x L (mm) 830 x 66 x 340

REF TM 930

**GRADE PARA CAMA DE ABAIXAR**  
Produzida em PEAD  
(Polietileno de Alto Densidade)  
C x A x L (mm) 830 x 66 x 340

REF TM 931

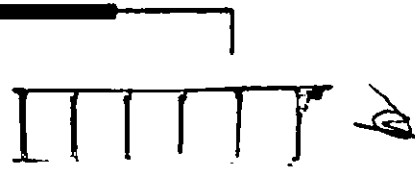

**GRADE PARA CAMA HOSPITALAR**  
Produzida em tubo de aço carbono  
ou Aço Inoxidável  
(c/ dispositivo e engate rápido)

REF TM 932



**GRADE PARA CAMA DE ABAIXAR**  
Produzida em aço carbono ou aço inoxidável  
(c/ travas e trava)

REF TM 933

**GRADE PARA CAMA HOSPITALAR**  
Produzida em Aço carbono


REF TM 934



COMISSÃO  
FINANÇAS  
RUBRICA


# MESAS E MACAS

**TUBOMED**  
MORE HOSPITALARE

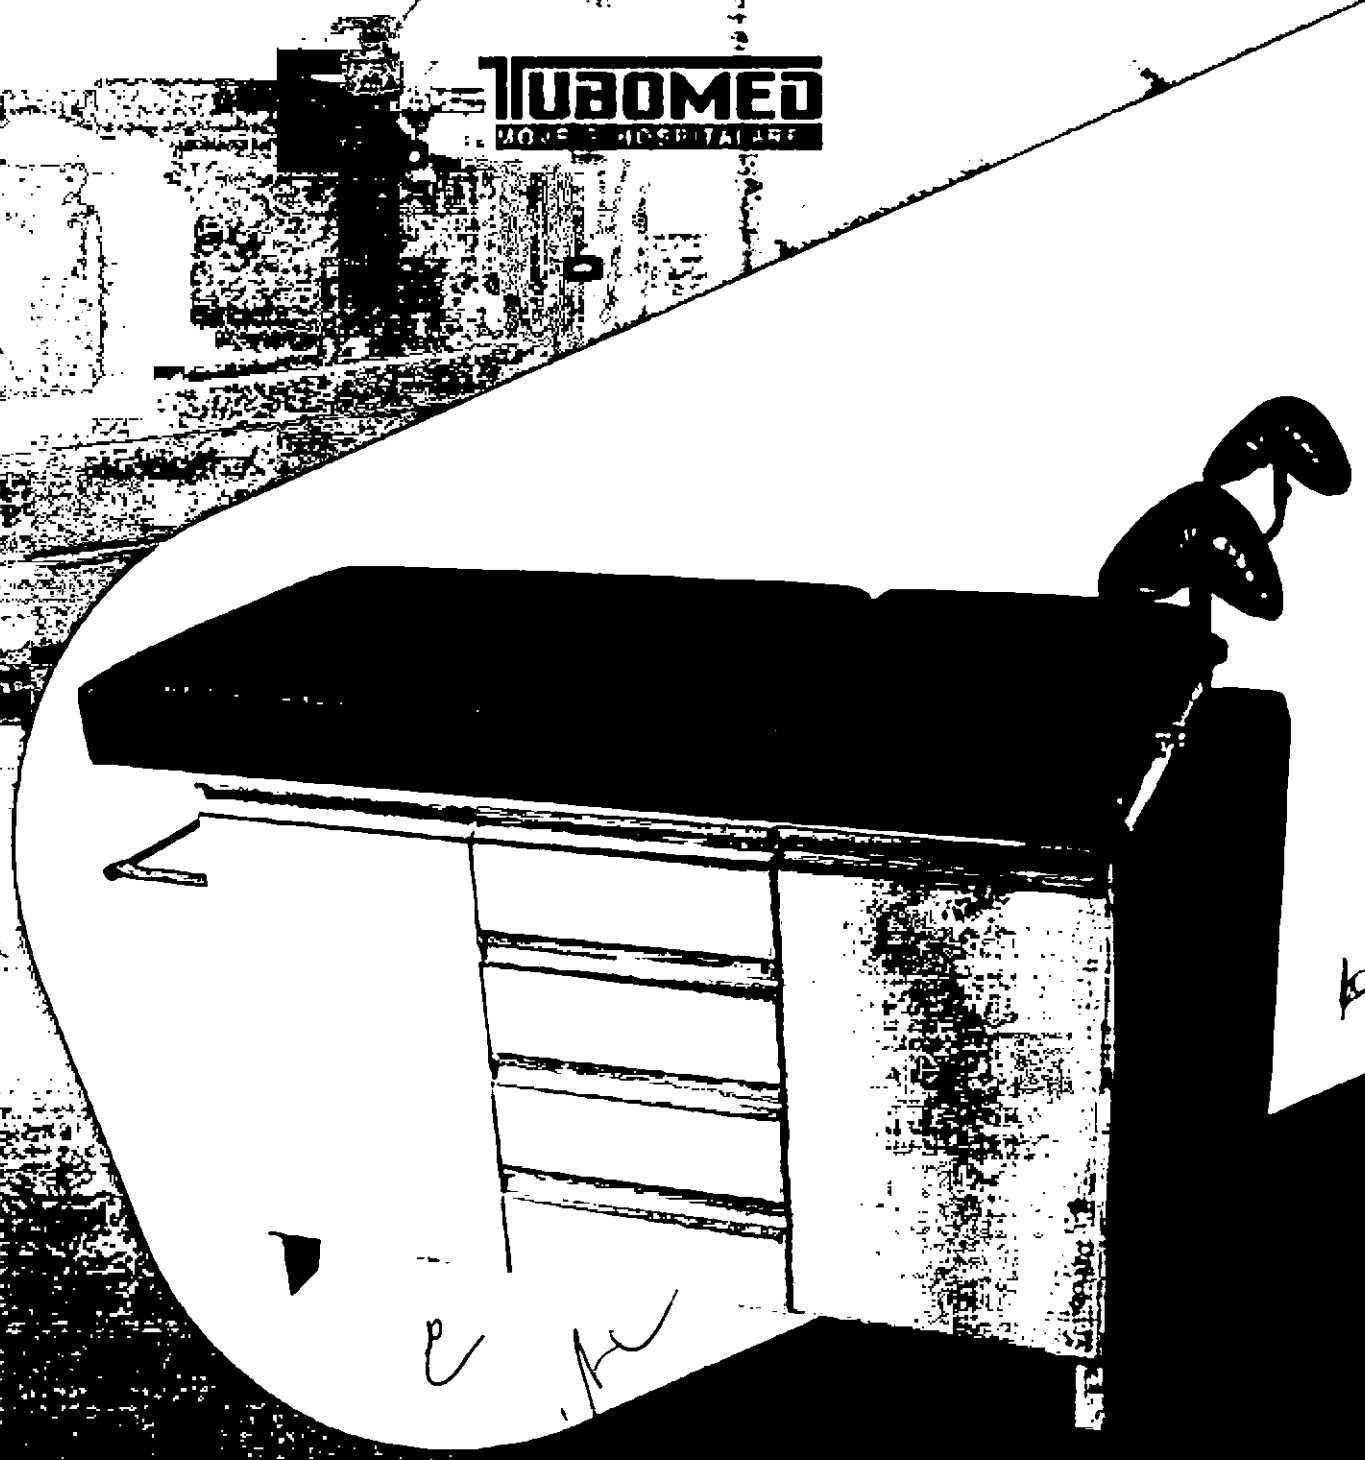

## MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO LUXO

REF: TM 700

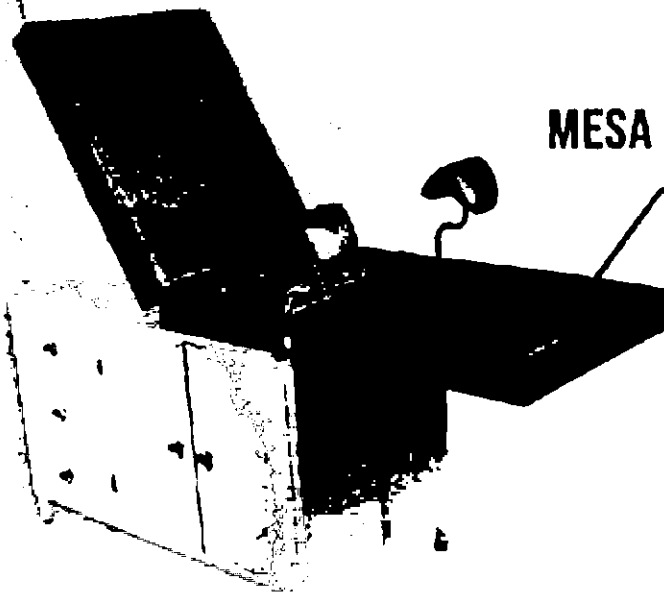

- Gabinete construído em tubos e chapas de aço carbono;
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Leito estofado revestido em courvin, dividido em 3 seções, 1 fixa e 2 com movimentos através de cremalheiras;
- Com 2 portas e 3 gavetas;
- Par de portas coxa em material termoplástico injetado, componentes inoxidáveis;
- Gaveta para escoamento de líquidos, inoxidável;
- Pés com pontelras plásticas;
- Capacidade de peso: 150kg;

### DIMENSÕES:

1,80 X 0,60 X 0,80m


ANVISA: Nº DE CADASTRO (80599249033)

### - OPCIONAIS:

- Rodízios
- Suporte para lençol descartável.
- Variações de cores do estofado.
- Construída em tubos e chapas de aço inoxidável.
- Gabinete em MDF.
- Quantidades de portas e gavetas.
- Capacidade de peso.
- Variação nas dimensões.
- Variação nas espessuras do estofado.
- Variações nas espessuras e diâmetros das chapas e tubos.

## MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO LUXO MDF

REF: TM 701

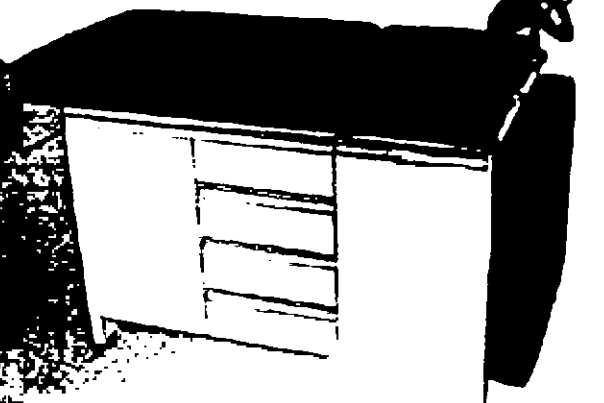

- Gabinete construído em MDF com revestimento BP (melamínico de baixa pressão);
- Leito estofado revestido em courvin, dividido em 3 seções, 1 fixa e 2 com movimentos através de cremalheiras;
- Com 2 portas e 4 gavetas;
- Par de porta coxas em material termoplástico injetado, componentes inoxidáveis;
- Gaveta para escoamento de líquidos, inoxidável;
- Pés com pontelras plásticas;
- Capacidade de peso: 150kg;

### DIMENSÕES :

1,80 X 0,60 X 0,80m

ANVISA: Nº DE CADASTRO (80599249033)

### - OPCIONAIS:

- Rodízios.
- Suporte para lençol descartável.
- Variação de cores do estofado.
- Quantidades de portas e gavetas.
- Capacidade de peso.
- Capacidade de peso.
- Variação nas dimensões.
- Variação nas espessuras do estofado.
- Variação nas espessuras MDF.





## MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO

REF: TM 702

- Construída em tubos de aço carbono;
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Leito estofado revestido em courvin, dividido em 3 seções, 1 fixa e 2 com movimentos através da cremalheira;
- Par de porta coxas em material termoplástico injetado, componentes em aço inoxidáveis;
- Gaveta para escoamento de líquidos, inoxidável;
- Pés com ponteiros plásticos;
- Capacidade de peso: 130kg;

### DIMENSÕES:

1,80 X 0,55 X 0,80m

ANVISA Nº DE CADASTRO (80589649001)

### - OPCIONAIS:

- Rodízios.
- Suporte para lençol descartável.
- Variação de cores do estofado.
- Construída em tubos de aço inoxidável
- Leito em chapa de aço carbono ou inoxidável.
- Variação nas dimensões
- Variação nas espessuras do estofado.
- Variações nas espessuras e diâmetros dos tubos.

## MESA PARA EXAMES CLÍNICOS LUXO

REF: TM 703

- Gabinete construído em tubos e chapas de aço carbono;
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Leito estofado revestido em courvin;
- Cabeceira regulável através de cremalheira;
- Com 2 portas e 3 gavetas;
- Pés com ponteiros plásticos;
- Capacidade de peso: 150kg;

### DIMENSÕES:

1,80 X 0,60 X 0,80 m

ANVISA: Nº DE CADASTRO (80589649001)

### - OPCIONAIS:

- Rodízios.
- Suporte para lençol descartável.
- Variação de cores do estofado.
- Construído em tubos e chapas de aço inoxidável.
- Quantidades de portas e gavetas.
- Capacidade de peso.
- Variação nas dimensões.
- Variação nas espessuras do estofado.
- Variações nas espessuras e diâmetros das chapas e tubos.

## MESA PARA EXAME CLÍNICO LUXO MDF

REF: TM 704



- Gabinete construído em MDF com revestimento BP (melamínico de baixa pressão);
- Leito estofado revestido em courvin;
- Cabeceira regulável através de cremalheira;
- Com 2 portas e 4 gavetas;
- Pés com ponteiros plásticos;
- Capacidade de peso: 150kg;

### DIMENSÕES:

1,80 X 0,60 X 0,80 m


ANVISA: Nº DE CADASTRO (B0569649001)

### - OPCIONAIS:

- Rodízios
- Suporte para lençol descartável.
- Variação de cores do estofado.
- Quantidades de portas e gavetas.
- Capacidade de peso.
- Variação nas dimensões.
- Variação nas espessuras do estofado.
- Variação nas espessuras MDF.

## MESA PARA EXAME CLÍNICO

REF: TM 705

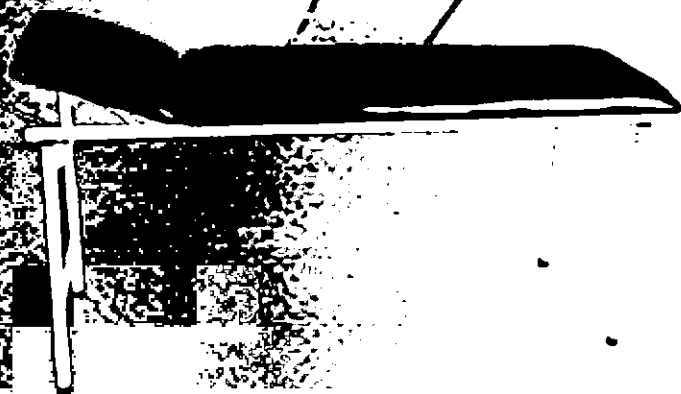

- Construído em tubos de aço carbono;
- Pintura eletroestática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Leito estofado revestido em courvin;
- Cabeceira regulável através de cremalheira;
- Pés com ponteiros plásticos;
- Capacidade de peso: 130kg;

### DIMENSÕES:

1,80 X 0,55 X 0,80 m

ANVISA: Nº DE CADASTRO (B0599649001)



### - OPCIONAIS:

- Rodízios.
- Capacidade de peso.
- Variação nas dimensões.
- Variação de cores do estofado.
- Construída em tubos de aço inoxidável.
- Suporte para lençol descartável.
- Leito em chapa de aço carbono ou inoxidável.



## DIVÃ MALA TRANSPORTÁVEL

REF: TM 706

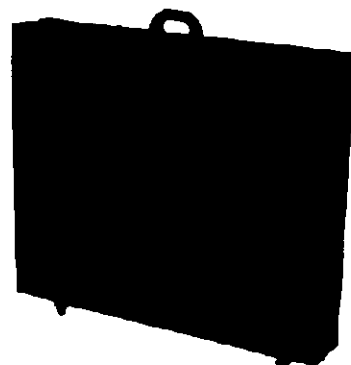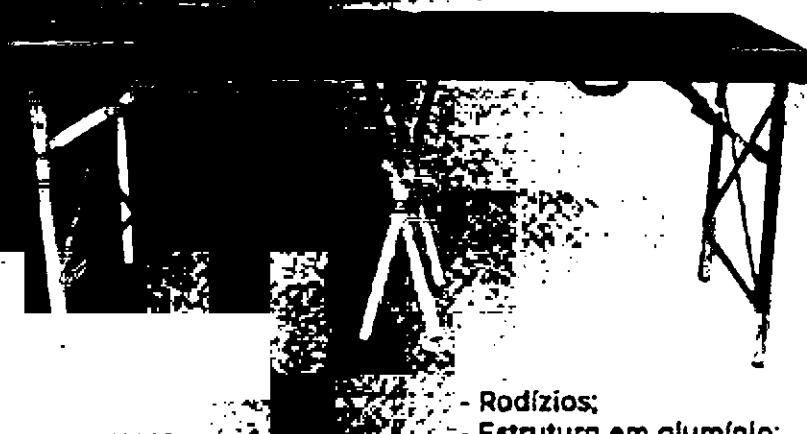

### - OPCIONAIS:

- Orifício.
- Variação de cores do estofado.
- Variação na espessura do estofado.

- Rodízios;
- Estrutura em alumínio;
- Pés com ponteiros plásticos;
- Alça para transporte;
- Leito estofado revestido em courovin sobre estrutura de madeira;


### DIMENSÕES:

1,80 X 0,60 X 0,80 m

ANVISA: A\* LE CADASTRO (BASEMANGGI);

## MESA CABECEIRA COM GAVETA E PORTA

REF: TM 707

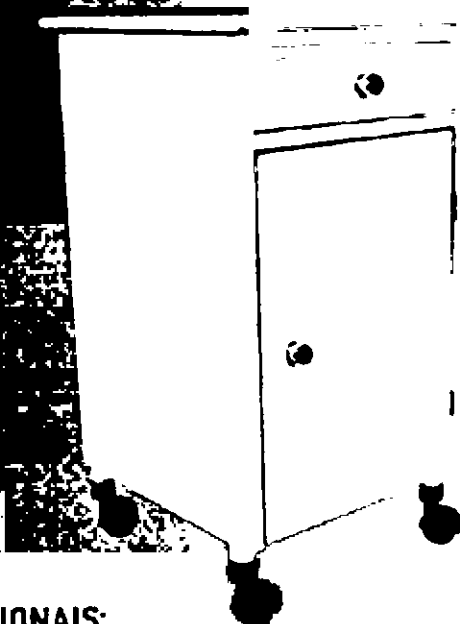

- Estrutura em tubos e chapa de aço carbono;
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Gaveta e porta com puxadores plásticos;
- Pés com rodízios;


### DIMENSÕES:

0,40 X 0,45 X 0,80 m

ANVISA: Não é considerado produto para saúde

### - OPCIONAIS:

- Fechadura.
- Pés com ponteiros plásticos.
- Construído totalmente em aço inoxidável.
- Variação nas dimensões.
- Variações nas espessuras e diâmetros das chapas e tubos.

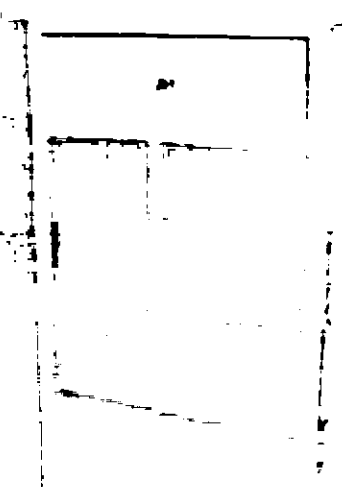

## MESA CABECEIRA COM GAVETA E PRATELEIRA

REF: TM 708

- Estrutura em tubos e chapa de aço carbono;
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Gaveta com puxador plástico;
- Pés com pontelras;


### DIMENSÕES:

0,40 X 0,45 X 0,80 m

ANVISA: Não é considerado produto para saúde

### - OPCIONAIS:

- Fechadura.
- Pés com rodízios.
- Construída totalmente em aço inoxidável.
- Variação nas dimensões.
- Variações nas espessuras e diâmetros das chapas e tubos.

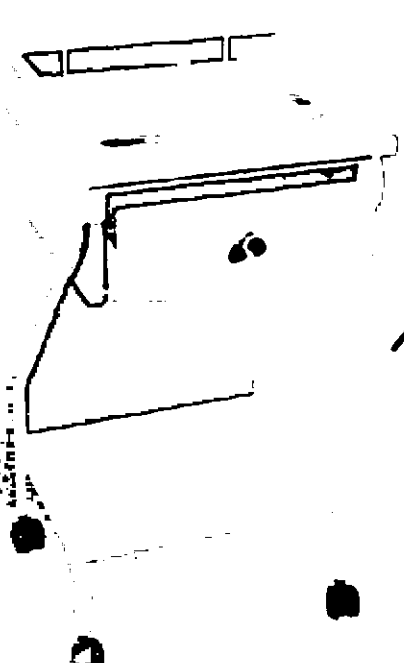

## MESA AUXILIAR EM Z

REF: TM 709

- Estrutura em tubos e chapa de aço carbono;
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Varanda em toda volta do tampo.
- Gaveta com puxador plástico;
- Pés com rodízios;

### DIMENSÕES:

0,40 X 0,45 X 0,80 m

ANVISA: Não é considerado produto para saúde

### - OPCIONAIS:

- Fechadura.
- Pés com pontelras plásticas.
- Construída totalmente em aço inoxidável.
- Variação nas dimensões.
- Variações nas espessuras e diâmetros das chapas e tubos.

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS  
PRODUTOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM PRECISO ANVISA



## MESA DE MAYO

REF: TM 710

- Estrutura em tubos de carbono;
- Pintura eletroestática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Bandeja em aço inoxidável;
- Pés providos com rodízios;

ALTURA AJUSTÁVEL: 0,90 até 1,30m

DIMENSÕES DA BANDEJA: 0,47 X 0,33m

### - OPCIONAIS:

- Construído totalmente em aço inoxidável.
- Variação nas dimensões.
- Variação no diâmetro do rodízios.
- Variações nas espessuras e diâmetros dos tubos.

ANVISA: não é considerado produto para saúde.

## MESA PARA REFEIÇÃO NO LEITO

REF: TM 711

- Estrutura em tubos de aço carbono;
- Pintura eletroestática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Tampo em MDF com revestimento BP (melamínico de baixa pressão);
- Pés com rodízios;

ALTURA AJUSTÁVEL: 0,90 até 1,30m

DIMENSÕES DO TAMPO: 0,35 X 0,50m

### - OPCIONAIS:

- Construído totalmente em aço inoxidável.
- Variação nas dimensões.
- Variação no diâmetro dos rodízios.
- Variações nas espessuras e diâmetros dos tubos.

ANVISA: não é considerado produto para saúde.



## MESA AUXILIAR COM TAMPO E PRATELEIRA

REF: TM 711

- Estrutura em tubos e chapa de aço carbono;
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Pés com rodízios;

**DIMENSÕES :**  
0,40 X 0,40 X 0,80 m

**ANVISA:** Não é considerado produto para saúde.

### - OPCIONAIS:

- Quantidades de prateleiras.
- Pés com ponteiros plásticos;
- Construída totalmente em aço inoxidável;
- Variação no diâmetro dos rodízios;
- Variação nas dimensões;
- Variações nas espessuras e diâmetros das chapas e tubos.

## MESA SEMI-CIRCULAR

REF: TM 713

- Estrutura em tubos de aço inoxidável;
- Tampo e prateleira em chapa de aço inoxidável;
- Pés com rodízios com freios em diagonal;

**DIMENSÕES:**  
1,25 X 0,35 X 0,80m

**ANVISA:** Não é considerado produto para saúde.


### - OPCIONAIS:

- Variação no diâmetro dos rodízios.
- Variação nas dimensões.
- Variações nas espessuras e diâmetros das chapas e tubos.



## MACA PARA TRANSPORTE DE CADÁVER

REF: TM 714

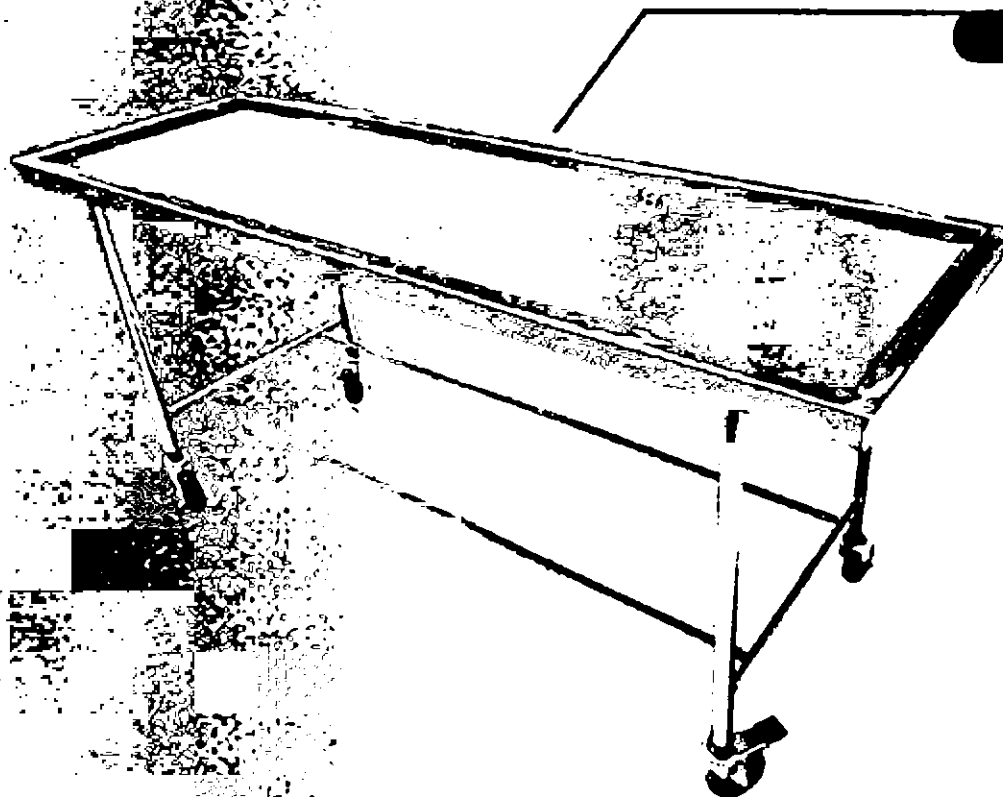

### - OPCIONAIS:

- Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem.
- Variação no diâmetro dos rodízios.
- Variação nas dimensões.
- Variações nas espessuras e diâmetros das chapas e tubos.

- Estrutura em tubos de aço inoxidável;
- Leito em aço inoxidável;
- Pés com rodízios com frelos em diagonal;


### DIMENSÕES :

1,90 X 0,80 X 0,80m


AN VISA. Nº DE CADASTRO: (REGISTRADOS)

# CARRROS

**TUBOMED**  
HOSPITALES

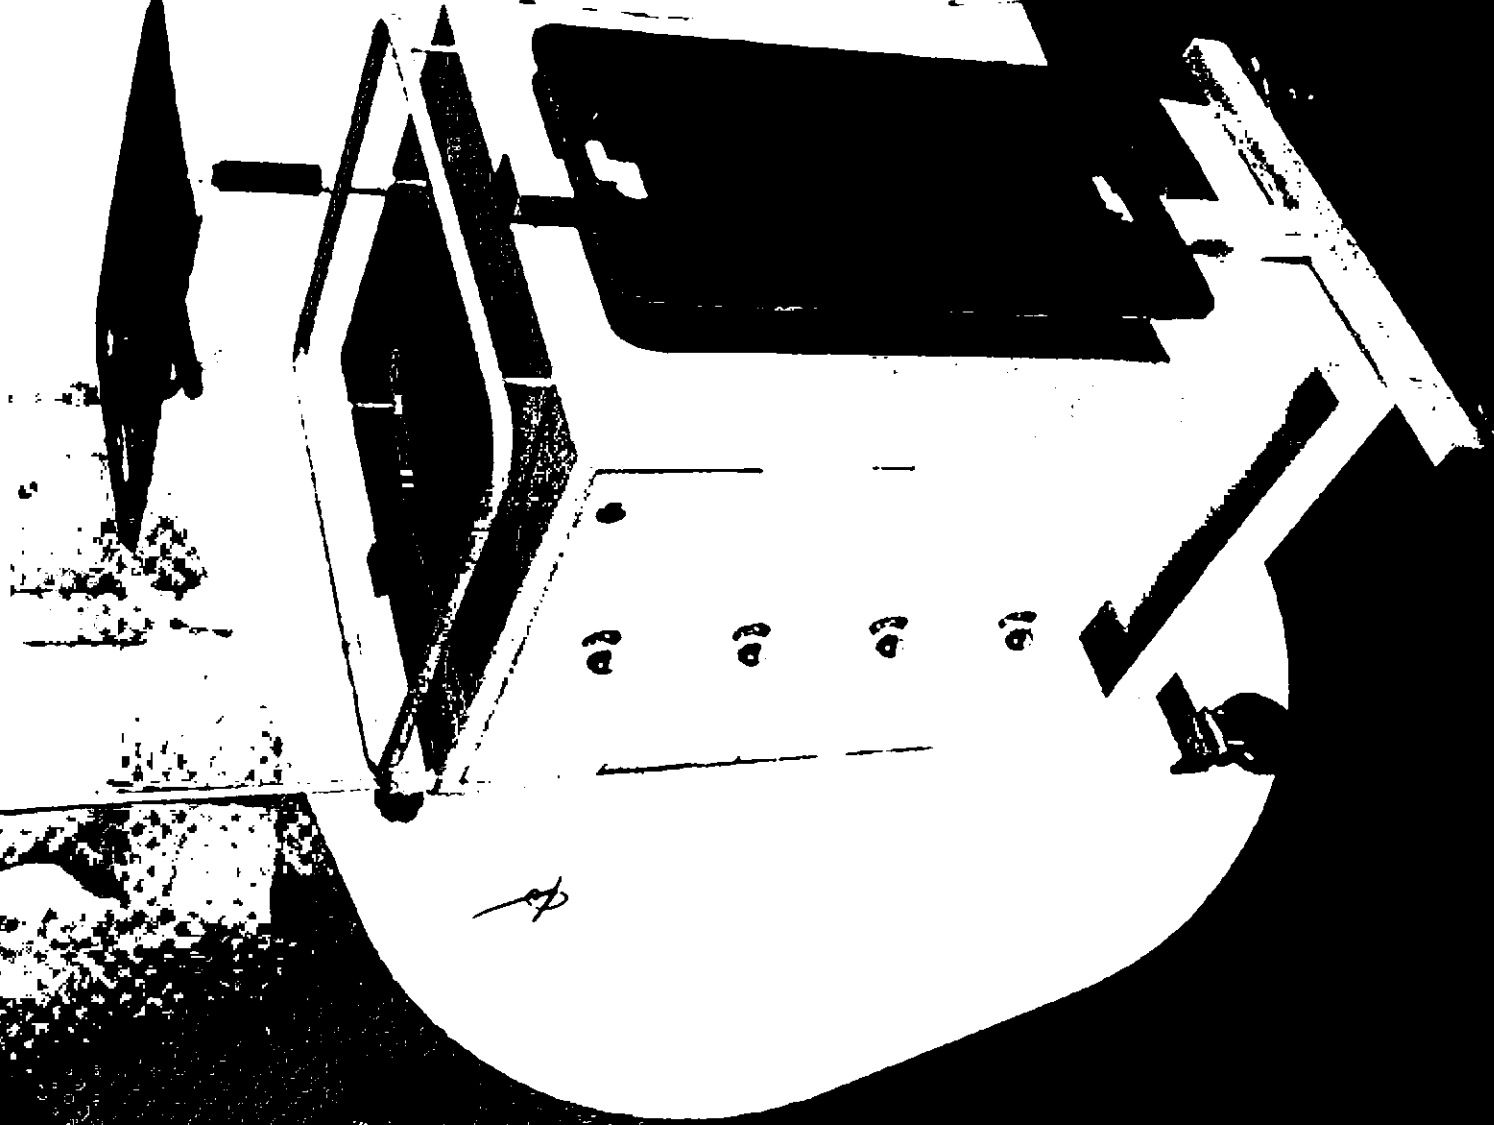

COMISSÃO  
ANTICORUPÇÃO

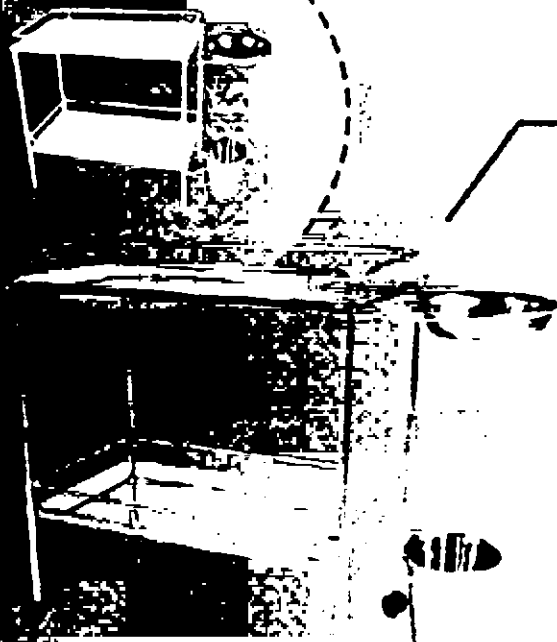

## CARRO CURATIVO

REF: TM 400

- Estrutura em tubos de aço inoxidável;
- Tampo e prateleira em aço inoxidável;
- Varanda em toda volta do tampo e prateleira;
- Suporte para balde e bacia;
- Acompanha balde e bacia inoxidáveis;
- Pés com rodízios com freios em diagonal;

### DIMENSÕES :

1,15 X 0,45 X 0,85 m

ANVISA: Não é considerado produto para saúde

### OPCIONAIS :

- Estrutura em aço carbono.
- Pintura eletrolítica antimicrobiana após tratamento antiferrugem.
- Sem balde e bacia.
- Capacidade de litros.
- Variação no diâmetro dos rodízios.
- Variação nas dimensões.
- Variações nas espessuras e diâmetros das chapas e tubos.

90

## CARRO PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS

REF: TM 401

- Estrutura em tubos de aço inoxidável;
- Tampo e prateleiras em aço inoxidável;
- Varanda em toda volta do tampo e prateleiras;
- Pés com rodízios com freios em diagonal;

### DIMENSÕES:

0,60 X 0,90 X 0,90 m

ANVISA: Não é considerado produto para saúde

### OPCIONAIS:

- Estrutura em aço carbono.
- Pintura eletrolítica antimicrobiana após tratamento antiferrugem.
- Variação no diâmetro dos rodízios.
- Variação nas dimensões.
- Variações nas espessuras e diâmetros das chapas e tubos.

M C



Voltar ao Início

## CARRO DE EMERGÊNCIA

REF: TM 402

- Estrutura em chapa de aço carbono;
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- 4 gavetas sendo a primeira com divisórias para medicamentos;
- Lacre único para todas as gavetas;
- Varanda em toda volta do tampo;
- Bandeja superior em aço inoxidável;
- Suporte superior para monitor/desfibrilador;
- Suporte para soro;
- Filtro de linha com 4 pontos;
- Suporte para cilindro de oxigênio;
- Tábua para massagem cardíaca;
- Rodízios com freios em diagonal;

### DIMENSÕES :

0,50 X 0,55 X 1,10 m

ANVISA: Não é considerado produto para saúde.

### OPCIONAIS:

- Suporte para soro inoxidável.
- Fabricado totalmente em aço inoxidável.
- Variação no diâmetro dos rodízios.
- Variação nas dimensões.
- Variações nas espessuras e diâmetros das chapas e tubos

## CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL

REF: TM 403

- Estrutura em chapa de aço inoxidável;
- Porta frontal bipartida fabricado em chapa de aço inoxidável com puxador de fecho tipo yale;
- Prateleira interna em aço inoxidável;
- Alça de transporte e parachoque de proteção em toda volta;
- Rodízios com freios em diagonal;

### DIMENSÕES :

0,60 X 0,90 X 0,80 m

ANVISA: Não é considerado produto para saúde.

### OPCIONAIS:

- Estrutura em chapa de aço carbono.
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem.
- Qualidade de prateleira interna.
- Variação no diâmetro dos rodízios.
- Variação nas dimensões.
- Variações nas espessuras e diâmetros das chapas e tubos.



# CARROS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
FR 223

## CARRO MACA HOSPITALAR

REF: TM 404

- Estrutura em tubos de aço inoxidável;
- Leito removível em chapa de aço inoxidável, com cabeceira móvel através de cremalheira;
- Grades de tomar em tubos de aço inoxidável; suporte para soro em aço inoxidável;
- Pés com rodízios com freios em diagonal;

### DIMENSÕES:

1,90 X 0,60 X 0,80m

ANVISA: N° DE CADASTRO (80589629005)

### - OPCIONAIS:

Leito Iso.

- Estrutura e leito em aço carbono com pintura eletrolítica antimicrobiana após tratamento antiferrugem.
- Para-choque de borracha em toda a volta.
- Suporte para cilindro de oxigênio.
- Variação no diâmetro dos rodízios.
- Variação nas dimensões.
- Variações nas espessuras e diâmetros das chapas e tubos.

## CARRO MACA DE TRANSFERÊNCIA

REF: TM 405

- Construído por dois carros construídos em tubos de aço inoxidável, com trilhos em aço inoxidável;
- O deslizante em chapa de aço inoxidável, engate perfeito em nylon, permite o deslocamento da maca que compõe o conjunto, oferecendo total segurança ao paciente;
- Sistema de fixação especial que libera o movimento do leito para ambos os lados;
- Cabeceira móvel através de cremalheira;
- Grades de tomar em tubo inoxidável, suporte para soro em aço inoxidável;
- Pés com rodízios com freios em diagonal;

### DIMENSÕES:

1,90 X 0,60 X 0,80m

ANVISA: N° DE CADASTRO (80589649005)

### - OPCIONAIS:

- Para-choque de borracha em toda a volta.
- Suporte para cilindro de oxigênio.
- Variação no diâmetro dos rodízios.
- Variação nas dimensões.
- Variações nas espessuras e diâmetros das chapas e tubos.

## CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA

REF: TM 406

- Estrutura em chapa de aço carbono.
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Tampa com abertura por dobradiças.
- Alça de transporte;
- Dreno para escoamento de líquidos;
- Rodízios com freios em diagonal;
- Capacidade : 400 Litros;

### DIMENSÕES:

0,60 X 0,90 X 0,85m

ANVISA: Não é considerado produto para saúde

### - OPCIONAIS:

- Fabricação em chapa de aço inoxidável.
- Para-choque de proteção em toda a volta.
- Variação no diâmetro dos rodízios.
- Variação nas dimensões.
- Variação nas espessuras e diâmetros das chapas e tubos.

## CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO

REF: TM 407

- Construído em tubos e chapa de aço carbono;
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Provido de rodas de borracha macia;

ANVISA: Não é considerado produto para saúde

### - OPCIONAIS:


- Capacidade: 3m<sup>3</sup>/ 15 litros. 7m<sup>3</sup>/40 litros. 10m<sup>3</sup>/50 litros.
- Variação no diâmetro dos rodízios.
- Variação nas dimensões.
- Variação nas espessuras e diâmetros das chapas e tubos.



# BERÇOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
R. 224  
R. 10/11/12  
R. 13/14/15

**TUBOMED**  
30 1 12 ARFES

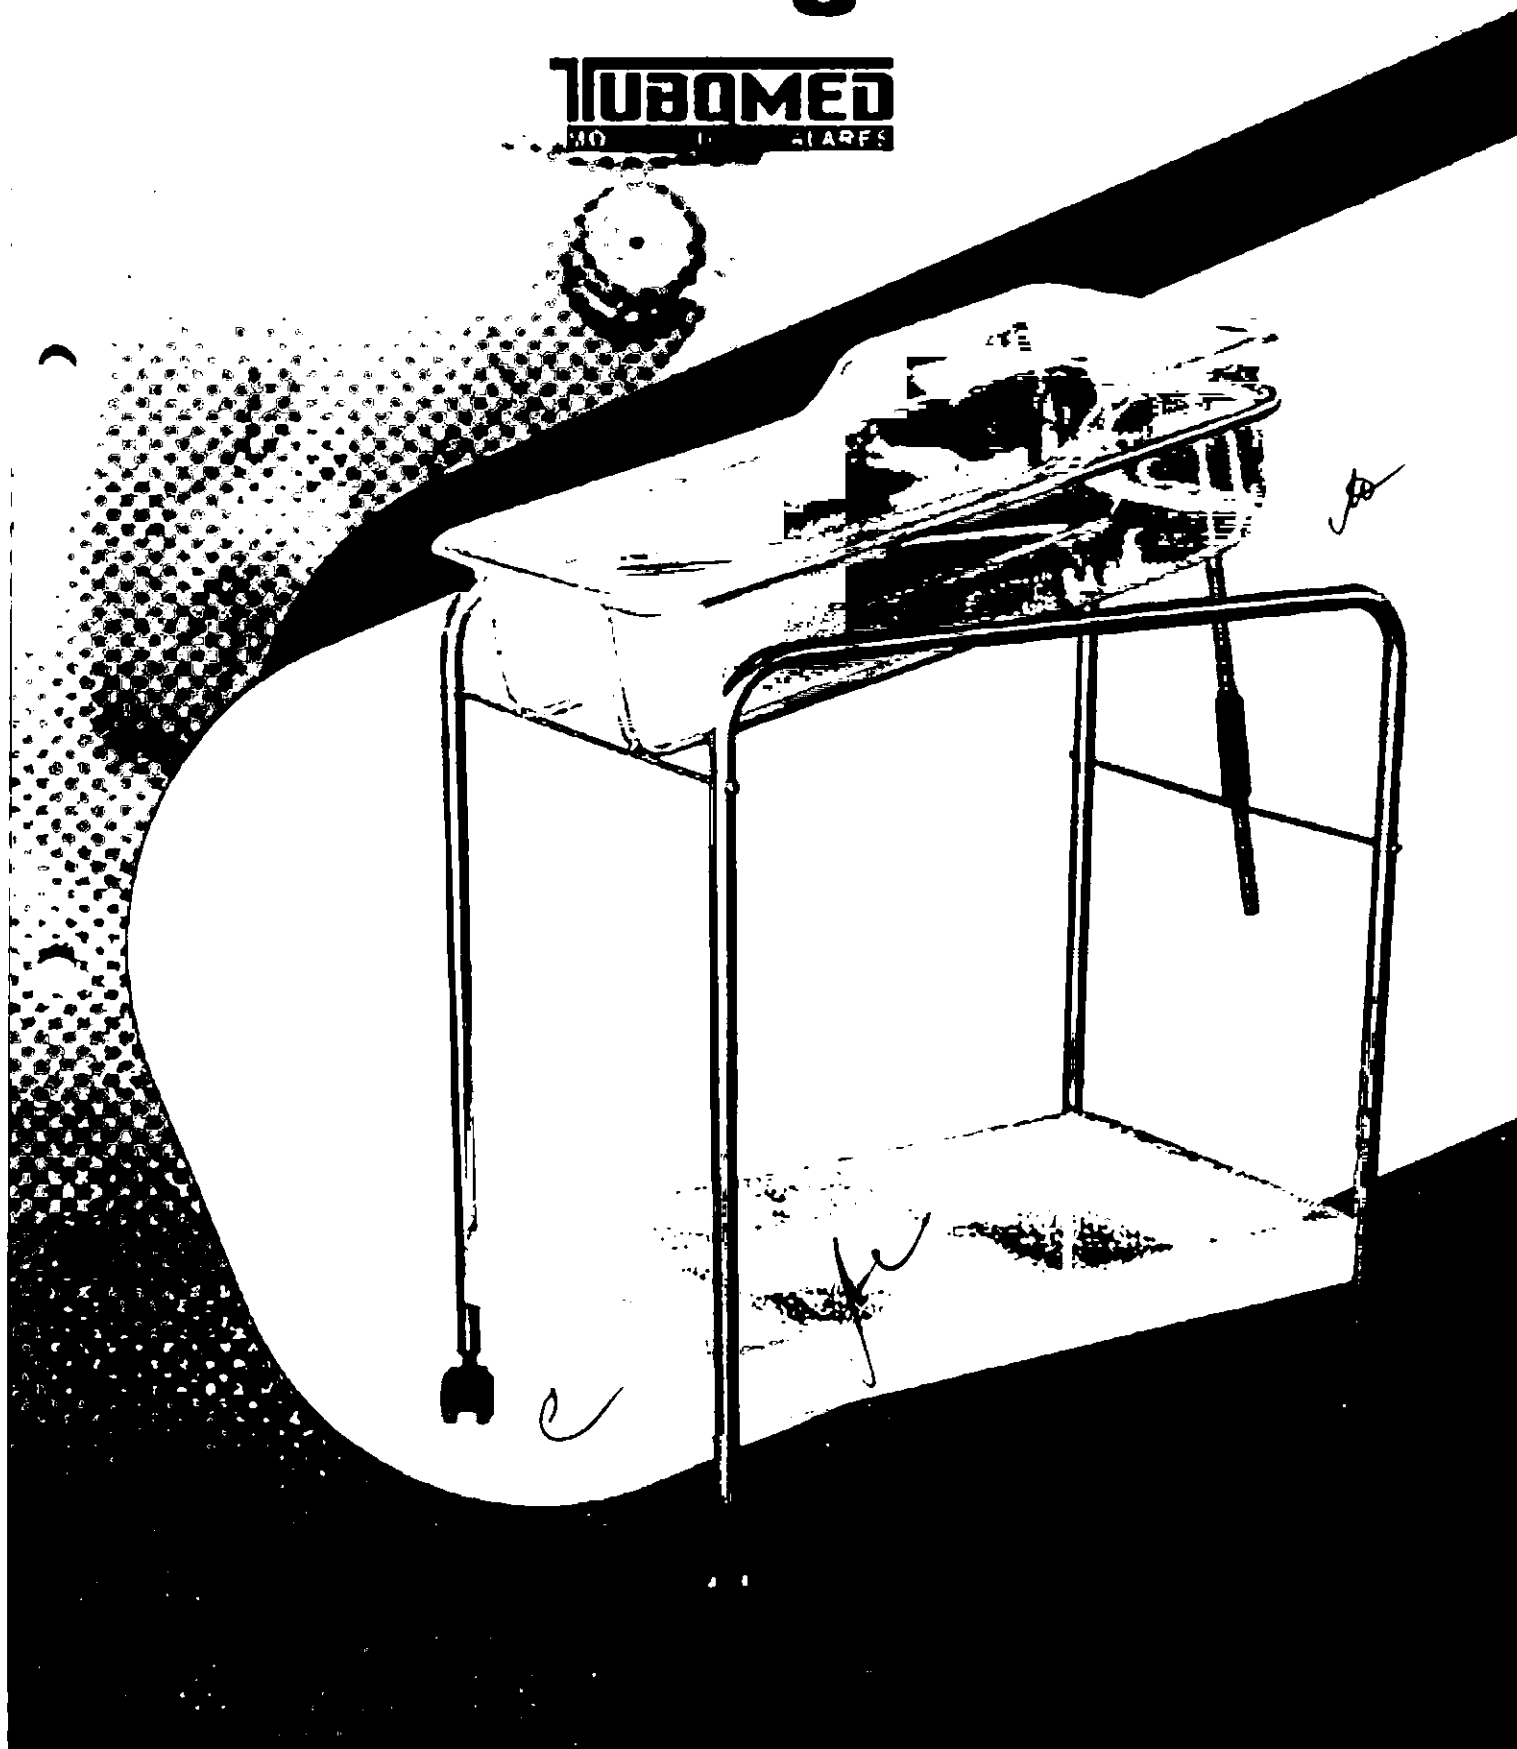



## BERÇO SIMPLES RECÉM NASCIDO

REF: TM 200



- Construído em tubos e chapas de aço carbono;
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Cabeceira e peseira em tubos de aço carbono;
- Grades em tubos de aço carbono;
- Suporte para soro;
- Pés com rodízios com freios em diagonal;
- Capacidade de Peso : 50kg;

### DIMENSÕES:

0,90 X 0,50 X 1,10 m


ANVISA: Nº DE CADASTRO (0258964/2006)

### - OPCIONAIS:

- Capacidade de peso.
- Construído totalmente em aço inoxidável.
- Leito perfurado.
- Pés com pontelras plásticas.
- Variação nas dimensões.
- Variação no diâmetro dos rodízios.
- Variações nas espessuras e diâmetros das chapas e tubos.

## BERÇO RN COM CUNA EM ACRÍLICO

REF: TM 201

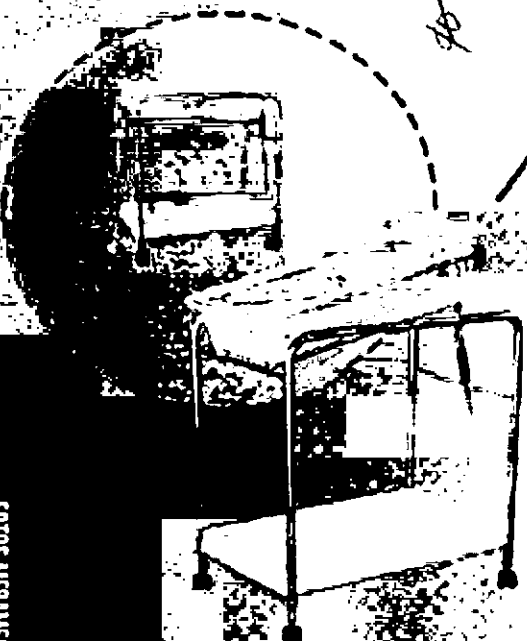

- Estrutura em aço inoxidável;
- Cesto removível em acrílico transparente ;
- Movimentos: trendeleburg e reverso do trendeleburg;
- Prateleira em ABS para guardar conveniências;
- Pés com rodízios com freios em diagonal;
- Capacidade de peso: 50kg;

### DIMENSÕES:

0,80 X 0,40 X 0,90 m

ANVISA: Nº DE CADASTRO (0608964/9036)

### - OPCIONAIS:

- Construído em tubos de aço carbono.
- Pintura eletrostática após tratamento antiferrugem.
- Sem prateleira.
- Suporte para soro em aço inoxidável.
- Pés com pontelras plásticas.
- Variação do diâmetro dos rodízios;
- Variações nas espessuras e diâmetros dos tubos.

## BERÇO HOSPITALAR INFANTIL

REF: TM 203



- Construído em tubos e chapas de aço carbono;
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Cabeceira e peseira em tubos de aço carbono;
- Grades de baixar com guias em aço inoxidável;
- Pés com rodízios com freios em diagonal;
- Capacidade de peso: 80kg;

### DIMENSÕES:

1,30 X 0,60X 0,65 m

ANVISA: Nº DE CADASTRO (0056949203)

### - OPCIONAIS:

- Capacidade de peso.
- Cabeceira regulável por cremalheira.
- Construído totalmente em aço inoxidável.
- Lito perfurado.
- Suporte para sono.
- Pés com ponteiros plásticos.
- Variação nas dimensões.
- Variação do diâmetro dos rodízios.
- Variação nas espessuras e diâmetros das chapas e tubos.



**TIJUBMED**  
KNEE HOSPITALARE

# CADEIRAS E POLTRONAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
12511

## CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE ESTOFADA

REF: TM 500

- Construída em tubos e chapas de aço carbono;
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Assento e encosto estofados, revestidos em courvin;
- Apoio para os braços, removíveis, com altura regulável, revestido em courvin;
- Componentes em aço inoxidável;
- Pés com ponteiros plásticos;
- Capacidade de peso: 120kg;

ANVISA. Nº DE CADASTRO: (805846790081)

### - OPCIONAIS:

- Estrutura em aço inoxidável.
- Capacidade de peso.
- Pés com rodízios.
- Suporte para arara em aço inoxidável.
- Variações nas espessuras e diâmetros dos tubos.

## POLTRONA RECLINÁVEL

REF: TM 600

- Construída em tubos de aço carbono;
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Assento, encosto e braços estofados, revestidos em courvin;
- Com descanso para os pés, articulado, com extensão concomitante à inclinação do encosto;
- Reclinável, permitindo várias posições;
- Movimento através de manivela lateral;
- Pés com ponteiros plásticos;
- Capacidade de peso: 120kg;

**DIMENSÕES EXTERNAS: 1,50 X 0,77 X 0,45m**

**DIMENSÕES INTERNAS : 1,50 X 0,54m**

ANVISA: não é considerado produto para saúde

### - OPCIONAIS:

- Estrutura em aço inoxidável.
- Braços fixos.
- Pés com rodízios.
- Capacidade de peso.
- Variações nas espessuras e diâmetros dos tubos.

## POLTRONA RECLINÁVEL PARA COLETA DE SANGUE

REF: TM 602

- Construída em tubos de aço carbono;
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Duas braçadeiras em material termoplástico injetado, removíveis, com altura regulável, revestidas em courvin;
- Componentes em aço inoxidável;
- Assento, encosto e braços estofados, revestidos em courvin;
- Com descanso para os pés, articulado, com extensão concomitante à inclinação do encosto;
- Reclinável, permitindo várias posições;
- Movimento através de manivela lateral;
- Pés com ponteiros plásticos;
- Capacidade de peso: 120kg;

**DIMENSÕES EXTERNAS : 1,50 X 0,77 X 0,45m**

**DIMENSÕES INTERNAS : 1,50 X 0,54m**

ANVISA: Nº DE CADASTRO (BENSERVICOS)

### - OPCIONAIS:

- Estrutura em aço inoxidável.
- Capacidade de peso.
- Pés com rodízios.
- Variações nas espessuras e diâmetros dos tubos.

## POLTRONA RECLINÁVEL PISTÃO À GÁS

REF: TM 601

- Construída em tubos de aço carbono;
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Assento, encosto e braços estofados, revestidos em courvin;
- Com descanso para os pés, articulado, com extensão concomitante à inclinação do encosto;
- Totalmente reclinável, permitindo várias posições;
- Descanso para os pés, articulado, movimento independente do encosto;
- Movimentos independentes acionados através de duas manivelas lateral;
- Pés com ponteiros plásticos.
- Capacidade de peso: 150kg;

**DIMENSÕES EXTERNAS : 1,85 X 0,70 X 0,45m**

**DIMENSÕES INTERNAS : 1,85 X 0,55m**

ANVISA: Não é considerada produto para saúde

### - OPCIONAIS:

- Estrutura em aço inoxidável.
- Pés com rodízios.
- Capacidade de peso.
- Variações nas espessuras e diâmetros dos tubos.



## CADEIRA POLIPROPILENO PARA COLETA DE SANGUE

REF: TM 501

- Construída em tubos e chapas de aço carbono;
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Assento e encosto em polipropileno;
- Apoio para o braço frontal estofado, revestido em couro, com altura regulável;
- Componentes em aço inoxidável;
- Pés com ponteiros plásticos;
- Capacidade de peso: 120kg;

ANVISA Nº DE CADASTRO (REG 59064908)

### - OPCIONAIS:

- Estrutura em aço inoxidável.
- Pés com rodízios.
- Suporte para soro em aço inoxidável.
- Variações nas espessuras e diâmetros dos tubos.

## CADEIRA FIXA EM AÇO ESMALTADO

REF: TM 502

- Construída em tubos e chapa de aço carbono;
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Assento e encosto em chapa de aço carbono;
- Pés com ponteiros plásticos;

### DIMENSÕES:

0,45 X 0,50 X 0,85m

ANVISA: Item é considerado produto para saúde

### - OPCIONAIS:

- Estrutura e assento em chapa de aço inoxidável.
- Variação nas dimensões.
- Variações nas espessuras e diâmetros dos tubos.
- Assento estofado;



Voltar ao Início

## CADEIRA FIXA

REF: TM 503

- Construída em tubos de aço carbono.
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Revestimento do assento e encosto em polipropileno.
- Pés com ponteiros plásticos;
- Capacidade de peso: 120kg;

**DIMENSÕES :**  
0,53 X 0,53 X 0,80 m

ANVISA: Não é considerado produto para saúde.

### - OPCIONAIS:

- Cores do polipropileno.

## LONGARINA DE 3 LUGARES

REF: TM 504

- Construída em tubos e chapa de aço carbono;
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Revestimento do assento e encosto em polipropileno;
- Pés com ponteiros plásticos;
- Capacidade de peso: 120 kg / Lugar

**DIMENSÕES :**  
1,50 X 0,55 X 0,80 m

ANVISA: Não é considerado produto para saúde.

### - OPCIONAIS:

- Quantidade de lugares
- Cores do polipropileno.



## BANCO MOCHO À GÁS

REF: TM 900

- Base em tubos de aço carbono;
- Acabamento termoplástico injetado de alta resistência;
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Mecanismo a gás com regulagem;
- Assento e encosto com espuma injetada, revestido em courvin;
- Pés com rodízios;

**DIMENSÕES SÓ DO ASSENTO:** 0,38m

**ALTURA (mínima) :** 0,58m

**ALTURA (máxima) :** 0,70m

ANVISA: Não é considerado produto para saúde

### - OPCIONAIS:

- Cores do courvin.

## BANQUETA GIRATÓRIA INOXIDÁVEL

REF: TM 901

- Construída em tubos de aço inoxidável;
- Assento estofado, revestido em courvin;
- Pés com rodízios;

**DIMENSÕES SÓ DO ASSENTO:** 0,33m

**ALTURA (mínima) :** 0,50m

**ALTURA (máxima) :** 0,65m

ANVISA: Não é considerado produto para saúde.

### - OPCIONAIS:


- Construída em tubos de aço carbono.
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem.
- Pés com pontelas.
- Variação do diâmetro dos rodízios.
- Variações nas espessuras e diâmetros dos tubos.



COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Fls. 228  
R. 10/11/12

# DIVERSOS

**TUBOMED**  
MÓDULO HOSPITALAR

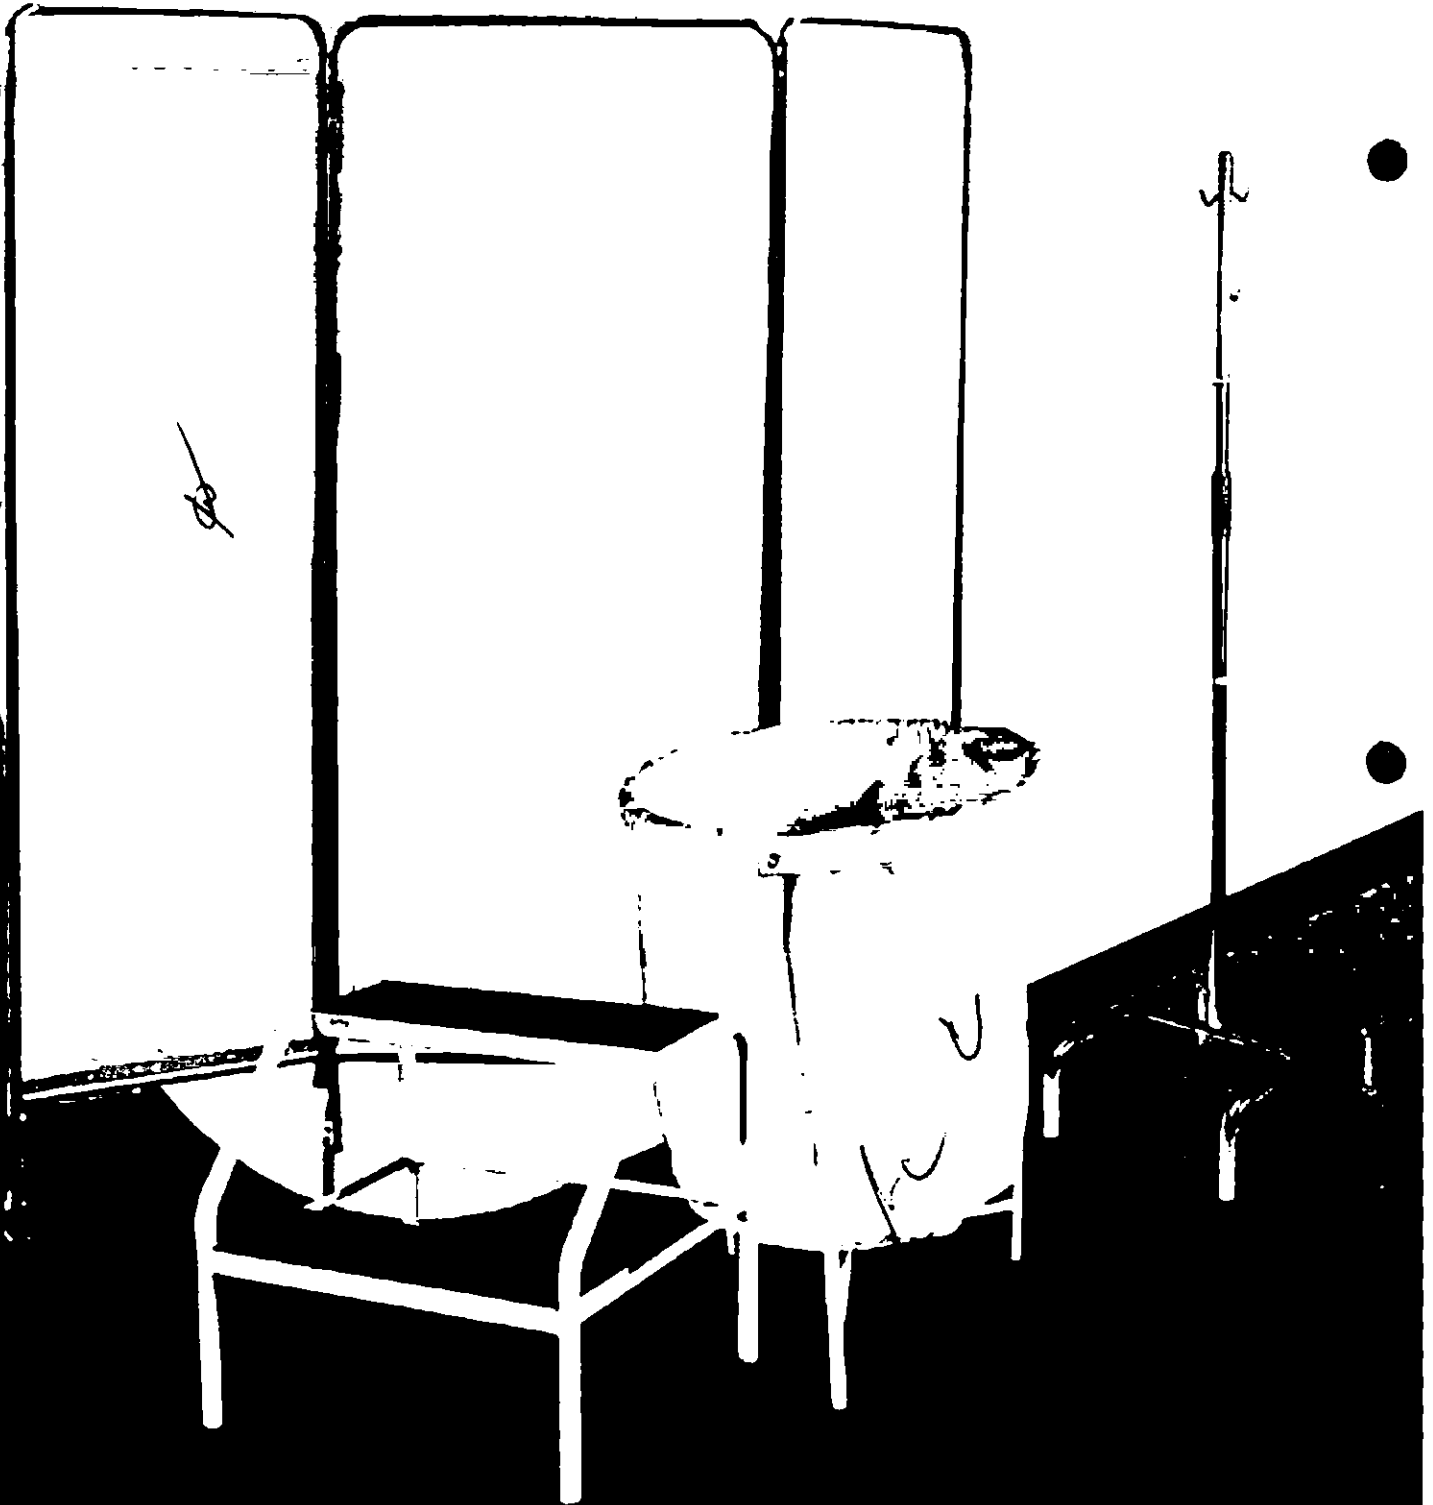

COMISSÃO DE  
Fis. 229  
*[Handwritten signature]*

## SUORTE PARA SORO

REF: TM 902

- Construído em tubos de aço carbono;
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Com 4 ganchos;
- Pés com ponteiros plásticos;

ALTURA: 1,90 m

ANVISA: N.º DE CADASTRO (R0358964903)

### - OPCIONAIS:

- Rodízios.
- Totalmente inoxidável.
- Variação no diâmetro dos rodízios.
- Variações nas espessuras e diâmetros dos tubos.

## SUORTE PARA SORO REGULÁVEL COM RODÍZIOS

REF: TM 903

- Construído em tubos de aço carbono.
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Com 4 ganchos;
- Pés com rodízios;

ALTURA AJUSTÁVEL:

1,40 m (Mínima) - 2,40 m (Máxima)

ANVISA: N.º DE CADASTRO (R0358964903)

### - OPCIONAIS:

- Pés com ponteiros plásticos.
- Totalmente inoxidável.
- Altura fixa.
- Haste inoxidável.
- Variação no diâmetro dos rodízios.



## BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO

REF: TM 904

- Construída em tubos de aço inoxidável;
- Altura regulável através de mandril;
- Concha em material termoplástico injetado;

### ALTURA AJUSTÁVEL:

0,80 m (Mínima) - 1,30 m (Máxima)

ANVISA: Nº DE CADASTRO (6158949007)

### - OPCIONAIS :

- Construída em tubos de aço carbono.
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem.
- Concha revestida em courovin.
- Variação na elevação de altura.
- Variações nas espessuras e diâmetros dos tubos

## HAMPER (COLETOR DE ROUPAS)

REF: TM 907

- Construído em tubos de aço carbono;
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Pés com rodízios;
- Acompanha saco em algodão cru;

### DIMENSÕES:

0,50 m X 0,80 m

ANVISA: Não é considerado produto para saúde.

### - OPCIONAIS:

- Pés com pontetras;
- Construído em tubos de aço inoxidável;
- Variação no diâmetro do rodízios;
- Variação nas dimensões;
- Variações nas espessuras e diâmetros dos tubos;



Voltar ao Início

## BIOMBO DUPLO

REF: TM 905

- Construído em tubos de aço carbono;
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Composto por duas faces giratórias em 360°;
- Pés com ponteiros plásticos;
- Faces em PVC dupla face;

### DIMENSÕES :

1,20 m X 1,75 m

**ANVISA:** Não é considerado produto para saúde

### - OPCIONAIS:

- Construído em tubos de aço inoxidável.
- Faces em algodão cru.
- Pés com rodízios.
- Variação nas dimensões.
- Variações nas espessuras e diâmetros dos tubos.

## BIOMBO TRIPLO

REF: TM 906

- Construído em tubos de aço carbono;
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Composto por duas faces giratórias em 360°;
- Pés com ponteiros plásticos;
- Faces em PVC dupla face;

### DIMENSÕES:

1,80 m X 1,75 m

**ANVISA:** Não é considerado produto para saúde

### - OPCIONAIS:


- Construído em tubos de aço inoxidável.
- Faces em algodão cru.
- Pés com rodízios.
- Variação nas dimensões.
- Variações nas espessuras e diâmetros dos tubos.



Voltar ao Início

## ESCADA COM 1 DEGRAU

REF: TM 912

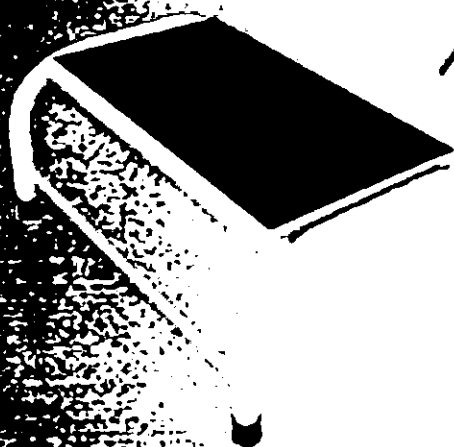

- Construída em tubos e chapas de aço carbono;
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Piso revestido com borracha antiderrapante na cor preta;
- Pés com pontelras;
- Capacidade de peso: 130kg;

### DIMENSÕES:

0,40 X 0,30 X 0,20 m

### - OPCIONAIS:

- Construída em tubos e chapas de aço inoxidável.
- Piso em chapa de alumínio antiderrapante.
- Variação nas dimensões.
- Variações nas espessuras e diâmetros dos tubos e chapas.

## ESCADA COM 2 DEGRAUS

REF: TM 908



- Construída em tubos e chapas de aço carbono;
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Pisos revestidos com borracha antiderrapante na cor preta;
- Pés com pontelras;
- Capacidade de peso: 150kg;

### DIMENSÕES:

0,40 X 0,40 X 0,40 m

### - OPCIONAIS:

- Construída em tubos e chapas de aço inoxidável.
- Piso em chapa de alumínio antiderrapante.
- Variação nas dimensões.
- Variações nas espessuras e diâmetros dos tubos e chapas.



## SUORTE PARA COLETOR PERFUROCORTANTE

REF: TM 910

- Construído em aço inoxidável;
- Furos para fixação na parede;
- Capacidade: 7 litros;

### - OPCIONAIS:

- Construído em aço carbono.
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem.
- Capacidade: 3, 7, 13, 20 litros.

## CALÇADOR DE MEIA DE COMPRESSÃO

REF: TM 911

- Construído em aço carbono;
- Pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem;
- Tamanho único;

## COLCHÃO HOSPITALAR

REF: TM 909

- Placa de espuma de alta performance densidade D26;
- Tratamentos antiácido e contra bactéria na espuma e revestimento;
- Revestimento em napa azul 100% PVC;
- Espuma selada 100% Poliuretano;

### - OPCIONAIS:

- Densidade: D20, D26, D28, D33, D46;



# OPÇÕES DE CORES DO COURVIN

## PARA MÓVEIS COM ESTOFADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
FR 232  
Ribeira

**TUBE**  
MÓVEIS

Informamos que podem ocorrer pequenas variações nas cores em relação ao mostrado na tela.

BRANCO

BEGE

CINZA

GRAFITE

PRETO

AZUL

AZUL CLARO

VERDE CLARO



Voltar ao Inicio





**Agência Nacional  
de Vigilância Sanitária**

A Tubomed Móveis Hospitalares possui autorização de funcionamento expedida pela ANVISA Nacional nº U4415X4YWY23, publicada no Diário Oficial da União, seção 01, suplemento ao nº 06, página 11, do dia 11 de Janeiro de 2010.

**REGISTRO: OS MÓVEIS DA TUBOMED SÃO INSETOS DE REGISTROS NA ANVISA, POIS SÃO CONSIDERADOS CLASSE 1- PRODUTOS MÉDICOS NÃO INVASIVOS, CONFORME ESCLARECE A RESOLUÇÃO RDCNº 185/01, HAVENDO SOMENTE A NECESSIDADE DE CADASTRO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC Nº 24/09.**

**CADASTRO: PELA RESOLUÇÃO RDC Nº 260/02, SOMENTE ALGUNS MÓVEIS DA TUBOMED SÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE, PRECISANDO ESTES TEREM CADASTROS. OS DEMAIS SÃO INSETOS TANTO DE REGISTRO COMO DE CADASTRO.**

**CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO : " O REGIME DE CADASTRAMENTO DISPENSA A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO, MAS NÃO ISENTA DE CUMPRIR COM REQUISITOS DAS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO ." RESOLUÇÃO RDCNº 24/09.**

**TUBOMED**  
MOVEIS HOSPITALARES

**ATENDIMENTO  
AO CLIENTE**

St. Corredor da AABB, Nº 1300, Parque Bulandeira,  
Barbalha - CE, 63180-000

☎ ☎ (88) 9. 9957.1070 \ (88) 3532-1353

LOCAL, 08 DE NOVEMBRO DE 2023.

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM  
Secretaria de Saúde  
Comissão de Licitação



OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1610.01/2023 - SMS / PE  
ABERTURA: 09 / 11 / 2023 ÀS 08 : 30 H

P-6

	MARCA	QTDE.	UNID.	UNIT. (R\$)	ex	extenso
--	-------	-------	-------	-------------	----	---------

LOTE 1

1	MEXA DE EXAMES - CARACTERÍSTICA FÍSICA ESTRUTURA   MATERIAL DE CONFECÇÃO ESPECIFICAÇÃO COM ARMÁRIO   MADEIRA OU MDF	saltem	1	UND	4.813,50	quatro mil, oitocentos e treze reais e cinquenta centavos	4.813,50	quatro mil, oitocentos e treze reais e cinquenta centavos
---	---	--------	---	-----	----------	---	----------	---

4.813,50
----------

quatro mil, oitocentos e treze reais e cinquenta centavos

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA.....: R\$	4.813,50
quatro mil, oitocentos e treze reais e cinquenta centavos	

<b>PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.</b>
<b>PRAZO DE ENTREGA: Conforme os termos do edital</b>
Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretas, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento convocatório (edital).

Handwritten marks at the bottom of the page.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

P-8

À  
 PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM/CE  
 EDITAL PARA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1610.01/23-SMS/PE  
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE. DATA DE ABERTURA: 09-11-2023 | HORA DA ABERTURA: 08:30:00

ITEM	UND	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	MODELO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO ESTIMADO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	UND	Mesa de Exames Característica Física ESTRUTURA   MATERIAL DE CONFECCÃO Especificação COM ARMÁRIO   MADEIRA OU MDF	1	SANTA CLARA	SCB 10M	R\$ 3.209,00	TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS	R\$ 3.209,00	TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS

A PRESENTE PROPOSTA É VALIDA CONFORME EDITAL OU ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS. ✓

PRazo e LOCAL DE ENTREGA: OS BENS LICITADOS/CONTRATADOS DEVERÃO SER ENTREGUES CONFORME EDITAL OU NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA EMITIDA PELA UNIDADE GESTORA, NO LOCAL DEFINIDO NA ORDEM DE COMPRA. FRETE: CIF

O OBJETO CONTRATUAL CONFORME EDITAL OU TERA GARANTIA DE 12(DOZE) MESES.

GARANTIA DOS PRODUTOS: CONFORME EDITAL OU 12 (DOZE) MESES.

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL OU ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA.

POR ESTA PROPOSTA, DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE AOS DA LEI 8.666/93. PROPONHOS EXECUTARMOS O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, OBEDECENDO ÀS ESTIPULAÇÕES DO CORRESPONDENTE EDITAL E ÀS SUAS ESPECIFICAÇÕES, E ASSEVERANDO QUE: O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE : CONFORME EDITAL, AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO SÃO: CONFORME EDITAL; O PRAZO DE ENTREGA/ EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO É DE ACORDO COM CONTRATO; TODOS OS COMPONENTES DE DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA, CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS RELACIONADOS COM SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E SOCIAIS, E TODOS OS DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXIGÊNCIA LEGAL OU DAS CONDIÇÕES DE GESTÃO DO CONTRATO A SER ARRENDADO, ENCONTRAM-SE INCLUIDOS NOS PREÇOS OFERTADOS.PELA PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE OS DA LEI Nº 8.666/93 E LEI Nº 18.520/2002, BEM COMO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA; DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEDA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO. ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE EXECUTAR OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I CASO SEJAMOS VENCEDORES DA PRESENTE LICITAÇÃO O LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO DOS ITENS LICITADOS, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO. DECLARAMOS DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; DECLARAMOS DE QUE O PROPONENTE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA PROPOSTA DE PREÇOS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO EDITAL. O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA DESTA EDITAL. - INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM: - ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; - TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES; - SEGUROS EM GERAL, DA IMPORTUNISTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUALQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI Nº 18.520, DE 03 DE SETEMBRO DE 2002, LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO SUPRACITADA. NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETOS DESTA LICITAÇÃO; QUE SE COMPROMETE A FORNECER INFORMAÇÕES ADICIONAIS, SOLICITADAS PELO(A) PREGOEIRO(A) OU PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMO: LAUDOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DO PRODUTO, CATÁLOGOS, E OUTROS, A QUALQUER TEMPO E/OU FASE DO PROCESSO LICITATÓRIO, COM FINALIDADE DE DIRIMIR DÚVIDA E INSTRUIR AS DECISÕES RELATIVAS AO JULGAMENTO. NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETOS DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL; DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, GARANTIA DO MATERIAL, TARIFAS CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE O OBJETO DA PRESENTE AQUISIÇÃO. DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

DATA: 09/11/2023

*(Handwritten signature and initials)*

# Mesa para Exame Clínico em MDF



Estrutura: Gabinete/Armário confeccionada em madeira "MDF" de 15 mm de espessura, dupla face, com 2 portas e 3 gavetas. Leito: acolchoado com espuma de alta densidade, revestido em courvim, dividido em 3 seções, sendo assento fixo, parte posterior e anterior com movimentos através de cremalheira. Pés: com ponteiros. Própria para exames e curativos.

#### CAPACIDADE

180kg

#### DIMENSÕES

1,80 x 0,50 x 0,85 (C x L x A)

#### OPCIONAL

- Dimensões variadas
- Variação nas quantidades de gavetas
- Gabinete em chapas de aço carbono ou inox
- Variação no numero de portas
- Suporte de lençol descartável

#### REFERÊNCIA

SCB 10M

#### REGISTRO ANVISA

80413280005

Produtos Registrados



## Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	SANTA CLARA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ	35.042.019/0001-85
Autorização	8.04.132-8
Produto	MESA PARA EXAMES CLÍNICO

Modelo Produto Médico
SCF006
SCB10
SCB10_M
SCB11
SCB12
SCB13
SCB14
SCB14M
SCB02
SCB02_RF
SCB03
SCB04

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de
[sem dados cadastrados]		

Nome Técnico	Mesa para exame
Registro	80413280005
Processo	25351094135201703
Fabricante Legal	SANTA CLARA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1610.01/2023-SME/PE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

AO PREGEDOR(A) DA PREFEITURA DE FORTIM

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE.

p-7

CARTA PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	QTD	VL.UNIT.		VL.TOTAL	
1	Mesa de Exames Característica Física ESTRUTURA   MATERIAL DE CONFEÇÃO (Especificação COM ALBAÁRIO   MADEIRA OU MDF)	UNID	NEW MAP	1	R\$ 3.208,00	três mil, duzentos e nove reais	R\$ 3.208,00	três mil, duzentos e nove reais
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b>							<b>R\$ 3.208,00</b>	
								três mil, duzentos e nove reais

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre os serviços referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus inerentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

DATA: 09/11/23

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

**NEW MAP**

## **Mesa de Exames com armário**

### **Característica Física**

ESTRUTURA | MATERIAL DE CONFECÇÃO

### **Especificação**

COM ARMÁRIO | MADEIRA OU MDF

PE Nº 1610.01/2023 -SMS/PE



**PROPOSTA DE PREÇOS**

À  
PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM/CE  
EDITAL PARA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1610.0123-SMS/PE  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE. DATA DE ABERTURA: 09-11-2023 | HORA DA ABERTURA: 08:30:00

ITEM	UND	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	MODELO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITÁRIO REFERENCIAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL REFERENCIAL
2	UND	Ar Condicionado Característica Física TIPO   CAPACIDADE   CICLO Especificação SPLIT   9000 A 12000 BTUs   QUENTE E FRIO	1	AGRATTO	FTT CCST9QF	R\$ 1.843,00	MIL OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS	R\$ 1.843,00	MIL OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS

F-3

A PRESENTE PROPOSTA É VALIDA CONFORME EDITAL OU ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS BENS LICITADOS/CONTRATADOS DEVERÃO SER ENTREGUES CONFORME EDITAL OU NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA EMITIDA PELA UNIDADE GESTORA, NO LOCAL DEFINIDO NA ORDEM DE COMPRA. FRETE: CIF

O OBJETO CONTRATUAL CONFORME EDITAL OU TERA GARANTIA DE 12(DOZE) MESES.

GARANTIA DOS PRODUTOS: CONFORME EDITAL OU 12 (DOZE) MESES.

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL OU ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA.

POR ESTA PROPOSTA, DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE AOS DA LEI 8.666/93. PROPOMOS EXECUTARMOS O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, OBEDECENDO ÀS ESTIPULAÇÕES DO CORRESPONDENTE EDITAL E AS SUAS ESPECIFICAÇÕES, E ASSEVERANDO QUE: O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 1 CONFORME EDITAL; AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO SÃO: CONFORME EDITAL; O PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO É DE ACORDO COM CONTRATO; TODOS OS COMPONENTES DE DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA, CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS RELACIONADOS COM SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E SOCIAIS, E TODOS OS DEBEMOS IMPOSTOS, TAXAS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXIGÊNCIA LEGAL OU DAS CONDIÇÕES DE GESTÃO DO CONTRATO A SER ASSINADO, ENCONTRAM-SE INCLUIDOS NOS PREÇOS OFERTADOS PELA PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE OS DA LEI Nº 8.666/93 E LEI Nº 10.520/2002, BEM COMO AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA; DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEDIRIA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO. ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE EXECUTAR OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, CASO SEJAMOS VENCEDORES) DA PRESENTE LICITAÇÃO LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAL E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO DOS ITENS LICITADOS, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO. DECLARAMOS DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, E DEMAIS ÔNUS ATENENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; DECLARAMOS DE QUE O PROPONENTE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA PROPOSTA DE PREÇOS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO EDITAL. O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA DESTA EDITAL. - INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM: - ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; - TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICÊNCIAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES; - SEGUROS EM GERAL, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUALQUER DANO E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI Nº 10.520, DE 03 DE SETEMBRO DE 2002, LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO SUPRACITADA. NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PNEAS DA LEL QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETOS DESTA LICITAÇÃO; QUE SE COMPROMETE A FORNECER INFORMAÇÕES ADICIONAIS, SOLICITADAS PELO(A) PREGOEIRO(A) OU PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMO: LAUDOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DO PRODUTO, CATÁLOGOS, E OUTROS, A QUALQUER TEMPO E/OU FASE DO PROCESSO LICITATÓRIO, COM FINALIDADE DE DIRIMIR DÚVIDA E INSTRUIR AS DECISÕES RELATIVAS AO JULGAMENTO. NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PNEAS DA LEL QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETOS DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL; DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, GARANTIA DO MATERIAL, TARIFAS CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE O OBJETO DA PRESENTE AQUISIÇÃO. DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

DATA: 09/11/2023




COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Fis. 240  
Rúbrica

# Ar Condicionado SPLIT



# FIT

9.000 BTUs

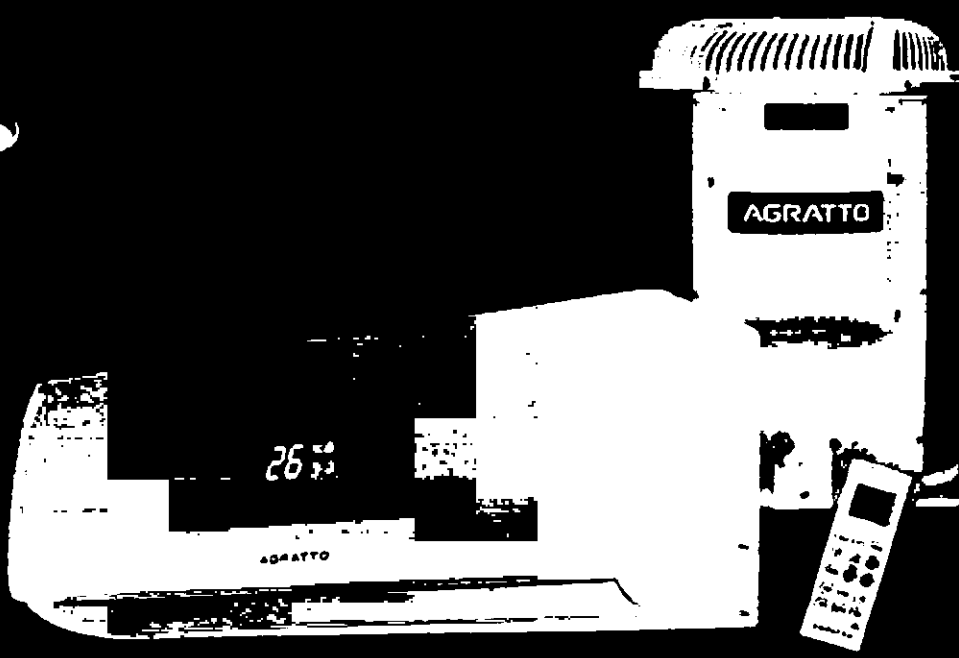

QUENTE e FRIO 

Com design clean, moderno e elegante

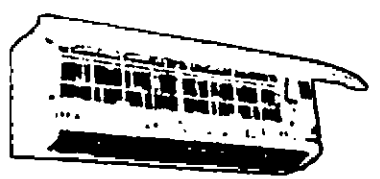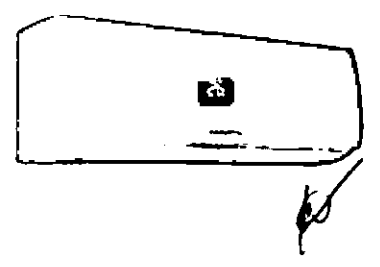

Todas as imagens desta ficha são meramente ilustrativas.

# AGRATTO

*Handwritten signature*


Ar Condicionado

# SPLIT FIT

De fabricação nacional, são econômicos, ecológicos e silenciosos, gerando o mínimo de impacto no meio ambiente.

São desenvolvidos com materiais de alta durabilidade, utilizando as melhores peças e acabamentos e ainda possuem a confiança de serem produtos de fabricação nacional.

**Top Discharge** com grade superior especialmente desenvolvida para maior ventilação e dissipação de calor. Possui menos partes metálicas, o que a deixa mais leve e evita a corrosão.

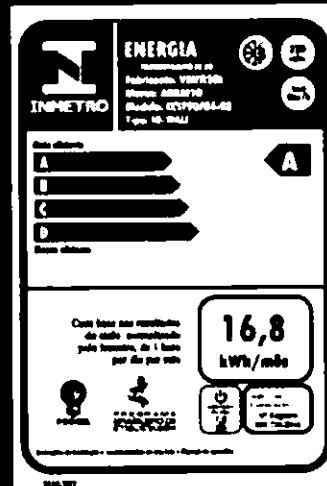

## AGRATTO

Modelo	CCST9QFER4-02
Modelo de Unidade Interna	CCST9QFER4-02
Modelo de Unidade Externa	CCST9QFER4-02
Classe	I
Grau de Segurança	IP XA
Tensão	220V~
Frequência	60Hz
Capacidade de Resfriamento	7500W
Capacidade de Refrigeração	8000Btu/h
Corrente	4.2A
Potência Máxima	770W
Vazão Fluxo de Ar	480m³/h
Nível de Ruído Interno/ Externo	32-38/54dB(A)
Gás Refrigerante	R410A/740g
Pressão Máxima (Descarga)	4.2MPa
Pressão Máxima (Sucção)	1.2MPa
Peso de Unidade Interna	7.320Kg
Peso de Unidade Externa	19.210Kg

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MAMAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA


[www.agratto.com](http://www.agratto.com)

**ECONÔMICO** Classificação A no Procel

**SERPENTINA** Tubos 100% em cobre

**PAINEL DE LED** Iluminação suave

**GÁS R410a** Gás ecológico

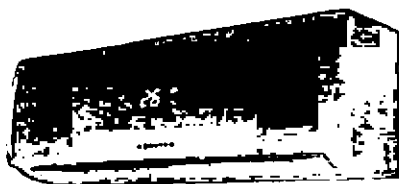

UNIDADE EVAPORADORA



CONTROLE REMOTO



CONDENSADORA TOP DISCHARGE

# AGRATTO

FICHA TECNICA

P-1

A  
 PREFEITURA DE FORTIM  
 ESTADO DO CEARA  
 PREGÃO ELETRONICO N. 1610.01/2023

Item	Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
03	Câmara para Conservação de Imunobiológicos - MARCA:PRÓPRIA MODELO:PRÓPRIA - MATERIAL DE CONFEÇÃO (GABINETE INTERNO) AÇO INOXIDÁVEL 304 TEMPERATURA ENTRE +2º C E + 8ºC CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO SENSORES INTERNOS DISCADOR DE EMERGÊNCIA CAPACIDADE E QUANTIDADE/CONTRA PORTA/SISTEMA DE EMERGÊNCIA E DE REGISTRO DE DADOS 120 LITROS E 2 GAVETAS. COM REGISTRO ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES.	UN	01	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
<b>VALOR TOTAL DO ITEM Nº 03 R\$ 14.000,00</b>					
<b>(QUATORZE MIL REAIS)</b>					

DECLARAÇÕES:

- Tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, e execução do objeto da licitação e na concordância com todos os termos deste Edital, inclusive no seguinte:
- Os produtos são de primeira qualidade;
- Concordamos em manter a validade desta proposta por um período não inferior a 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da abertura da mesma. Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital;
- Condições de pagamento: conforme Edital.
- Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:
- A fornecer os produtos no prazo e condições previstos no Edital, contados a partir do recebimento da respectiva nota de empenho;
- Que atende os requisitos de qualidade mínima exigidos do(s) produto(s) ou serviço(s) bem como seus prazos e condições de entrega;
- Que no preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e taxas assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
- Declaramos total conhecimento e concordância com os termos do Edital.
- DECLARO, sob as penas da lei, que os preços cotados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

09 de novembro de 2023.

Handwritten marks at the bottom of the page, including a checkmark and a signature.



A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM  
À CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTIM  
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1916.01/2023 - SRE/SPE  
DIA E HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09 DE NOVEMBRO DE 2023 às 09h30 horas  
DIA E HORÁRIO DA SESSÃO DE DEBUTA DE LANCES: 09 DE NOVEMBRO DE 2023 às 11h30 horas

At. Sr.(a) Pregoeiro (a)  
Pelo presente instrumento, venho apresentar nossa Proposta de Escrita, relativa ao objeto do referido prego, bem como as informações especificações e as condições abaixo discriminadas

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE.

P-2

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	V. UNITÁRIO	EXTENSO UNITÁRIO	V. TOTAL	EXTENSO TOTAL
3	Câmara para Conservação de Imunológicos Característica Física Especificação DESCADOR DE EMERGÊNCIA POSSUI MATERIAL DE CONFEÇÃO (GABINETE INTERNO) AÇO INOXIDÁVEL 304 CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO POSSUI BENSORES INTERNOS POSSUI CAPACIDADE 1 QUANTIDADE DE GAVETAS   SISTEMA DE EMERGÊNCIA   REGISTRO DE DADOS ATE 300 LITROS   2 A 4 GAVETAS   POSSUI   POSSUI TEMPERATURA ENTRE MAIS 2 GRAUS CELSIUS E MAIS 8 GRAUS CELSIUS MOD. CCV 380-220V GAVTELE380	UND	1	ANCO	R\$ 20.779,44	vinte mil, setecentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 20.779,44	vinte mil, setecentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$ 20.779,44	
							vinte mil, setecentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos	

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação que nossa Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do Edital, supracitado e seus anexos.

Declaramos que objeto cotado atende todas as exigências do edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Ourossim declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços de proposta inicial, digital ou anexa, ou ofertados por meio de lances, estão inclusas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos, sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive margem de lucro.

Caso nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

a) Validade da proposta: 60 (SESENTA) dias, contados da sessão de abertura das propostas;

b) Prazo de entrega: 20(VINTE) dias úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Compra.

09 de Novembro de 2023.

v

pc

LOCAL, 08 DE NOVEMBRO DE 2023.

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM  
Secretaria de Saúde  
Comissão de Licitação



OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1610.01/2023 - SMS / PE  
ABERTURA: 09 / 11 / 2023 ÀS 08 : 30 H

P-1

MARCA	QTDE.	UNID.	UNIT. (R\$)	extar	extarço
-------	-------	-------	-------------	-------	---------

LOTE 3

3	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS CARACTERÍSTICA FÍSICA DISCADOR DE EMERGÊNCIA ESPECIFICAÇÃO POSSUI MATERIAL DE CONFECOÇÃO (GABINETE INTERNO) ESPECIFICAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 304 CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO POSSUI SENSORES INTERNOS POSSUI, CAPACIDADE ATÉ 300 LITROS   2 A 5 GAVETAS   POSSUI   SISTEMA DE EMERGÊNCIA   POSSUI  REGISTRO DE DADOS   POSSUI  TEMPERATURA ENTRE MAIS 2 GRAUS CELSIUS E MAIS 8 GRAUS CELSIUS	Elber	1	UND	29.850,00	vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta reais	29.850,00	vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta reais
---	--	-------	---	-----	-----------	--	-----------	--

29.850,00
-----------

vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta reais

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA.....: R\$	29.850,00
------------------------------------	-----------

vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta reais

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.**

**PRAZO DE ENTREGA: Conforme os termos do edital**

Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretas, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM  
 À CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTIM  
 PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1916.01/2023 - BMS/PE  
 DIA E HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09 DE NOVEMBRO DE 2023 às 09h30 horas  
 DIA E HORÁRIO DA SESSÃO DE ABERTURA DE LANCES: 09 DE NOVEMBRO DE 2023 às 11h30 horas

At. Sr.(a) Pregoeiro (a)

Pelo presente instrumento, venho apresentar nossa Proposta de Escrita, relativa ao objeto do referido prego, bem como as informações especificações e as condições abaixo descritas:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE

PROPOSTA DE PREÇOS

7-2

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	V. UNITÁRIO	QUANTIDADE	V. TOTAL	EXTENSÃO TOTAL	
4	Armário Característica Fios Especificação MATERIAL DE CONFEÇÃO   DIMENSÕES   PRATELEIRAS   CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA AÇO   ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM   03 DU 04   20KG MÍNIMO DA PRATELEIRA	UND	1	MAP MOVES	RS	1.811,43	RS	1.811,43	má seiscientos e onze reais e quarenta e três centavos
VALOR TOTAL DO LOTE							RS	1.811,43	má seiscientos e onze reais e quarenta e três centavos

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação que nossa Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do Edital, supracitado e seus anexos.

Declaramos que objeto cotado atende todas as exigências do edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Outrossim declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços da proposta inicial, digital ou anexa, ou ofertados por meio de lances, estão incluídos todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos, sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas frete, seguros deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive margens de lucro.

Caso nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

- Validade da proposta: 60 (SESSENTA) dias, contados da sessão de abertura das propostas;
- Prazo de entrega: 20(VINTE) dias úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Compra.

09 de Novembro de 2023.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

AO(A) PREGOEIRO(A) DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM/CE.

PE Nº 1610.01/2023-SMS/PE

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNO	QTD	ITENS		VALOR MÉDIO UNT	VALOR MÉDIO TOTAL		
				MARCA			mil e cinquenta e seis reais	mil e cinquenta e seis reais	
4	Armário Característica Física Especificação MATERIAL DE AÇO 1 ALTURA DE 100 CONFEÇÃO A 210 CM X LARGURA DE 70 A DIMENSÕES DE 70 A PRATELEIRAS 110 CM 1 03 OU 04 CAPACIDADE 20KG MÍNIMA DA PRATELEIRA	UNO	1	ARX		R\$ 1.056,00	R\$	1.056,00	
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA							R\$	1.056,00	mil e cinquenta e seis reais

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME EDITAL.

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 20 (VINTE) DIAS, CONFORME EDITAL.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTE A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).


07 DE NOVEMBRO DE 2023.

*Handwritten signature*

# ARX

Comércio de Móveis de Aço Ltda.


## Armário em Aço - 04b

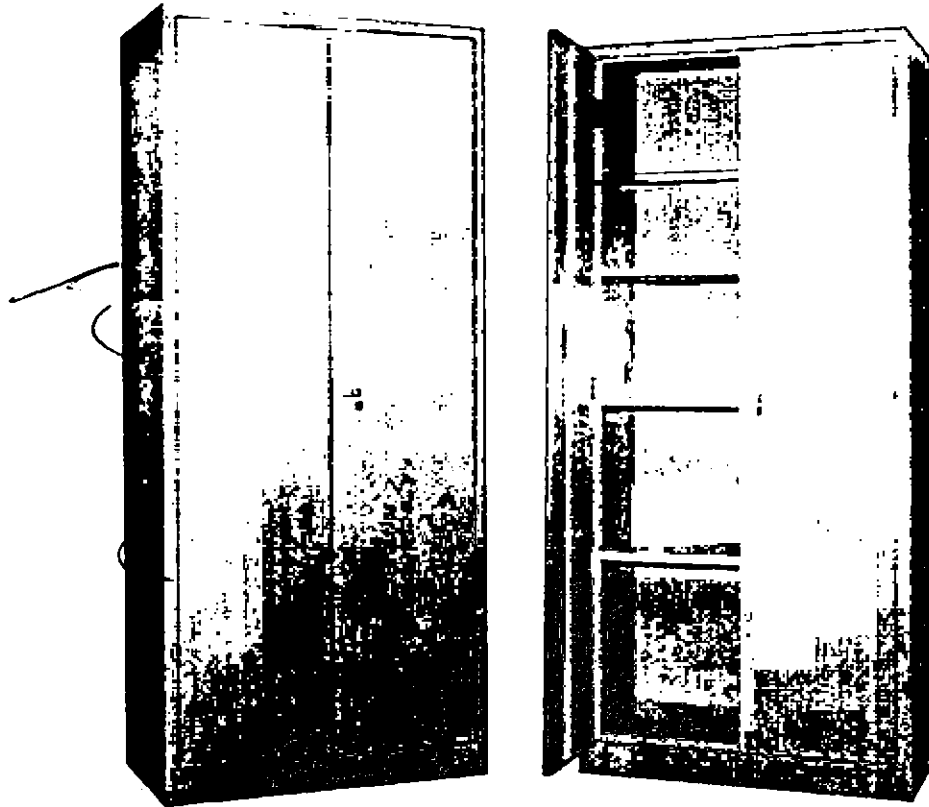

Armário em aço  
c/04 bandejas  
Cod.: Arm 04b/1,98m

Alt.: 1,98 m  
Larg.: 0,92 m  
Prof.: 0,45 m

## Armário em Aço - 03b

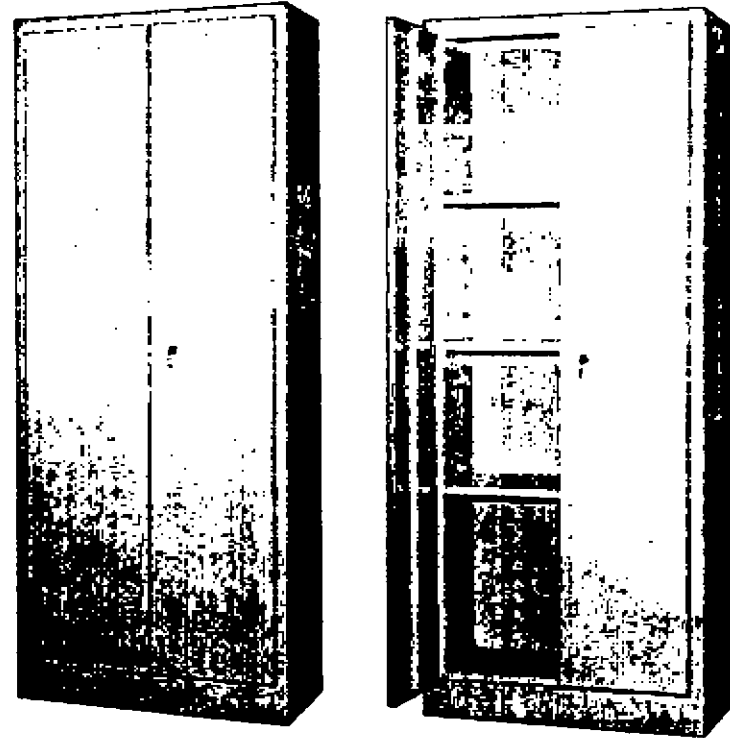

Armário em aço  
c/03 bandejas  
Cod.: Arm 03b/1,80

Alt.: 1,80 m  
Larg.: 0,75 m  
Prof.: 0,36 m

Armário em aço  
c/03 bandejas  
Cod.: Arm 03b/1,70

Alt.: 1,70 m  
Larg.: 0,70 m  
Prof.: 0,36 m

Opcional

COMISSÃO  
R\$ 12  
[Handwritten signature]



COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Nº 247  
 Rubrica

P-5

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1610.01/2023-SM/PE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM  
 AO PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA DE FORTIM  
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE

CARTA PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	VL.UNIT.		VL.TOTAL	
4	Armário Característica Física Especificação MATERIAL DE CONFEÇÃO   DIMENSÕES   PRATELEIRAS   CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA AÇO   ALTURA DE 100 A 110 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM   OS OU OS   2025	UND	W3	1	R\$ 1.056,00	mil e cinquenta e seis reais	R\$ 1.056,00	mil e cinquenta e seis reais
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							R\$ 1.056,00	mil e cinquenta e seis reais

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS


Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre os serviços referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nessa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

DATA: 09/11/23

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten marks]*

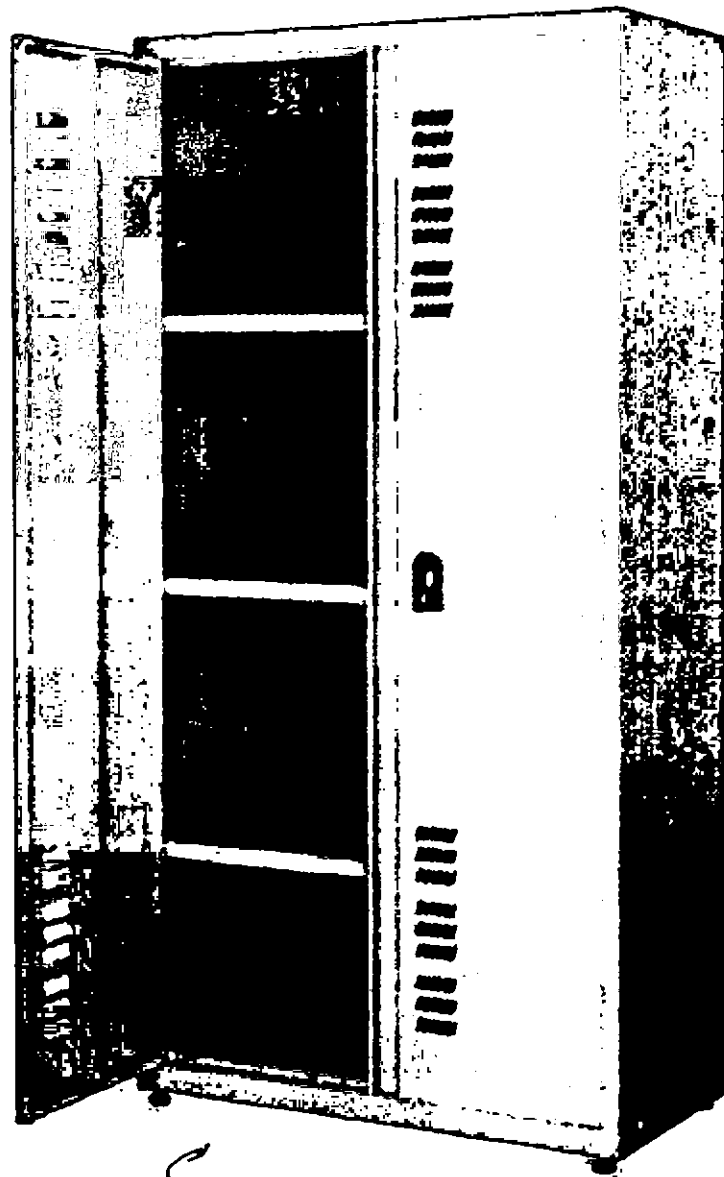

## Armário

**MATERIAL DE CONFEÇÃO**  
DE AÇO

### **DIMENSÕES**

ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM

### **PRATELEIRAS**

03 OU 04 | 20KG

### **CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA AÇO**

COM ARMÁRIO | MADEIRA OU MDF



PE N° 1610.01/2023 -SMS/PE

COMISSÃO DI  
 FI. 269  
 R. J. J. J.  
 R. J. J. J.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

À  
**PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM/CE**  
**EDITAL PARA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1610.01/23-SMS/PE**  
**OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE. DATA DE ABERTURA: 09-11-2023 | HORA DA ABERTURA: 08:30:00**

ITEM	UND	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	MODELO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
4	UND	Armário Característica Física Especificação MATERIAL DE CONFECCÃO   DIMENSÕES   PRATELEIRAS   CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA AÇO   ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM   03 OU 04   20KG	1	NEW MOBILI	ARMÁRIO BAIXO	RS 1.056,00	MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS	RS 1.056,00	MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS

A PRESENTE PROPOSTA E VALIDA CONFORME EDITAL OU ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS BENS LICITADOS/CONTRATADOS DEVERÃO SER ENTREGUES CONFORME EDITAL OU NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA EMITIDA PELA UNIDADE GESTORA, NO LOCAL DEFINIDO NA ORDEM DE COMPRA. FRETE: CIF

O OBJETO CONTRATUAL CONFORME EDITAL OU TERA GARANTIA DE 12(DOZE) MESES.

GARANTIA DOS PRODUTOS: CONFORME EDITAL OU 12 (DOZE) MESES.

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL OU ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA.

POR ESTA PROPOSTA, DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE AOS DA LEI 8.666/93. PROPONHO EXECUTAR O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, OBEDECENDO ÀS ESTIPULAÇÕES DO CORRESPONDENTE EDITAL E ÀS SUAS ESPECIFICAÇÕES, E ASSEVERANDO QUE: O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE : CONFORME EDITAL; AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO SÃO: CONFORME EDITAL; O PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO É DE ACORDO COM CONTRATO; TODOS OS COMPONENTES DE DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA, CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS RELACIONADOS COM SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E SOCIAIS, E TODOS OS DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXIGÊNCIA LEGAL OU DAS CONDIÇÕES DE GESTÃO DO CONTRATO A SER ASSINADA, ENCONTRAM-SE INCLUSOS NOS PREÇOS OFERTADOS PELA PRESENTE DECLARAÇÃO INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE OS DA LEI Nº 8.666/93 E LEI Nº 10.520/2002, BEM COMO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA; DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO, ASSUMINDO O COMPROMISSO DE BEM E FIDELMENTE EXECUTAR OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, CASO SEJAMOS VENCEDOR(ES) DA PRESENTE LICITAÇÃO LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO DOS ITENS LICITADOS, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO. DECLARAMOS DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; DECLARAMOS DE QUE O PROPONENTE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA PROPOSTA DE PREÇOS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO EDITAL. O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA DESTA EDITAL. INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM: - ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; - TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁIS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES; - SEGUROS EM GERAL, DA INFORTUNISTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUALQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI Nº 10.520, DE 03 DE SETEMBRO DE 2002, LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO SUPRACITADA, NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETOS DESTA LICITAÇÃO; QUE SE COMPROMETE A FORNECER INFORMAÇÕES ADICIONAIS, SOLICITADAS PELO(A) PREGOEIRO(A) OU PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMO: LAUDOS TÉCNICOS DE ANÁLISES DO PRODUTO, CATÁLOGOS, E OUTROS, A QUALQUER TEMPO E/OU FASE DO PROCESSO LICITATÓRIO, COM FINALIDADE DE DIRIMIR DÚVIDA E INSTRUIR AS DECISÕES RELATIVAS AO JULGAMENTO. NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETOS DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL; DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, GARANTIA DO MATERIAL, TARIFAS CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE O OBJETO DA PRESENTE AQUISIÇÃO. DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

DATA: 09/11/2023

*M* *U*

AO(A) PREGOEIRO(A) DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM/CE.

PE Nº 1610.01/2023-SMS/PE

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR MÉDIO UNIT	VALOR MÉDIO TOTAL
5	<p>Computador (Desktop-Sistema)            Especificação Técnica            especificação mínima, que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 núcleos, 8 threads e frequência de 3.3 GHz. Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos slots de 4 GB cada, de tipo SDRAM DDR4 2666MHz. Não suporta: coponudo em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MINICOMBT, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formadores.org, organismo que define as padrões nacionais. Passar pelo menos 3 slots PCI-EXPRESS 3.0 x 16 ou superior. Passar sistema de detecção de vírus de arquivos, com atestado registrado no governo. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Passar superior ao INTEL HD GRAPHICS 630 ou superior. Passar monitor estereótipo. Passar no mínimo 2 slots de vídeo, sendo pelo menos 1 digital de tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade convenida de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, sem fio. Monitor de LED 19 polegadas (resolução 16:9) (1366 x 1080 a 60Hz), entrada de vídeo HDMI e display PORT. Argolas de vídeo vertical e horizontal mínimo de 1789. Inclinacao de rede 90/100/180 e 180 graus. IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Nome comercial e que superior todo o configuração mínima no item. Gabinete e partes deve funcionar no vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados sistema, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradação neutro das cores branco, preto ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes de produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.</p>	UND	1	JAB	R\$ 4.624,00	R\$ 4.624,00
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA						R\$ 4.624,00

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME EDITAL.

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 30 (VINTE) DIAS, CONFORME EDITAL.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTE A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

07 DE NOVEMBRO DE 2023.

*Ju*

*C*



PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Descrição Especificação	Qtd	Marca Modelo	Und	Preço Unitário	Preço Total
05	<p>Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que computador desktop</p> <p>possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe</p> <p>M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site <a href="http://www.formfactors.org">www.formfactors.org</a>, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot</p> <p>PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de Intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo Integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNTZ, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no Item.</p> <p>Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondiçãoamento.</p>	1	Própria BR200/ I3 10100F	UN	R\$ 4.624,00	R\$ 4.624,00

7.3

**TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 4.624,00 Quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais**

Prazo de Validade da Proposta: A proposta vigorará pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias corridos, contados da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº. 8.666/93 e art. 6º da Lei nº. 10.520, de 17-07-2002.

Prazo de Entrega dos Equipamentos: Conforme edital;

Prazo Contratual: Conforme edital;

Prazo de Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e instalação dos materiais e equipamentos, contados da entrega e instalação dos mesmos, podendo chegar a 36 (trinta e seis), na categoria On Site ou conforme o edital solicitar;

Declaramos, para devidos fins:

Que nesta proposta estão inclusos todos os impostos, taxas, fretes, seguros e encargos trabalhistas;

Atende plenamente aos requisitos estabelecidos no presente edital, referente aos objetos ofertados do Pregão Eletrônico;

Que o(s) objeto(s) ofertados atendem todas as especificações descritas neste Edital.

Que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

MC

U

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
252  
FIS.

Que a empresa está ciente que deve seguir os padrões de segurança adequados ao uso de dados pessoais de que trata a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

Concórdia, 08 de novembro de 2023.

✓

✓

✓


PROPOSTA DE PREÇOS

up-5

A  
 PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM/CE  
 EDITAL PARA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1618.01/23-SMS/PE  
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE. DATA DE ABERTURA: 09-11-2023 | HORA DA ABERTURA: 08:30:00

ITEM	UND	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	MODEL	VALOR UNITARI	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TOTAL
5	UND	<p>Computador (Desktop-Básico)            Especificação Técnica especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site <a href="http://www.formfactors.org">www.formfactors.org</a>, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x 16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas</p>	1	GOLDENTE C	13 GT	R\$ 4.624,00	QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS	R\$ 4.624,00	QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS



	<p>com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir graduações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondição</p>										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Handwritten mark*

A PRESENTE PROPOSTA É VALIDA CONFORME EDITAL OU ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS BENS LICITADOS/CONTRATADOS DEVERÃO SER ENTREGUES CONFORME EDITAL OU NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA EMITIDA PELA UNIDADE GESTORA, NO LOCAL DEFINIDO NA ORDEM DE COMPRA. FRETE: CIF


O OBJETO CONTRATUAL CONFORME EDITAL OU TERA GARANTIA DE 12(DOZE) MESES.

GARANTIA DOS PRODUTOS: CONFORME EDITAL OU 12 (DOZE) MESES.

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL OU ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA.

POR ESTA PROPOSTA, DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE AOS DA LEI 8.666/93. PROPONEMOS EXECUTARMOS O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, OBEDECENDO ÀS ESTIPULAÇÕES DO CORRESPONDENTE EDITAL E AS SUAS ESPECIFICAÇÕES, E ASSEVERANDO QUE: O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE : CONFORME EDITAL; AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO SÃO: CONFORME EDITAL; O PRAZO DE ENTREGA/ EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO É DE ACORDO COM CONTRATO; TODOS OS COMPONENTES DE DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA, CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS RELACIONADOS COM SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E SOCIAIS, E TODOS OS DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXIGÊNCIA LEGAL OU DAS CONDIÇÕES DE GESTÃO DO CONTRATO A SER ASSINADO, ENCONTRAM-SE INCLUSOS NOS PREÇOS OFERTADOS PELA PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE OS DA LEI Nº 8.666/93 E LEI Nº 10.520/2002, BEM COMO AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA; DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEDIRIA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO. ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE EXECUTAR OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, CASO SEJAMOS VENCEDORES) DA PRESENTE LICITAÇÃO LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETE, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO DOS ITENS LICITADOS, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO. DECLARAMOS DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; DECLARAMOS DE QUE O PROPONENTE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA PROPOSTA DE PREÇOS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO EDITAL. O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I PROJETO BÁSICO TERMO DE REFERÊNCIA DESTA EDITAL. - INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM: - ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; - TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRACÇÕES; - SEGUROS EM GERAL, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUALQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI Nº 10.520, DE 03 DE SETEMBRO DE 2002, LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO SUPRACITADA. NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETOS DESTA LICITAÇÃO; QUE SE COMPROMETE A FORNECER INFORMAÇÕES ADICIONAIS, SOLICITADAS PELO(A) PREGOZEIRO(A) OU PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMO: LAUDOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DO PRODUTO, CATÁLOGOS, E OUTROS, A QUALQUER TEMPO E/OU FASE DO PROCESSO LICITATÓRIO, COM FINALIDADE DE DILIMIR DÚVIDA E INSTRUIR AS DECISÕES RELATIVAS AO JULGAMENTO. NESTA OPORTUNIDADE,

*Handwritten mark*

Rubrica  
  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Fls. 254  
Rubrica

TEMOS A DECLARAR, SOB AS PNEAS DA LEI QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETOS DESTA LICITAÇÃO, QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTES CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL; DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, GARANTIA DO MATERIAL, TARIFAS CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE O OBJETO DA PRESENTE AQUISIÇÃO. DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

DATA: 09/11/2023

AC(A) PROCESSO(A) DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM/CE.

PE Nº 3618.01/2023-SMS/PE

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR MÉDIO UNT	VALOR MÉDIO TOTAL
6	Balde e Pedal Característica Física MATERIAL DE CONFEÇÃO I CAPACIDADE	UND	1	MOR	R\$ 327,00	R\$ 327,00
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA						R\$ 327,00

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME EDITAL.

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 20 (VINTE) DIAS, CONFORME EDITAL.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTE A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTES LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

07 DE NOVEMBRO DE 2023.

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*


*[Assinatura]*

COMISSÃO DI  
256  
Fis  
Rubrica  
Civ



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten marks]*

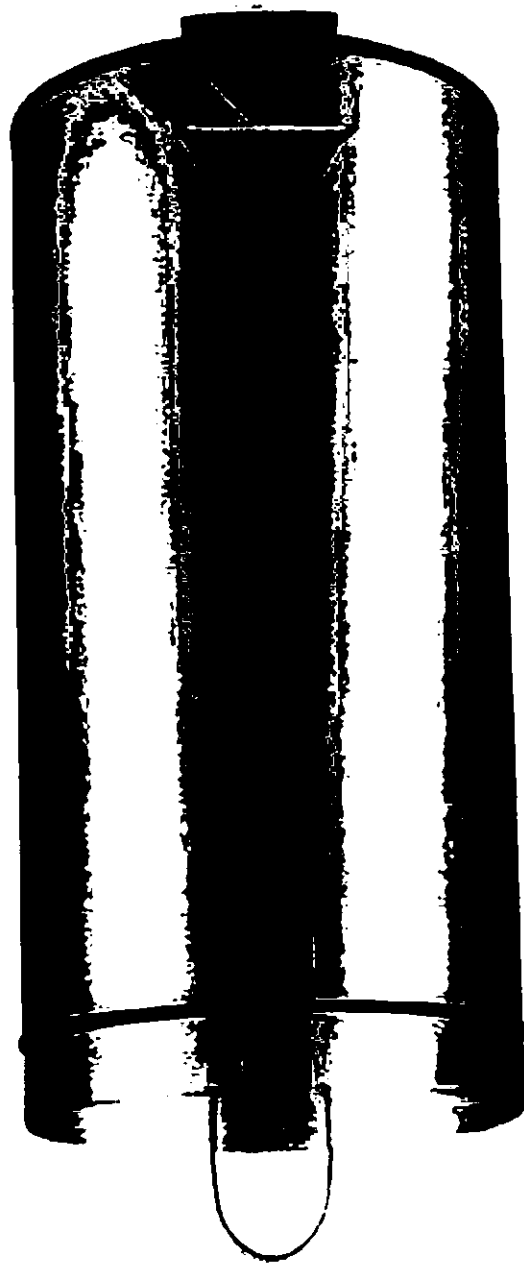

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Fis. 25X  
Rubrica




10

2

1

COMISSAO DE LICITACAO  
254  
RUBICA

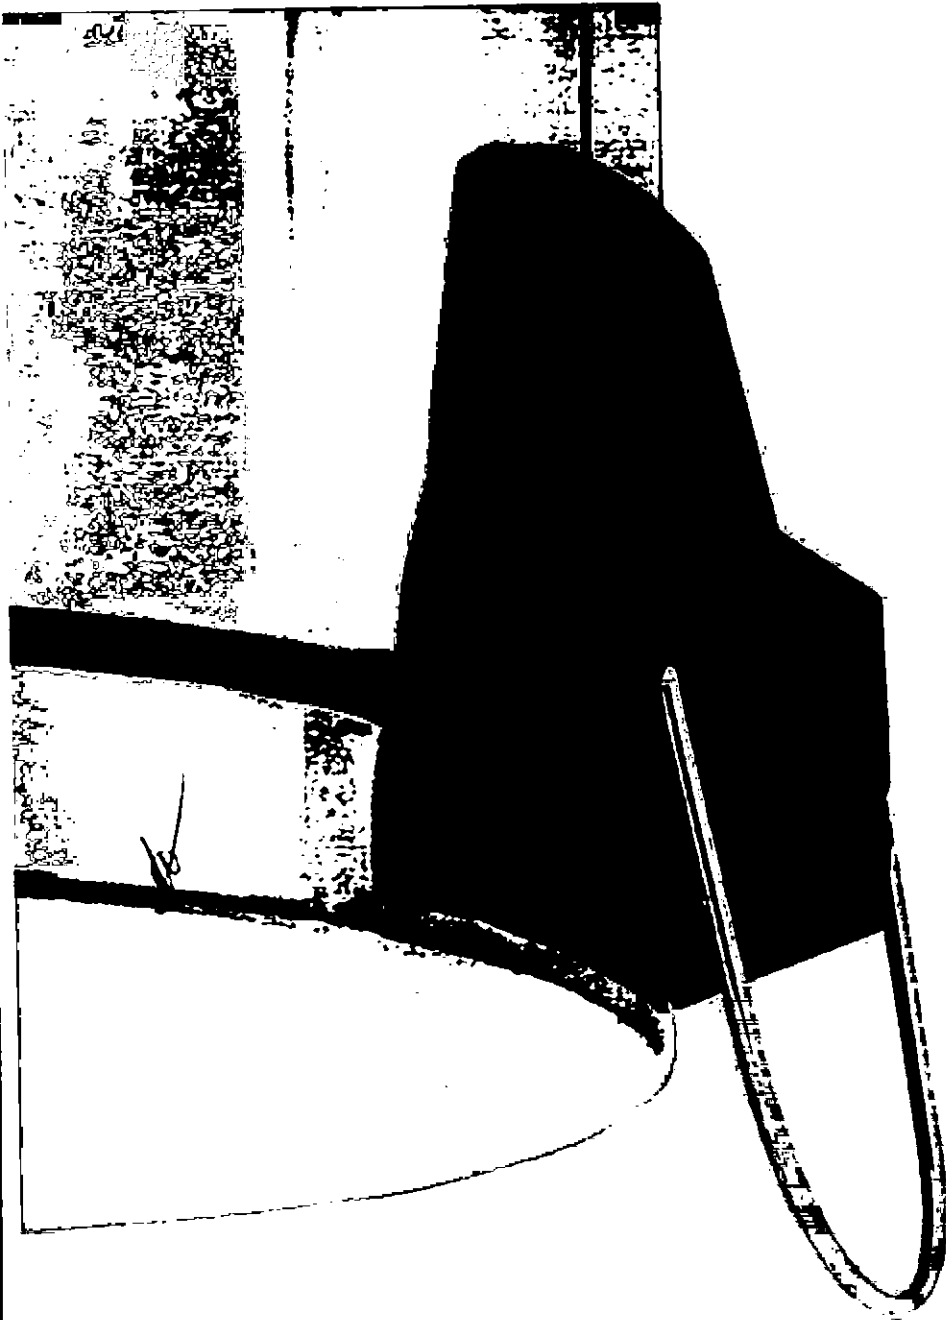

me

2

COMISSAO DE LICITACAO  
Fls. 258  
Rubrica


*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



COMISSAO DE LICITACAO  
2580  
RUBRICA

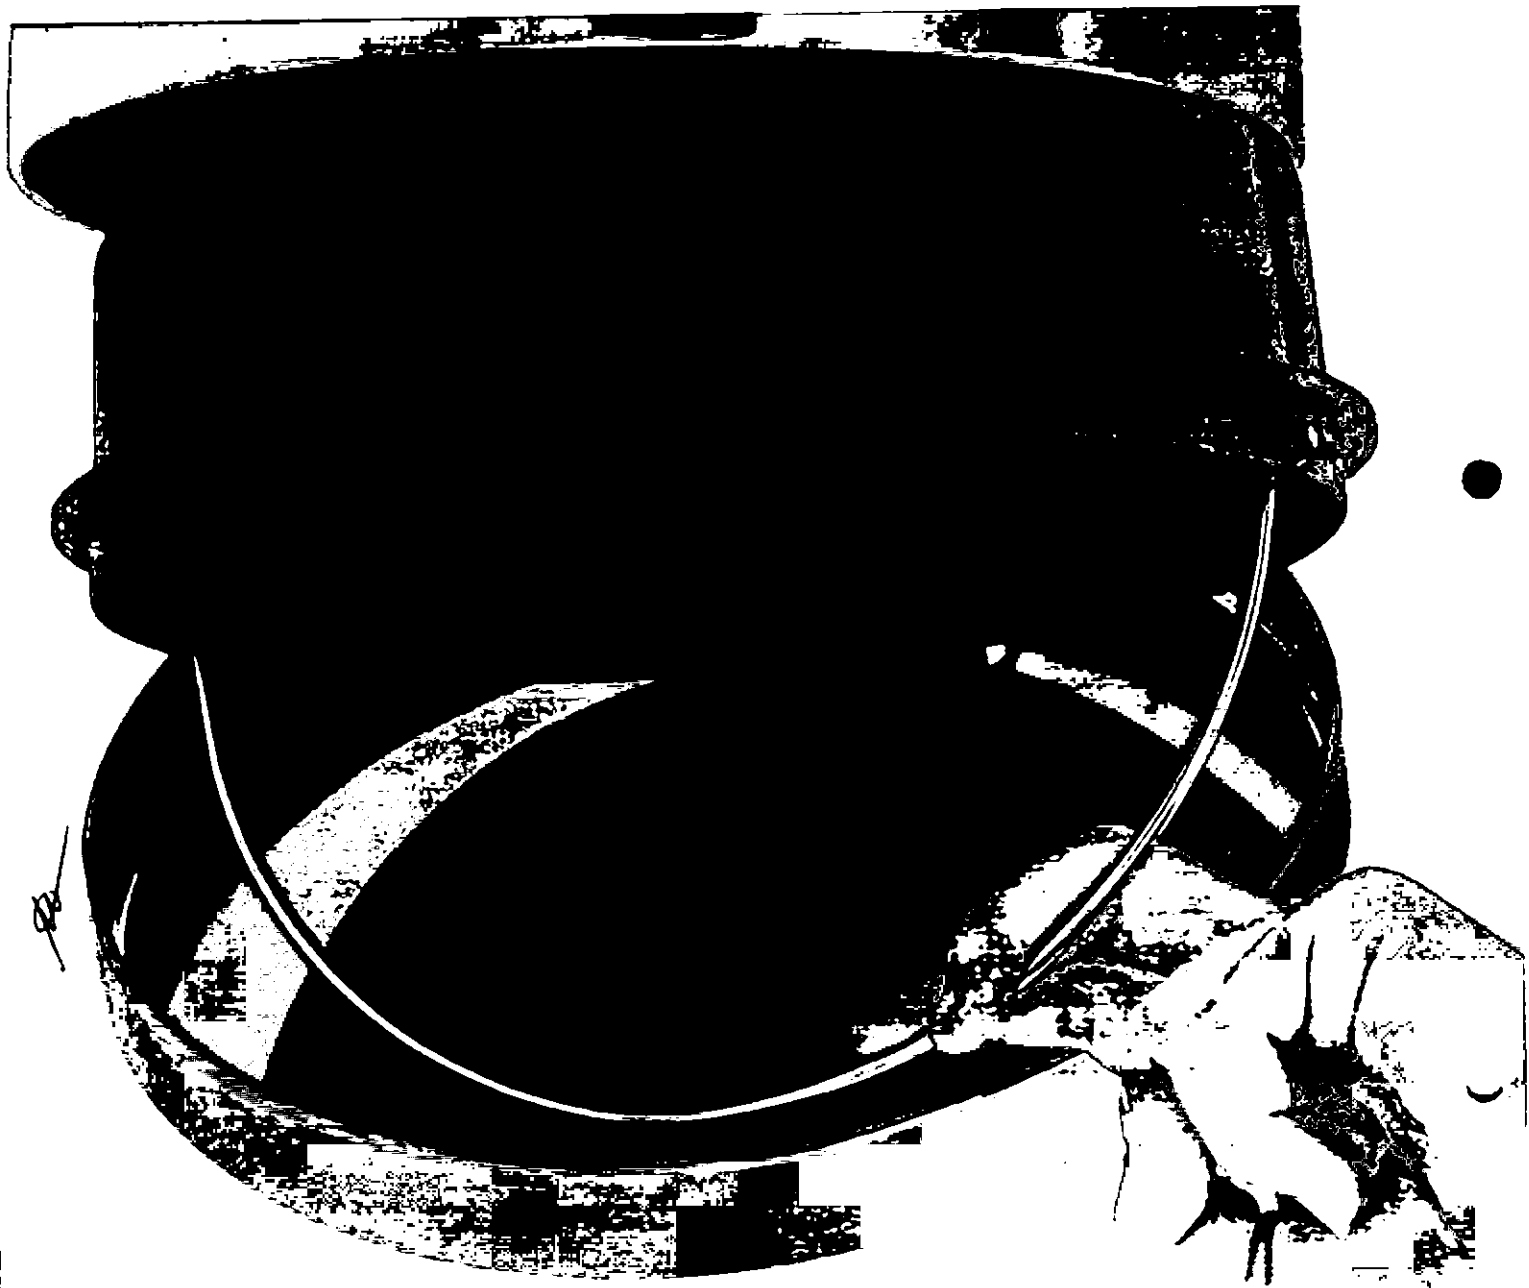

je

e

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM  
 A CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTIM  
 PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1616.01/2023 - SIS/PE  
 DIA E HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09 DE NOVEMBRO DE 2023 às 09h30 horas  
 DIA E HORÁRIO DA SESSÃO DE DEPUTA DE LANCES: 09 DE NOVEMBRO DE 2023 às 11h30 horas



AL. Sr(a) Pregoeiro(a):

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta de Escrita, relativa ao objeto do referido prego, bem como as informações especificações e as condições abaixo descritas:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE.

P-2

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	V. UNITÁRIO	EXTENSÃO VALORES	V. TOTAL	EXTENSÃO TOTAL
6	Balão a Pedal Característica Flutuante Especificação MATERIAL DE CONFECCÃO CAPACIDADE AÇO INOX   DE 30L ATÉ 48L CAPACIDADE MOD. LIGERA Q/TAMPA 30x40 CNP 30L TS	UND	1	ECOBIN	R\$ 328,08	Inscritos e vltos e oito reais e oito centavos	R\$ 328,08	Inscritos e vltos e oito reais e oito centavos
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>							<b>R\$ 328,08</b>	
Inscritos e vltos e oito reais e oito centavos								

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação que nossa Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do Edital, supracitado e seus anexos.

Declaramos que objeto cotado atende todas as exigências do edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Outrosim declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços da proposta inicial, digital ou anexa, ou ofertados por meio de lances, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos, sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive margem de lucro.

Caso nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

- a) Validade da proposta: 60 (SESENTA) dias, contados da sessão de abertura das propostas;
- b) Prazo de entrega: 20(VINTE) dias úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Compra.

09 de Novembro de 2023.

AGÊNCIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE FORTIMA/CE.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIMA/CE.

PE Nº 2018.01/2019-006/PE

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIMA.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR MÉDIO UNT	VALOR MÉDIO TOTAL
7	No-Break (Para Computador/Impressora) Especificação Técnica Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria Interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.	UND	1	RAGTECH	R\$ 1.022,00	R\$ 1.022,00
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA						R\$ 1.022,00

7-3

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS, CONFORME EDITAL.

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 20 (VINTE) DIAS, CONFORME EDITAL.


DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTE A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

07 DE NOVEMBRO DE 2019.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

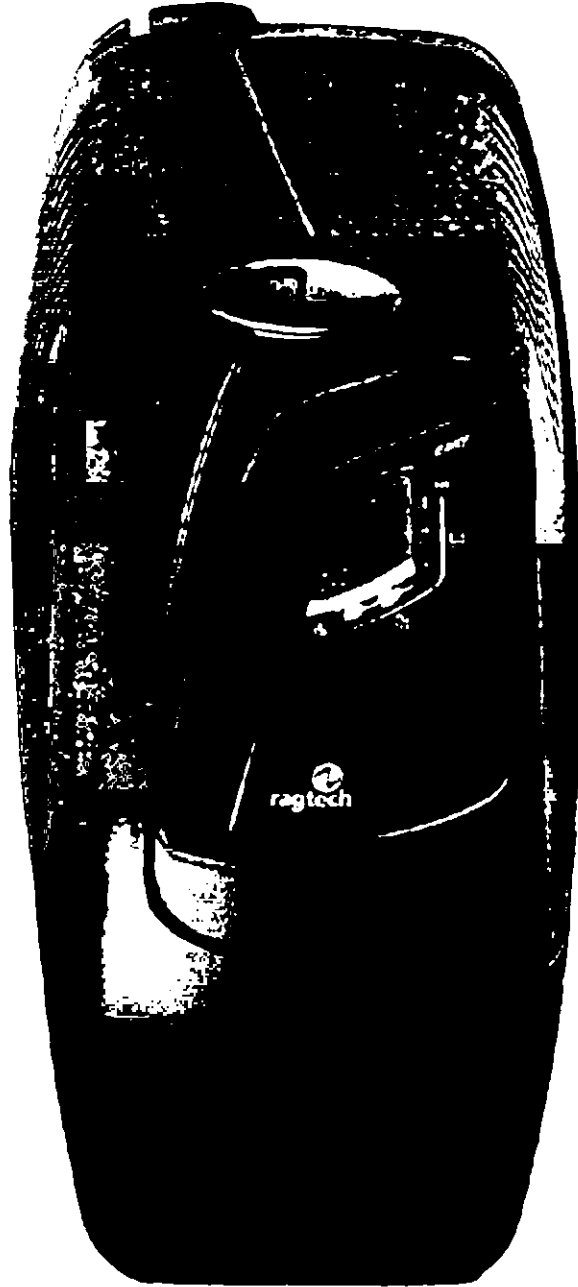

✓


✓

✓

COMISSAO DE LICITACAO  
RUBRICA

261V

RUBRICA

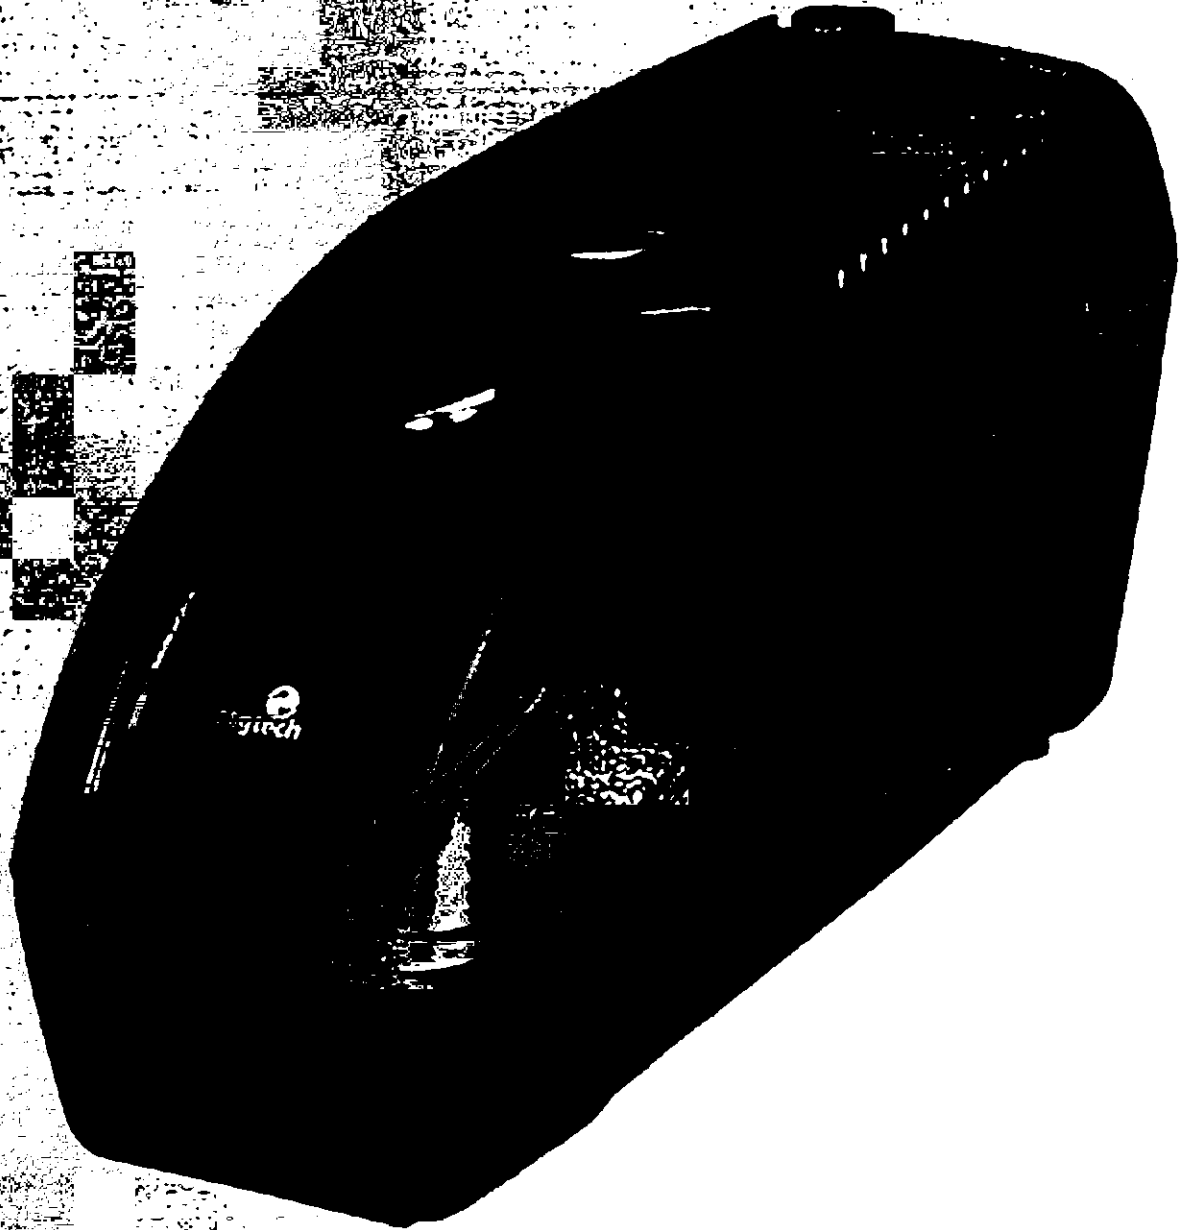


C

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


COMISSAO DE LICITACAO  
Fls. 262  
Rubrica

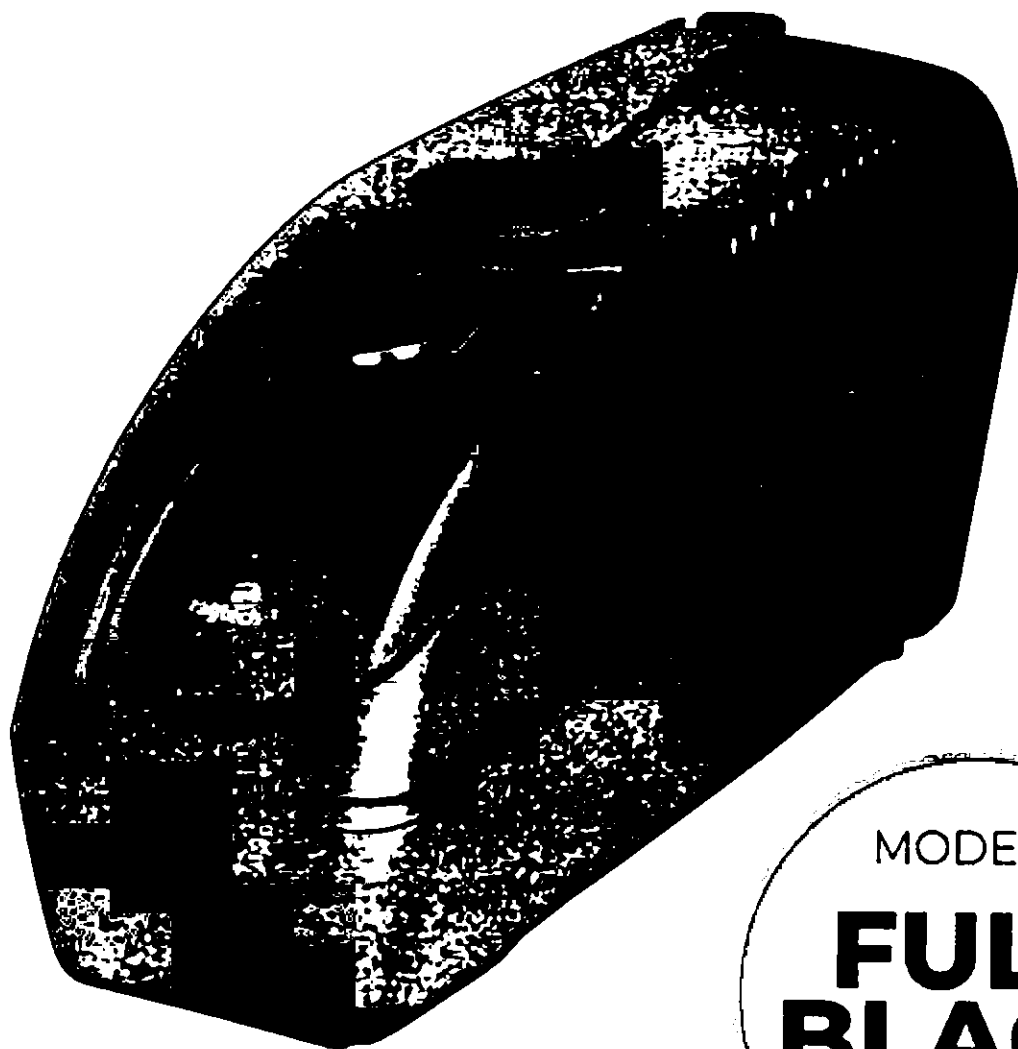

MODELO  
**FULL  
BLACK**

v / e


COMISSÃO LICITADA  
RUBRICA

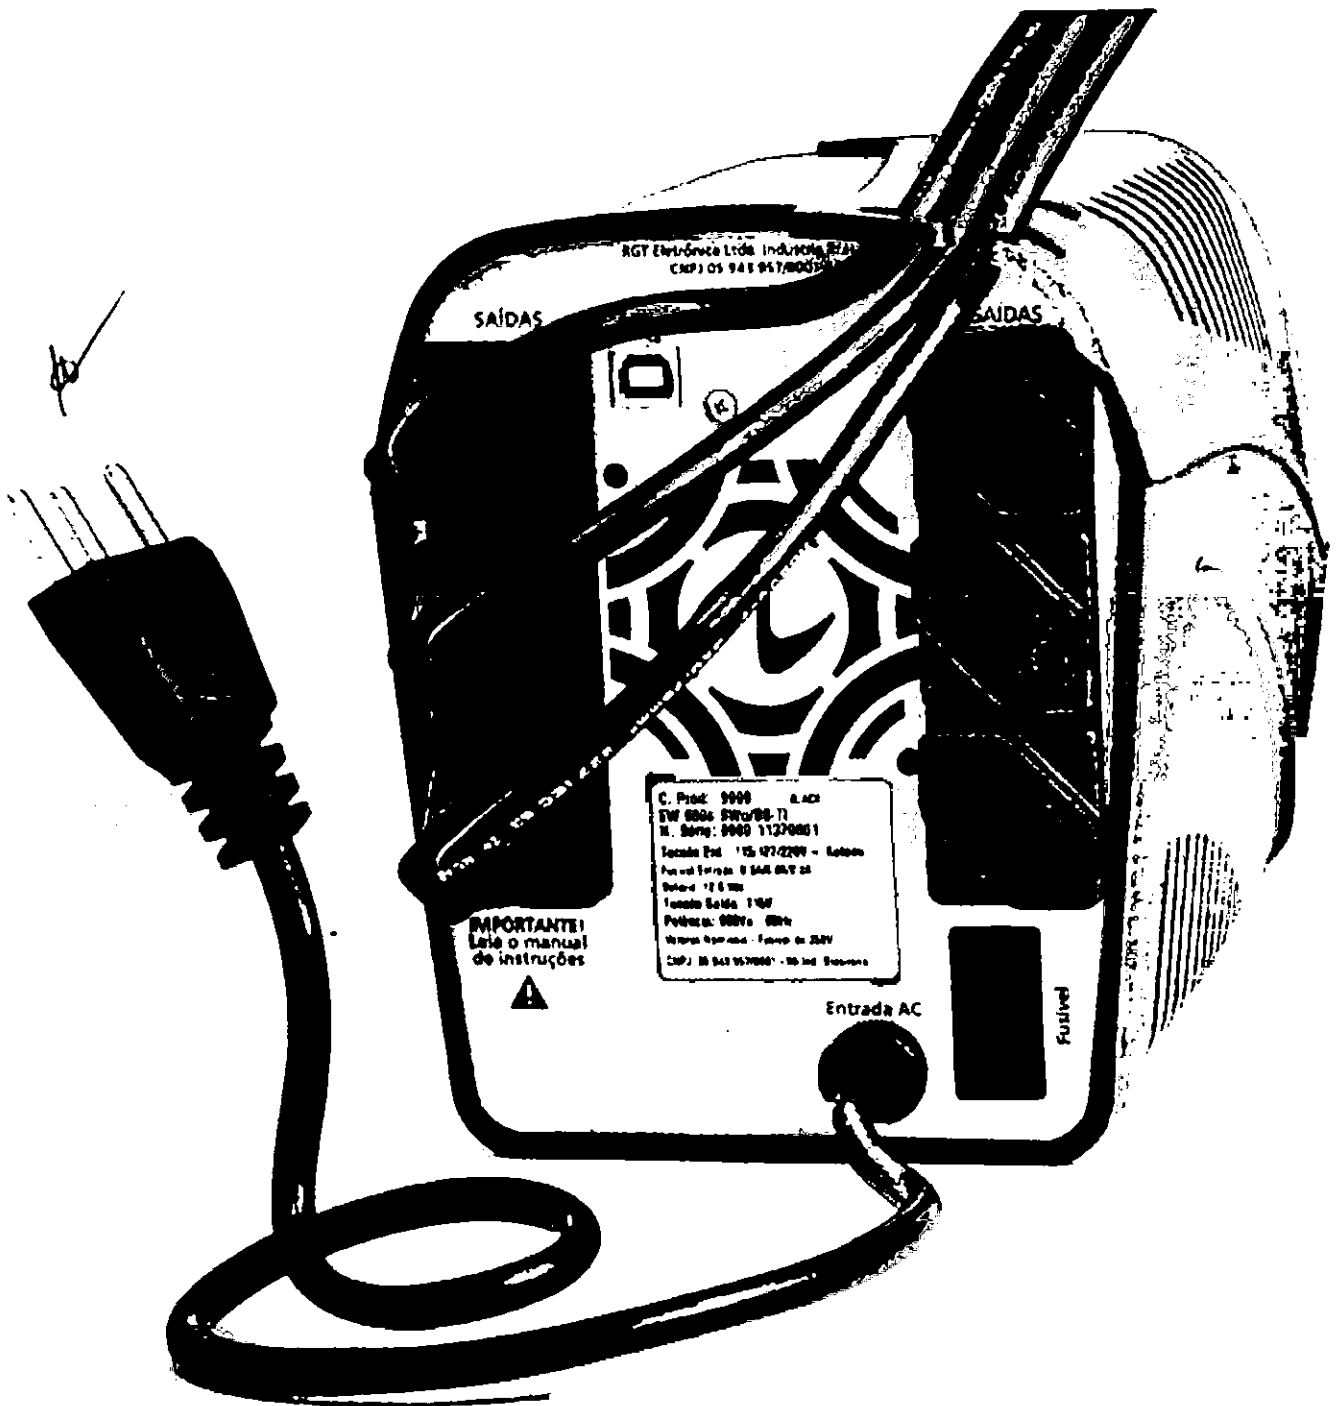

2

1

✓

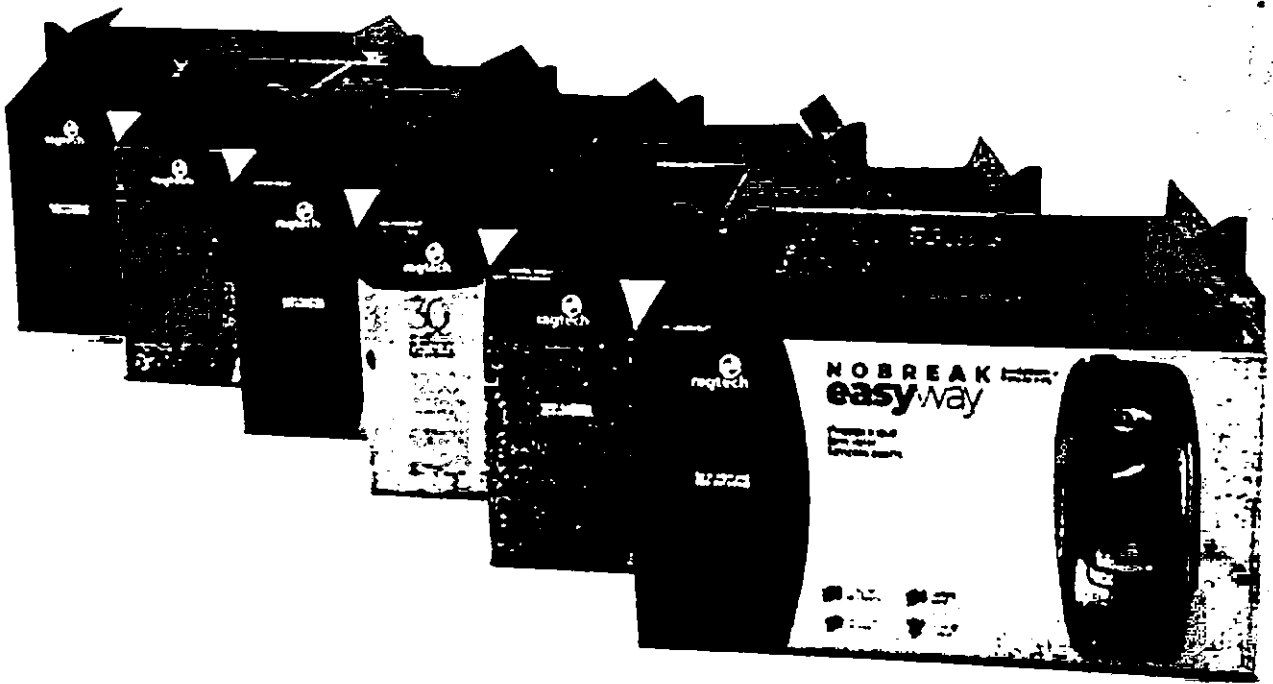

✓

✓



*[Handwritten signature]*  
 Fabrica

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1610.01/2023-SMIL/PE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM  
 AO PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA DE FORTIM  
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE.

P-5

CARTA PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	QTD	VL.UNIT.		VL.TOTAL	
7	No-break (Para Computador/Impressora) Especificação Técnica Especificação mínima que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,1 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em correntes alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possui, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.	UNID	GOLDENTEC	1	R\$ 1.022,00	mil e vinte e dois reais	R\$ 1.022,00	mil e vinte e dois reais
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b>						<b>R\$</b>	<b>1.022,00</b>	mil e vinte e dois reais

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: 30 (VINTE) DIAS ÚTEIS

Declaramos que nas preçõs ofertadas estão incluídas todas as despesas incidentes sobre os serviços referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).


DATA: 09/11/23

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*


O Nobreak Goldentec está pronto para proteger seus equipamentos! Evite que as quedas de energia afetem a performance e garanta uma maior eficiência energética para seus aparelhos! Com 1200 VA de potência, o No Break Goldentec protege os equipamentos desde pequenas falhas até a queda total de energia. Com 30 minutos de autonomia, você tem tempo para salvar seus documentos e desligar seus equipamentos de forma segura

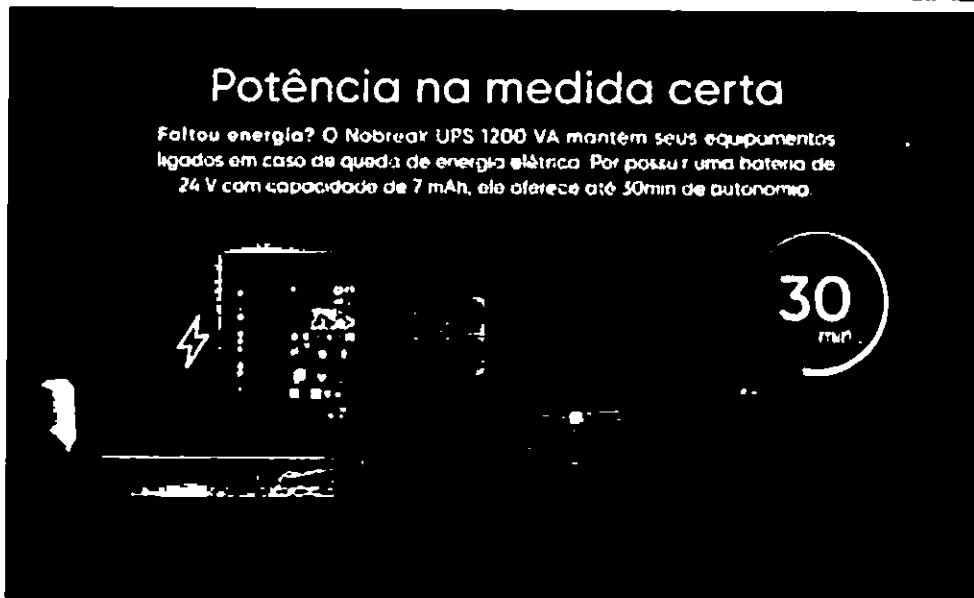

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
265V.  
Rubrica

# Equipamentos sempre funcionando

Com 6 tomadas de saída alimenta seus equipamentos e garante uma perfeita autonomia em caso de falha da rede elétrica.

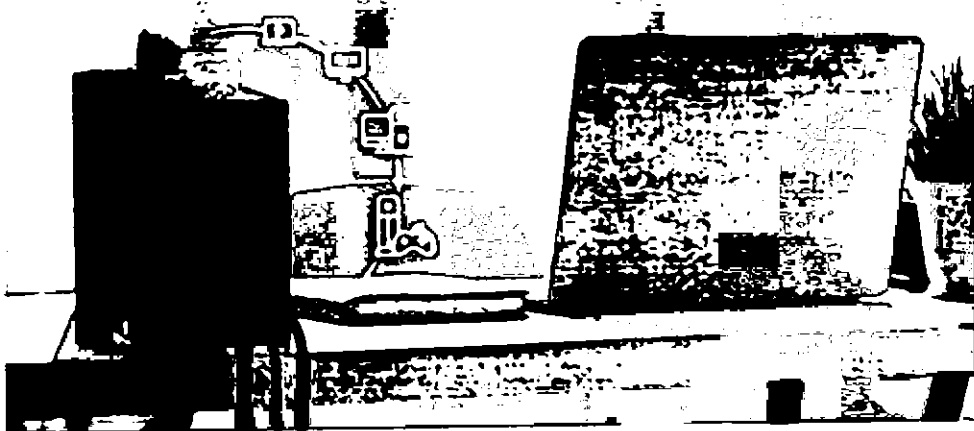

## 4 níveis de proteção



Queda de rede

Ruído de rede elétrica

Sobretensão


Subtensão

## Para sua casa ou escritório

O Nobreak UPS 1200 VA é perfeita para diversas cenários de aplicações como: rede doméstica ou de pequena porte (modem, roteador, computadores desktop), segurança (gravador de vídeo, câmera, sistema de alarme), PDV (impressora fiscal, máquina de cartão) e telecom (PABX, media gate-way, terminais).



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Marca:	Goldentec
Cor	Preta
Proteção	Queda de rede Ruído de rede elétrica Sobretensão Subtensão
Potência	1200 VA
Potência nominal ativa	600 W
Tensão de entrada	Bivolt
Tensão de saída	120 V
Onda	Senoidal simulada
Saídas	6
Fusível	Resetável
Variação de tensão	190 VAC - 262 VAC
Forma de onda de saída	PWM
Tensão da bateria	24 V
Capacidade da bateria	7 Ah
Autonomia	30 minutos
Dimensões	12,3 x 34,5 x 18,9 cm
Conteúdo da Embalagem	1 Nobreak 1 Manual de Instruções