

Participante 1

Nome do documento	Ação
FICHA TÉCNICA P.E FORTIM 1406.012024SMS.pdf	

Edital: 1406.01/2024SMS | Lote: 7

Marca	SANTA CLARA
Data	28/06/2024 09:59:50.833
Prazo de Validade da Proposta	60 dias



Informações sobre preços e marcas					
Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário <small>(Valor Inicial Global)</small>	Valor Final Unitário <small>(Valor Final Global)</small>	Marca
FOCO DE LUZ CLINIC	1	Unidade	R\$ 758,80 <small>(R\$ 758,80)</small>	*	SANTA CLARA
TOTAL DO LOTE			R\$ 758,80		

DECLARAÇÕES:


- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitada da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.

Participante 3

Nome do documento	Ação
catalogos Fortim_compressed.pdf	

Edital: 1406.01/2024SMS | Lote: 7

Marca renascer/rn14026r
 Data 01/07/2024 | 14:54:20.734
 Prazo de Validade da Proposta 60 dias



Informações sobre preços e marcas


Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
FOCO DE LUZ CLINK	1	Unidade	R\$ 761,00 (R\$ 761,00)	-	renascer/rn14026r
TOTAL DO LOTE			R\$ 761,00		

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.
- Declaramos que estamos organizados em cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
- Declaramos que estamos enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

Nome do documento	FOCO DE LUZ MIKATOS 009CLIN.pdf	Ação
-------------------	---------------------------------	------


Edital: 1406.01/2024SMS Lote: 7	
Marca	mikatos
Data	01/07/2024 17:01:12.29
Prazo de Validade da Proposta	60 dias



Informações sobre preços e marcas					
Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
FOCO DE LUZ CLINIK	1	Unidade	R\$ 761,00 (R\$ 761,00)	-	mikatos
TOTAL DO LOTE					

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas Infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.
- Declaramos que estamos enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

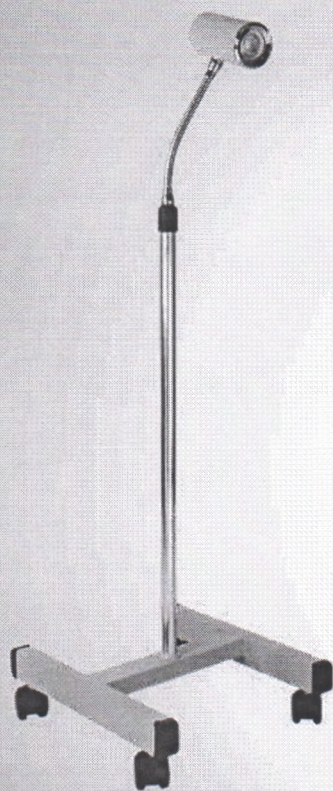

Vital
SCHEFFER



FOCO DE LUZ MIKATOS - 009CLIN

Especificações


- O Foco Clínico Portátil Mikatos é o equipamento que auxilia a equipe médica durante os procedimentos clínicos e ambulatoriais, usado para iluminar o campo sob visualização através da luz de alta qualidade emitida pela iluminação.
- Facilitam sua locomoção de um local para o outro, Tubo Articulado (Flexível) que propicia o direcionamento do foco de luz fria;
- Foi projetado de tal forma a manter a funcionalidade e praticidade através de rodízios o que aplicável a vários procedimentos. Por exemplo, quando se trata do aparelho reprodutor feminino, funciona como foco ginecológico;
- Iluminação: Luz Branca (Branco Frio);
- Tensão Elétrica: V (Volts);
- Entrada: 100 – 240 Vca (Corrente alternada – variável);
- Saída: 12 Vcc (Corrente contínua);
- Potência Elétrica: 3,0 W (Watts) ;
- Fluxo Luminoso: 270 Lm (Lúmens) – Corresponde a 20.000 Lux;
- Temperatura de Cor: 6.000 – 6.500 K (Kelvin) ;
- Vida Útil: 20.000 h (horas – mínima);
- Regulagem da altura: 1,05 m a 1,40 m (metro);

Participante B

Nome do documento	Ação
ANEXO_LOTE7.pdf	

Edital: 1406.01/2024SMS | Lote: 7

Marca	MEDPEJ
Data	01/07/2024 18:03:52.944
Prazo de Validade da Proposta	60 dias



Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
FOCO DE LUZ CLINIK	1	Unidade	R\$ 761,00 (R\$ 761,00)	-	MEDPEJ
TOTAL DO LOTE					

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.



AO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PE Nº1406.01/2024
ABERTURA: 02/07/2024 Às 8:30
DISPUTA: 02/07/2024 ÀS 10:30

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA - HMWA CONFORME PROPOSTA Nº 10295311000124011 E PORTARIA GM/MS Nº 3.747, DE 07 DE MAIO DE 2024 QUE AUTORIZA O MUNICÍPIO A RECEBER RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO ACIMA CITADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTIM/CE.

PROPOSTA

LOTE	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTDE	VL.UNIT.	VL.TOTAL
7	FOCO DE LUZ CLINICO FOCO DE LUZ CLÍNICO E GENECOLÓGICO	UND	MEDPEJ	1	R\$ 761,00	R\$ 761,00
VALOR TOTAL DO ITEM						R\$ 761,00
						setecentos e sessenta e um reais
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						R\$ 761,00
						setecentos e sessenta e um reais

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) dias uteis

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro;
Declaramos que cumprimos os requisitos para a habilitação e a conformidade de nossa proposta com as exigências do edital.


DATA: 02/07/24

Participante 5

Nome do documento	Ação
ITEM 9_ Descritivo do Fabricante_Monitor VITA 1100e.pdf	

Edital: 1406.01/2024SMS | Lote: 9

Marca	ALFA MED / VITA 1100E
Data	01/07/2024 14:49:11.805
Prazo de Validade da Proposta	60 dias



Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
MONITOR MULTIPAI	2	Unidade	R\$ 12.629,00 (R\$ 25.258,00)	-	ALFA MED / VITA 1100E
TOTAL DO LOTE					

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.



Monitor Multiparamétrico – VITA 1100e
Fabricante: Alfa Med
Procedência: Nacional
Registro Anvisa: 80629370011

O Vita 1100e é uma solução com alta precisão e qualidade, fácil manuseio, interface modular intercambiável, e características especialmente otimizadas para UTI e Bloco. Permite monitoramento durante o transporte externo ou interno e aplicável inclusive em procedimentos de alta complexidade.

Parâmetros: ECG 3/7 Derivações, Resp., SpO2, FP, Temp. (2 canais), PNI

Características:

- Tela TFT LCD colorida de 12,1" (800 × 600) touch screen - Velocidade de Varredura: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50mm/s.
- Exibição de pelo menos 13 curvas simultâneas com valores digitais;
- Indicadores: alarme, status da alimentação, status da bateria, Bip de QRS e alarme sonoro;
- Display e processador em bloco único;
- Armazenamento de dados: Tendências gráficas e numéricas tabulares de até 150 horas, 1200 conjuntos de análise de medições de PNI, 200 conjuntos de análise de alarmes, 200 conjuntos de eventos de arritmias;
- Autonomia de bateria ≥10 h;
- Alarmes audiovisuais ajustáveis com três níveis de prioridade com limites máximo e mínimo para todos parâmetros programáveis pelo usuário;
- Alarmes funcionais para sensor, bateria, rede, etc;
- Menu de configuração acessível através de teclado membrana ou botão giratório;
- Estrutura Modular com possibilidade de conexão de rack para extensão de gabinetes de módulos;
- Possibilidade de inserção de módulos futuros intercambiáveis pelo usuário tais como analisador de gases, BIS, EEG, TNM, pressão invasiva (8 canais), débito cardíaco por termodiluição, débito cardíaco contínuo (ICG), Respiração Mecânica (RM), Variação da Pressão de Pulso (VPP), Capnografia Sidestream/Mainstream, Oximetria Nellcor, ECG 12 derivações;
- Possibilidade de inserção de Impressora em 3 canais de impressão;
- Sistema de alarme para desconexão de módulo;
- Captura automática dos parâmetros fisiológicos;
- Comunicação bi-direcional com central de monitoramento através de rede ethernet e ou WIFI;
- Comunicação com outros monitores (Leito-a-Leito) via rede local sem a necessidade de uma central de monitoramento;
- Possibilidade de comunicação protocolo HL7 bidirecional;
- Possui modo DEMO com senha para treinamento dos usuários;
- Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi;
- Possui memória constante para armazenagem das configurações;
- Menu único para acesso e exibição simultânea de todos alarmes dos parâmetros monitorados para configuração do usuário;
- Sistema de auto teste e software em português;
- Sistemas de alarme ininterruptos conforme NBR IEC 60601-1-2-49;
- Alimentação: Bivolt automático 100 a 240Vac 50/60hz;
- Proteção IPX1;
- Faixa de operação de Umidade: 15 a 95%;

Interface

Porta USB (4 conexões)
Saída VGA
Interface DVI
Conexão RS232
Conexão de rede padrão
Saída de sinal analógico
Saída de sinal de chamada de enfermeira
Conexão de Cartão SD

Conexão para trava antifurto
Trava de segurança de alimentação
Terminal de aterramento equipotencial



ECG 3/5 Vias

5 Vias: R, L, N, F, C (IEC) ou RA, LA, RL, LL, V (AHA);

Forma de Onda de ECG: Exibição simultânea de até 7 derivações na tela;

Possibilidade de exibição simultânea de 12 derivações com cabo paciente de 10 vias. (opcional)

Seleção de Ganho: x0,125 (1,25mm/mv); x0,25 (2,5mm/mv); x0,5 (5mm/mv); x1 (10mm/mv); x2 (20mm/mv); Auto.

Velocidade de Varredura: 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50mm/s.

Saída Analógica de ECG

Faixa de Frequência Cardíaca: 15 a 350 bpm.

Exatidão: 1 bpm ou 1% (o que for maior).

Resolução: 1 bpm.

Proteção para Eletrocirurgia

Proteção para Desfibrilação

Deteção de Pulso de Marca-passo:

Deteção de eletrodo solto com identificação

Modos de Operação: Diagnóstico, Monitor e Cirurgia.

Análise de ST na faixa de -2,0 mV a + 2,0 mV para todas as derivações sem necessidade de central com visualização simultânea na tela;

Função Diagnóstico: Fornece medição automática dos parâmetros comuns, como frequência cardíaca, intervalo de FP, duração de QRS, Intervalo de QT/QTc, eixo P/QRS/T e amplitude de RV5/SV1;

Análise e deteção de até 33 arritmias distintas, como: Assistolia, V-Fib / V-Tach, Couplet, Ritmo de ventilação, Bigeminia PVC, Trigemina PVC, Tachy (Taquicardia), R em T, PVC, Ritmo Irr, Bradicardia, Batida perdida, Marcapasso sem ritmo, Ventilação Brady (Bradicardia), Marcapasso sem captura, VEB, Executar PVCs, Ac. Ritmo de ventilação, IPVC, VT não sustentada, PVCs multiformes, Pausas/min Alto, Pausar, Afib, Bigeminia PAC, PVCs Alto, Baixa tensão (membro), Brady (Bradicardia) Extrema, Trigemina PAC, Tachy de QRS Amplo, VT Sustentada, Tachy (Taquicardia) Extrema, e V-Tach;

Faixa de alarme: 15 a 350 bpm

Respiração

Método: Impedância Torácica (Medição através das derivações: RA-LL, RA-LA.

Faixa de medida da Frequência Respiratória e de alarme:

Faixa de leitura: 0 a 150 rpm

Resolução: 1 rpm

Exatidão: ± 2 rpm

Alarme com tempo de apnéia configurável;

SpO2

Visualização simultânea da curva de plestimografia, valor da saturação e valor da frequência de pulso;

Tecnologia para baixa perfusão e movimentação;

Faixa de Medida: 0 a 100%.

Resolução: 1%.

Exatidão: 70 a 100%: ± 2 %.

Faixa de alarme: 0 a 100%

Faixa de medição de FP: 25 a 300 bpm.

Faixa de alarme: 30 a 300 bpm

Resolução: 1 bpm

Índice de Perfusão Numérico e Gráfico (PI): 0.00 a 20%;

Temperatura 2 canais

(Superficial e Intracavitária)

Canal: 2 canais T1, T2 e TD

Faixa de Medida: 0 a 50 °C

Resolução: 0,1 °C

Exatidão: $\pm 0,1$ °C (sem incluir o sensor)

Pressão Não Invasiva (PNI)

Método: Oscilométrico com medidas em mmHg ou Kpa;

Proteção e Medição para adulto, pediátrico e neonatal;

Modos de Operação: Manual, automático, contínuo

Automático: intervalo de medição 1 a 480 min

Contínuo: 5 min, intervalo de 5 s

Tipos de Medida: Pressão Arterial Sistólica, Pressão Arterial Diastólica, Pressão Arterial Média.

Faixa de medição da pressão no manguito: 0 a 300 mmHg

Resolução: 1 mmHg.

Exatidão: Erro de Média e Desvio Padrão pela ANSI/AAMI SP10.

Proteção contra sobrepressão Adulto: 300 mmHg

Proteção contra sobrepressão Infantil: 240 mmHg

Proteção contra sobrepressão Neonatal: 150 mmHg

Faixa de FP:

Faixa: 40 a 240 bpm

Resolução: 1 bpm

Exatidão: ± 3 bpm ou 3,5%



Acessórios:

01 (um) Cabo de ECG 5 vias reutilizável

01 (um) Sensor de Temperatura de Pele Adulto reutilizável

01 (um) Sensor SpO2 tipo clip adulto reutilizável

01 (um) Manguito/Abraçadeira reutilizável Adulto

01 (um) Tubo extensor de PNI 3m reutilizável

01 (um) Cabo de Alimentação (2P +T) padrão ABNT

02 (duas) Bateria interna Recarregável Lithium-Ion

01 (um) Manual do Usuário em Português

Licitante

Participante 2

Nome do documento

Ficha Técnica.pdf

Ação

Edital: 1406.01/2024SMS | Lote: 9

Marca
Data
Prazo de Validade da Proposta


Prolife
01/07/2024 | 10:10:07.608
60 dias

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
MONITOR MULTITAI	2	Unidade	R\$ 17.000,00 (R\$ 34.000,00)	-	Prolife
TOTAL DO LOTE			R\$ 34.000,00	-	

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.





FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO PRODUTO

Número do edital: 1406.01/2024-SMS
Orgão Comprador: Prefeitura Municipal de Fortim / CE

Item	Especificação	Marca e Modelo	Qtd	Valor Unit	Valor Total
09	MARCA: PROLIFE MODELO: C120 REGISTRO: 10394530056 ORIGEM: NACIONAL FABRICANTE: PROLIFE MONITOR MULTIPARAMÉTRICOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - TELAS DE 12,1" - DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO TOUCHSCREEN - BATERIA RECARREGÁVEL - ALÇA PARA TRANSPORTE - PARÂMETROS MONITORADOS: OXIMETRIA DE PULSO, TEMPERATURA, PRESSÃO NÃO INVASIVA, ECG E RESPIRAÇÃO. - ALIMENTAÇÃO: 127/220V AC, 50/60HZ - PRINCIPAIS OPCIONAIS DISPONÍVEIS (SOMENTE PARA MONITORES DE 12 E 15 POLEGADAS): IMPRESSORA TÉRMICA PRESSÃO INVASIVA, CAPNOGRAFIA (ETCO2), DÉBITO CARDÍACO, ÍNDICE BI-ESPECTRAL (BIS) E GASES ANESTÉSICOS.	Prolife / C120	02	R\$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais)	R\$ 34.000,00 (Trinta e Quatro Mil Reais)

Garantia: 12 meses
Prazo de validade da proposta (em dias) conforme estabelecido no edital): 60 dias
Condição de Pagamento: 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal
Prazo de entrega: 15 (quinze) dias uteis,
Preço Inicial para o item: R\$ 34.000,00 (Trinta e Quatro Mil Reais)
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital) e que o preço proposto

acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

Data: 01/07/2024



A handwritten signature or mark in blue ink, consisting of a vertical line with a horizontal stroke across it.

A handwritten signature or mark in blue ink, consisting of a vertical line with a horizontal stroke across it.

A handwritten signature or mark in blue ink, consisting of a vertical line with a horizontal stroke across it.


Participante 3

Nome do documento	Ação
G3L.pdf	

Edital: 1406.01/2024SMS | Lote: 9

Marca
Data
Prazo de Validade da Proposta

GENERAL MEDITECH
 01/07/2024 | 11:57:47.889
 60 dias



Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
MONITOR MULTIPAF	2	Unidade	R\$ 17.949,00 <small>(R\$ 35.898,00)</small>	-	GENERAL MEDITECH
TOTAL DO LOTE			R\$ 17.949,00		

DECLARAÇÕES:


- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.
- Declaramos que estamos enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

**G3L - MONITOR
MULTIPARAMETRO
15"**

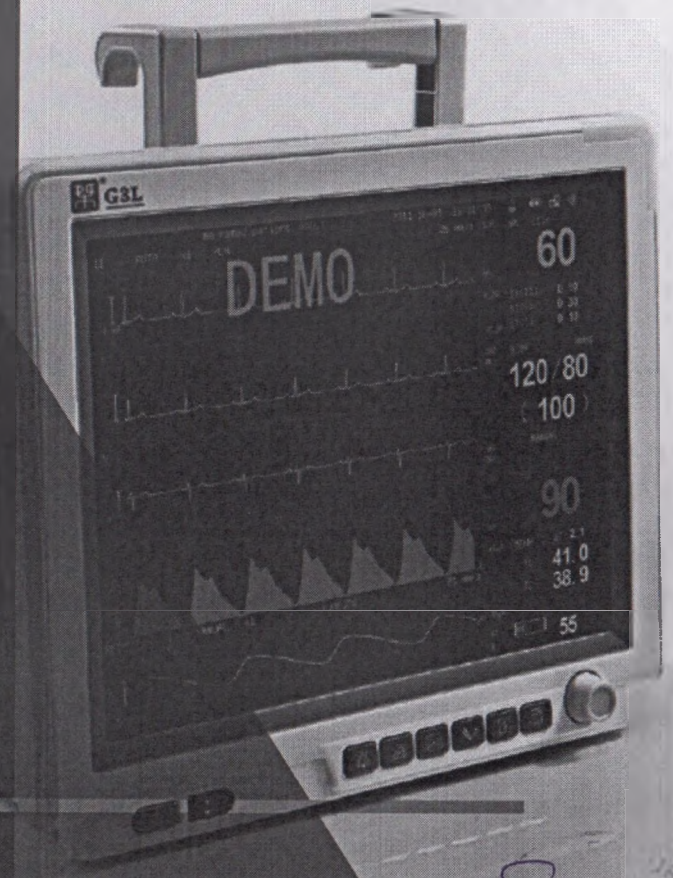

Endobrax
EQUIPAMENTOS MÉDICOS

Handwritten signature and a circular stamp with the number 284.

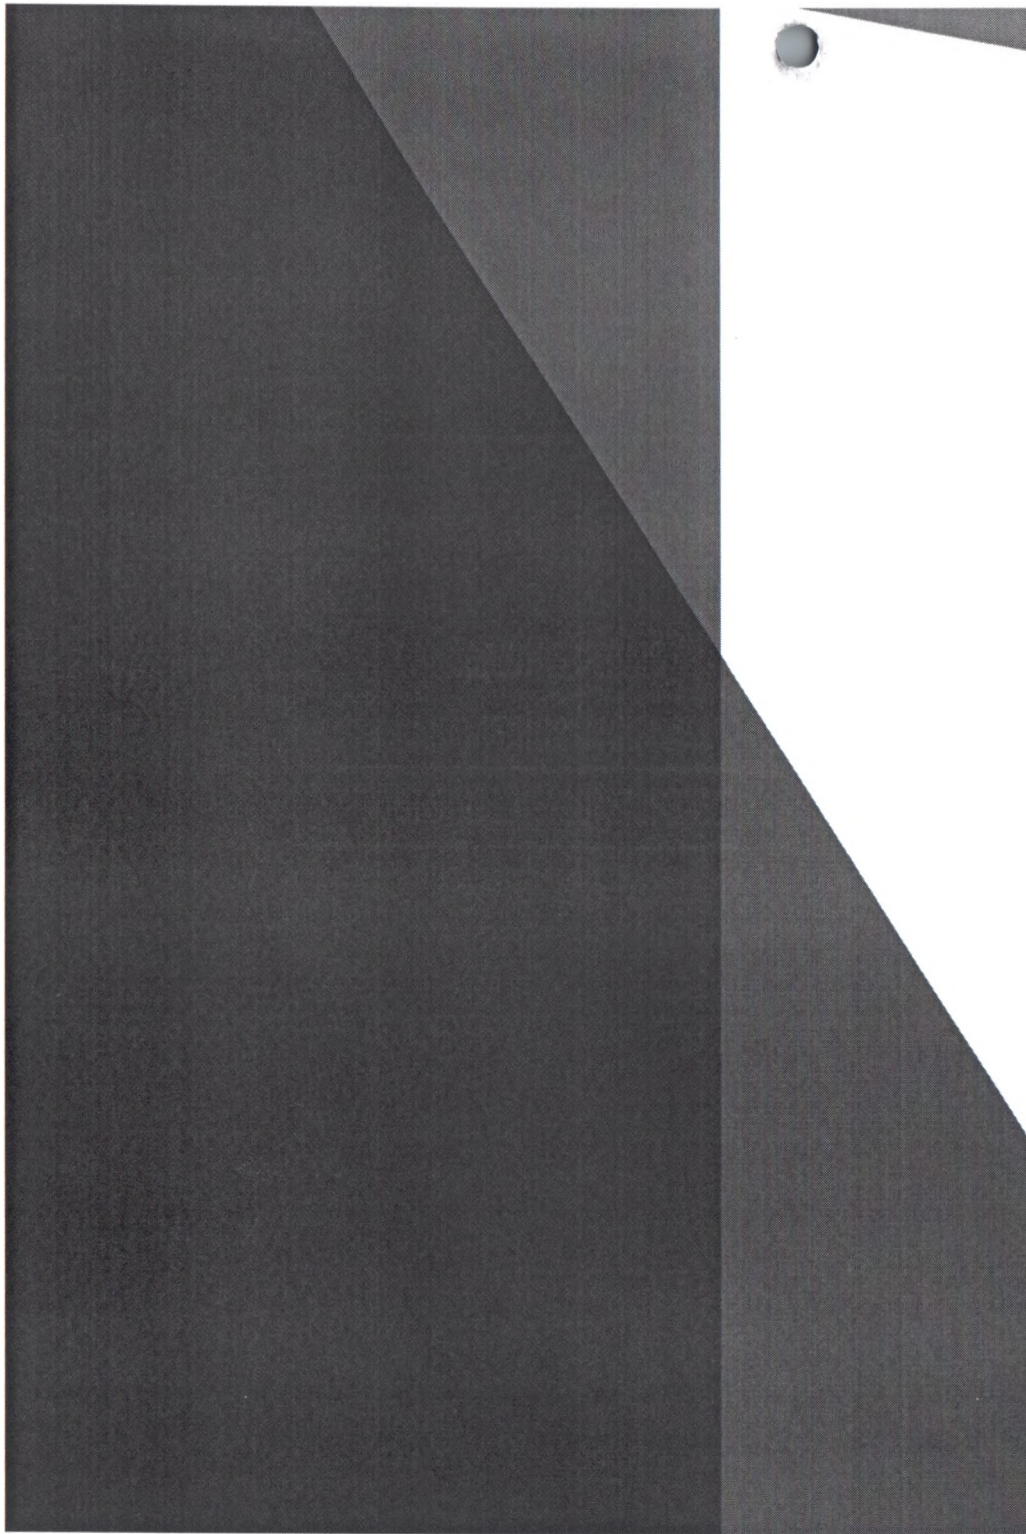

PARÂMETROS GERAIS

3

[Handwritten signature]

PARÂMETROS OPCIONAIS

4

CENTRAL DE MONITORAMENTO 2800

5

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]



PARÂMETROS GERAIS

ANVISA: 80393910019

- Eletrocardiografia (ECG), 3, 5 ou 10 vias com 7 derivações mostradas simultaneamente. Detecção do Segmento de ST e QRS. Analisador de arritmia (12 tipos), Histórico de arritmias gravadas com traçados de ECG, segundos antes e depois, detector de marca passo, detecção do segmento ST-QRS, filtro de banda DIA, MON, OPR.
- Indicação de frequência cardíaca por ECG, SPO2, ECG+SPO2, PNI e IBP.
- Oximetria (SPO2) com Curva Plestimográfica; Indicação numérica de Saturação e PULSO (PR); Tecnologia digital de medidas precisas em situações de baixa perfusão. Indicador de perfusão com barra gráfica.
- Temperatura 02 canais simultâneos (Cutâneos/ Superficiais - Esofágico/Retal); Sensor Imersível Circular ou Tubular. Cálculo das médias das temperaturas (Delta T).
- Pressão Arterial Não Invasiva (NIPB), tecnologia SUNTECH, manual e automática. Intervalo de medição programável para monitorização automático com medidas entre 01 minuto até 08 horas. Aacionamento e interrupção por tecla dedicada. Proteção Sobre-Pressão por Hardware. Medição de pressão SYS, DIA, MAP. Pressurização controlada para função venosa.
- Taxa Respiração por Sonda Nasal (T-Resp) e/ou Bioimpedância Respiratória Transtorácica (Resp). Traçado com ganho automático. Detecção de Apnéia com tempo programado.
- Calculador de medicamentos Incorporado.
- Tela em TFT LCD (crystal líquido) colorido de 15". Opcional touch screen. Resolução 1024x768 pixels. Formato de telas e tamanhos de números programáveis pelo usuário, velocidade de varredura ajustável. Congelamento e gravação da tela, apresentação dos últimos 15 seg antes do congelamento, histórico de alarmes (prioridade alta, média e baixa). Tela de Oxy-CRG, seleção de cores para cada parâmetro, apresentação de números extra grandes, identificação de paciente.
- Apresentação de 12 curvas de onda simultâneas, (configuração básica) de todos os valores numéricos medidos.
- Alarme visual e audível com limites programáveis para todos os parâmetros monitorados (indicação visual e sonora). Indicação sonora de QRS programada. Alarmes visuais segundo a NBR IEC 60601-1-2-49. Armazenamento de tendências de 360 horas e 60 eventos. Alarmes programáveis para todos os parâmetros medidos. Apresentação de tendências por gráficos ou tabelas.

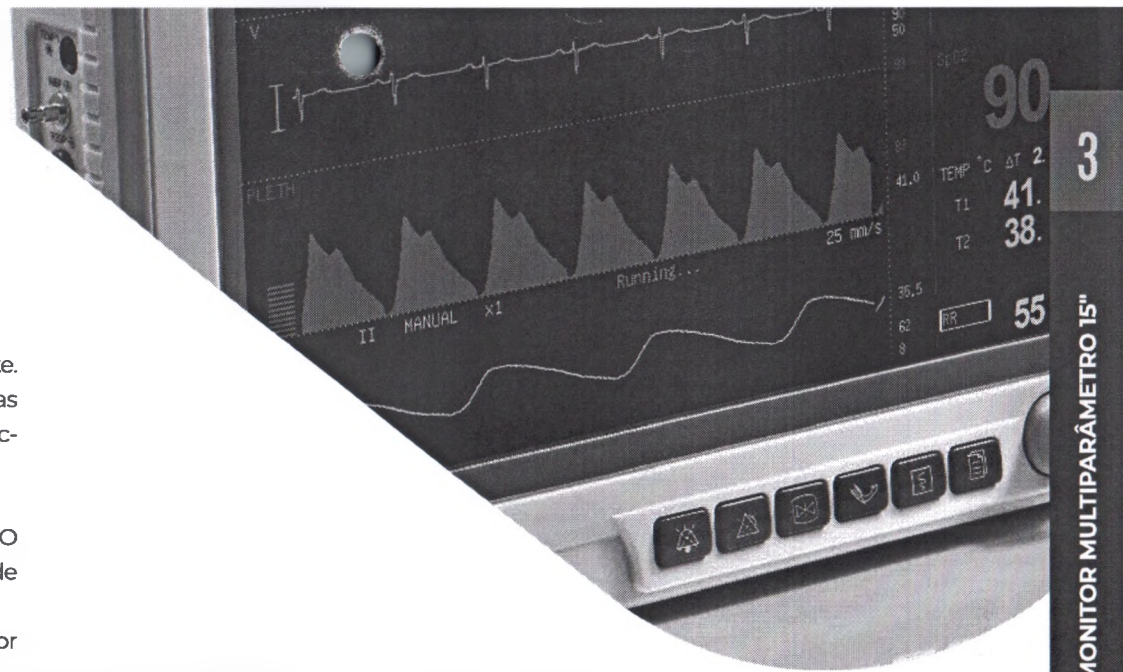

MONITOR MULTIPARÂMETRO 15"


3

- Bateria recarregável de alta energia incorporada (06 horas).
- Design para consumo de baixa energia com modo Stand by.
- Uso Adulto, pediátrico e neonatal (selecionável). Manguitos para obeso, adulto, pediátrico, neonatal, coxa (descartáveis ou reutilizáveis).
- Alça para transporte.
- Controle Remoto Infra-Red.
- Filtro contra interferências de ruído da rede elétrica, proteção para uso com desfibrilador.
- Tensão de rede elétrica de 90 ~ 240Vac. 50/60HZ. Bivolt automático.
- Idiomas disponíveis: Português, Inglês, Espanhol, Polonês, Francês, Chinês, Árabe, Russo, Italiano, Turco, etc.
- Brilho de tela e volume ajustável.
- Detecção de Marca Passo.
- Sistema de auto teste, possibilidade de manutenção remota, Upgrade de software via computador
- Proteção para uso simultâneo com desfibrilador.
- Dimensões e pesos: G3L - 353x240x181mm 5,7kg - tela 15,0".
- Led indicador de alarme, led indicador de energia, led indicador de carga, alto falante, botão.

PARÂMETROS OPCIONAIS

- Módulo Eletrocardiografia Indutiva (ECGI)*: Para Eletrodos Indutivos sem adesivo.
- Oximetria tecnologia GMI, BCI, digital nelcor Oximax e nelcor não Oximax, Maximo.
- Módulo Capnografia (EtCO2)*, Mainstream, Sidestream e Microstream: apresentação de curva em tempo real, acessórios descartáveis ou reutilizáveis. Indicação de gração inspirada de CO2 (FiO2). Indicação em %, KPA ou mmHg.
- Módulo Débito Cardíaco (CO)*: por Termodiluição. Indicação numérica e por curva. Indicações: L/min, V min/m², m², temp sangue, temp líquido injetável, cálculo hemodinâmico.
- Módulo Pressão Invasiva (IBP)*: venosa e arterial até 4 canais (ART, CVP, RVP, LAP, RAP, PAP, ICP e LVP), Delta PP.
- Módulo Nível de Consciência e Sedação (CSI)*: Incluindo Eletro Encefalograma (EEG)*. Supressão de Surto Isoelétrico (BS)*, Eletro Miografia (EMG/TNM)*, padrão de avaliação MMOS/CMS para monitorização de Anestesia Profunda (Depth of Anesthesia).
- Módulo de gás anestésico (Detecção de gás manual ou automático). Medição de CO2, FICO2, O2, FIO2, N2O, DES, ISO, ENF, SEV, HAL e MAC.
- Módulo Conversor CC/CA para uso em veículos 12V/24Vcc.
- Monitor TFT/LCD com Touch Screen*.

- Entrada de ECG com 10 vias para 12 derivações*.
- Conexões RS 232*, USB*, VGA (vídeo)*, RJ 45* e Memory Card, Interface HL7 - Protocolo TCP/IP.
- Visualizador de leito remoto, utilizando Central de Monitorização (Bed to Bed).
- Impressora térmica incorporada para impressão de dados, tabelas e diagramas de tendências, forma de onda com sua retícula milimetrada que dispensa papel térmico especial.
- Conexão para Central de Monitoramento por fio ou sem fio tipo wireless ou mista.
- Possibilidade de conexão externa.
- Sincronismo com o desfibrilador.
- Saída vídeo composto para monitor de vídeo.
- Impressora externa*.
- Suporte de parede com regulagem de inclinação e altura.
- Trolley tipo pedestal.

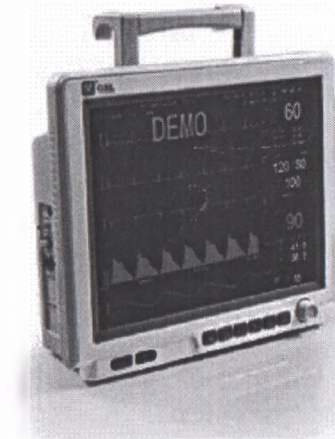



CENTRAL DE MONITORAMENTO 2800

- Suporta 2 telas de 32 polegadas simultaneamente. • Função de impressão para múltiplos diagramas.
- Apresentação de todas as derivações de ECG.
- Configurável para todos os parâmetros fisiológicos.
- Relatórios em tempo real.
- Comunicação bidirecional com monitores.
- Possibilidade de comunicação Bed to Bed.



*Com bateria de alta capacidade **Com bateria de alta capacidade



5

MONITOR MULTIPARÂMETRO 15"





Endobrax
EQUIPAMENTOS MÉDICOS



WWW.ENDOBRAX.COM.BR


Participante 4

Nome do documento	Ação
item 09.pdf	

Edital: 1406.01/2024SMS | Lote: 9

Marca
Data
Prazo de Validade da Proposta

COMEN C80
01/07/2024 | 14:21:15.756
60 dias



Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
MONITOR MULTITAI	2	Unidade	R\$ 17.949,00 (R\$ 35.898,00)	-	COMEN C80
TOTAL DO LOTE					

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.

Participante 8

Nome do documento	Ação
CATALOGO MONITOR M12.pdf	

Edital: 1406.01/2024SMS | Lote: 9

Marca	BIOLIGHT
Data	01/07/2024 16:06:22.143
Prazo de Validade da Proposta	60 dias



Informações sobre preços e marcas					
Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
MONITOR MULTIPAI	2	Unidade	R\$ 17.949,00 (R\$ 35.898,00)	-	BIOLIGHT
TOTAL DO LOTE					

- DECLARAÇÕES:**
- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
 - Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
 - Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
 - Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos Incisos III e IV do art. 1º e no Inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
 - Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.
 - Declaramos que estamos organizados em cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
 - Declaramos que estamos enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.



M10 e M12

MONITOR DE PACIENTE

TAMANHO E PESO:

Tamanho M12: 198mm X 320mm X 262mm
M10: 193mm X 288mm X 236mm

Peso M12: <4kg
M10: <3kg

ENERGIA:

- De acordo com os padrões da IEC 60601-1 e IEC 60601-1-2
- Voltagem de entrada: AC (100-240) V(±10%)
- Frequência: 50hz/60hz
- Entrada de energia: 100VA

TELA

Tipo TFT LCD Colorido

Tamanho 12.1" / 10.4" (M12 / M10)

Resolução M12: 1280x800 pixels
M10: 1024x600 pixels

ECG (ELETROCARDIOGRAMA)

Derivações: 3 derivações: I, II, III
5 derivações: I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vx
6 derivações: I, II, III, aVR, aVL, aVF, Va, Vb

Auto: identifica derivações automaticamente

Padrão de cor das derivações: AHA, IEC

Ganho: Auto, 2.5 mm/mV (x0.25), 5 mm/mV (x0.5), 10 mm/mV (x1), 20 mm/mV (x2), 40 mm/mV (x4)


CMRR: Monitor/Modo de operação: ≥ 110 dB
Modo de diagnóstico: ≥ 100 dB

Largura de banda (-3dB): ● Modo monitor: 0.5Hz até 40Hz.
● Modo operação: 1 Hz até 25Hz.
● Modo diagnóstico: 0.05Hz ~150Hz
● Modo ST: 0.05Hz ~ 40Hz

Impedância de entrada: ≥ 5.0 MΩ

Amplitude do sinal de entrada: -10.0mV~+10.0mV

Eletrodo de compensação potencial: ± 500 Mv d.c.

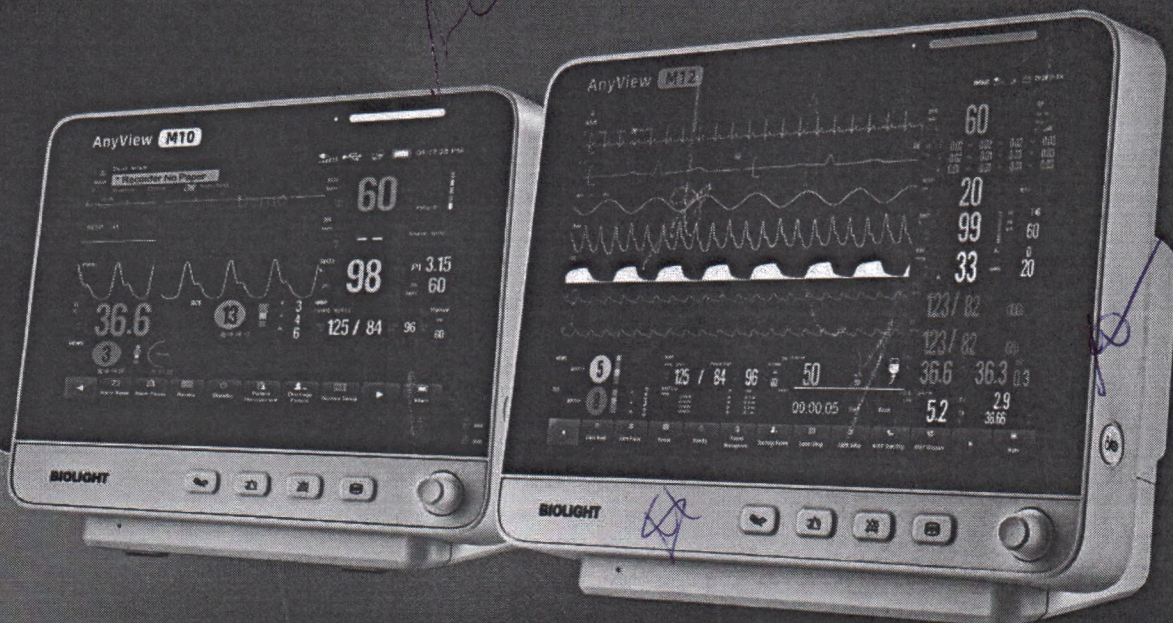



ECG (ELETROCARDIOGRAMA)

Ruído do sistema:	≤ 30 μVpp (RTI)
Tempo de recuperação após desfibrilação:	formas de onda voltam ao normal em até 10s.
Velocidade de varredura:	6.25mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50mm/s
Segmento ST	
Amplitude de medição:	-2.0 mV até +2.0 mV
Precisão:	-0.8mV até +0.8mV: ±0.02 mV ou ±10% (o que for maior)
Resolução:	0.01mV
Frequência Cardíaca	
Amplitude de medição:	Adulto: 10bpm até 300bpm Pediátrico e Neonatal: 10bpm até 350bpm
Precisão:	±1% ou ±1 bpm, o que for maior
Resolução:	1 bpm
Análise de Arritmias	
27 tipos:	Entre eles batimentos adicionais, taquicardias supraventriculares, arritmias ventriculares e bradiarritmias, bigeminismo, trigeminismo, ruído de ECG entre outros (favor conferir manual).
Respiração	
Derivações:	Selecionada do I (RA-LA) ou II (RA-LL)
Amplitude de medição:	0 rpm até 150 rpm
Resolução:	1 rpm
Precisão:	±2 rpm or ±2% o que for maior
Delay do alarme de apnéia:	delay ajustável de 10s - 60s

PNI (PRESSÃO NÃO INVASIVA)

Método de medição:	Oscilometria Automática
Modos de medição:	Manual, Auto, STAT, Sequencial
Intervalos de medição no modo Auto:	1/2/2.5/3/5/10/15/20/30min, 1/1.5/2/3/4/8h Tempo cíclico de 5 minutos no modo STAT
Modo Sequência:	Até 5 grupos, cada grupo permite a parametrização individual do intervalo e número de medições periódicas

IMPRESSORA (OPCIONAL M12)

Tipo:	Impressora Térmica (BTR50S)
Largura do papel:	50 mm ±1mm
Velocidade de impressão:	125 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Forma de onda da impressão:	Máximo 3 pistas

BATERIA

Tipo:	Bateria Li-ion recarregável 111V 2.5Ah
Tempo de operação:	>240 minutos (2.5Ah) (Uma bateria nova e completamente carregada operando em uma temperatura de 25°, com parâmetros SPO2 E PNI trabalhando no modo automático com intervalo de 30 minutos entre as medições)
Tempo de carregamento:	<8 horas (2.5Ah)

ARMAZENAMENTO DE DADOS:

Alarme de eventos:	3000 grupos com suas formas de onda
Tendências:	1800h, com resolução mínima de 10min 180h, com resolução mínima de 1 min. 6h, com resolução mínima de 5s.
Eventos de ARR:	3000 grupos com suas formas de onda.
PNI:	2400 grupos
Formas de onda holográficas:	72 horas



INTERFACE E DISPOSITIVOS DE E/S (ENTRADA E SAÍDA)

Teclas de atalho:	PNI Início/Pausa, Reinício Alarme, Pausa Alarme, Congela.
Botão rotacional:	1
Teclado e mouse:	Suporta
Leitor de Código de barras:	Suporta padrão 1D (Conexão USB)
Conexão de rede por cabo:	1 porta padrão RJ45
Wifi (opcional) Protocolo:	Protocolo: IEEE 11a/b/g/n
Frequência Wifi:	Dupla banda. 2.4G/5G
Entrada USB:	2 entradas
Saída de Vídeo:	1 entrada VGA (Opcional)
Porta multifuncional:	Chamada de enfermeira / sincronização com desfibrilador / saída analógica.
Amplitude Sistólica	<ul style="list-style-type: none"> ● Adulto 30 até 270 mmHg ● Pediátrico 30 até 235 mmHg ● Neonatal 30 até 135 mmHg
Amplitude diastólica	<ul style="list-style-type: none"> ● Adulto 10 até 220 mmHg ● Pediátrico 10 até 220 mmHg ● Neonatal 10 até 110 mmHg
Amplitude Média	<ul style="list-style-type: none"> ● Adulto 20 até 235 mmHg ● Pediátrico 20 até 235 mmHg ● Neonatal 20 até 125 mmHg
Precisão de pressão:	Estática: ±3 mmHg (±0.4kPa) Clínica: margem de erro ±5 mmHg Desvio padrão: ≤8 mmHg
Amplitude da taxa de pulso:	40bpm até 240bpm
Precisão da taxa de pulso:	±3bpm ou ±3% o que for maior.
Tempo de medição	20s até 45s (valores comuns)
Proteção contra pressão excessiva:	<ul style="list-style-type: none"> ● Adulto (297±3) mmHg ● Pediátrico (252±3) mmHg ● Neonatal (147±3) mmHg

TEMPERATURA (DUPLA TEMPERATURA SOMENTE PARA O M12)

Parâmetro:	T1,T2,TD
Probe:	YS1400 series probe (2252 Ω @25°C)
Amplitude de medição:	0.0°C até 50.0°C (32°F para 122°C)
Precisão:	±0.1°C ou ±1°F (exclusivo para probe)
Resolução	0.1°C ou 1°F
Unidade de medida:	°C ou F°

SPO2 (OXIMETRIA) BIOLIGHT

Amplitude de medição:	0% ~ 100%
Precisão(Clínica)	70% ~ 100% ≤3% (PROBE DE SPO2 INCLUIDO). 0% ~ 69% não especificado

TAXA DE PULSO

Amplitude de medição	25bpm até 300bpm
Resolução:	1bpm
Precisão:	± 3bpm

ÍNDICE DE PERFUSÃO

Amplitude de medição	0.05~20.00%
Resolução:	0.01%
Precisão:	±0.1% ou ±10% de leitura, o que for maior.

RESP (RESPIRAÇÃO)

Amplitude de medição	0 rpm ~90 rpm
Resolução:	1 rpm
Precisão:	± 2rpm

CONFIGURAÇÃO PADRÃO

3/5/6 derivações de ECG, FC (Frequência Cardíaca), SPO2, RESP, PNI, Temperatura ou Dupla Temperatura(M12), Bateria Li-ion recarregável (2.5Ah)

OPCIONAIS



M12: Tela sensível ao toque, impressora térmica
M10/M12: Carrinho de transporte, suporte de parede



Para mais
informações
sobre a 1000Medic,
visite nosso site em
www.1000medic.com.br

R. Lídio Oltramari, 1796,
Bairro Fraron, CEP 85.503-381, Pato Branco / PR, Brasil
CNPJ 05 993 698/0001-07 - Contato: +55 46 3224-7700

M10/M12 2020903_eng V1 Date Mar 2021




Participante 12

Nome do documento	Ação
ANEXO_LOTE9.pdf	

Edital: 1406.01/2024SMS | Lote: 9

Marca: OLIDEF MEDICAL
Data: 01/07/2024 | 18:03:52.945
Prazo de Validade da Proposta: 60 dias



Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
MONITOR MULTITAP	2	Unidade	R\$ 17.949,00 (R\$ 35.898,00)		OLIDEF MEDICAL
TOTAL DO LOTE					

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no Inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.



AO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PE Nº1406.01/2024
ABERTURA: 02/07/2024 Às 8:30
DISPUTA: 02/07/2024 ÀS 10:30

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA - HMWA CONFORME PROPOSTA Nº 10295311000124011 E PORTARIA GM/MS Nº 3.747, DE 07 DE MAIO DE 2024 QUE AUTORIZA O MUNICÍPIO A RECEBER RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO ACIMA CITADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTIM/CE.

PROPOSTA

LOTE	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTDE	VL.UNIT.	VL.TOTAL
9	MONITOR MULTIPARAMÉTRICOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - TELAS DE 8", 12,1" E 15,6" - DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO TOUCHSCREEN - BATERIA RECARREGÁVEL - ALÇA PARA TRANSPORTE - PARÂMETROS MONITORADOS: OXIMETRIA DE PULSO, TEMPERATURA, PRESSÃO NÃO INVASIVA, ECG E RESPIRAÇÃO. - ALIMENTAÇÃO: 127/220V AC, 50/60HZ - PRINCIPAIS OPCIONAIS DISPONÍVEIS (SOMENTE PARA MONITORES DE 12 E 15 POLEGADAS): IMPRESSORA TÉRMICA PRESSÃO INVASIVA, CAPNOGRAFIA (ETCO2), DÉBITO CARDÍACO, ÍNDICE BI-ESPECTRAL (BIS) E GASES ANESTÉSICOS.	UND	OLIDEF MEDICAL	2	R\$ 17.949,00	R\$ 35.898,00
VALOR TOTAL DO ITEM						R\$ 35.898,00
trinta e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais						
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						R\$ 35.898,00
trinta e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais						


VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) dias uteis

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro;
Declaramos que cumprimos os requisitos para a habilitação e a conformidade de nossa proposta com as exigências do edital.

DATA: 02/07/24


Nome do documento					Ação
9-G3D - JUNTADO.pdf					
Edital: 1406.01/2024SMS Lote: 9					
Marca			GENERAL MEDITECH		
Data			01/07/2024 19:13:20.156		
Prazo de Validade da Proposta			60 dias		
Informações sobre preços e marcas					
Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
MONITOR MULTITAI	2	Unidade	R\$ 17.949,00 (R\$ 35.898,00)		GENERAL MEDITECH
TOTAL DO LOTE					

**DECLARAÇÕES:**

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos Incisos III e IV do art. 1º e no Inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.
- Declaramos que estamos organizados em cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
- Declaramos que estamos enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

G3D - MONITOR MULTIPARAMETRO 12.1"


Endobrax
EQUIPAMENTOS MÉDICOS

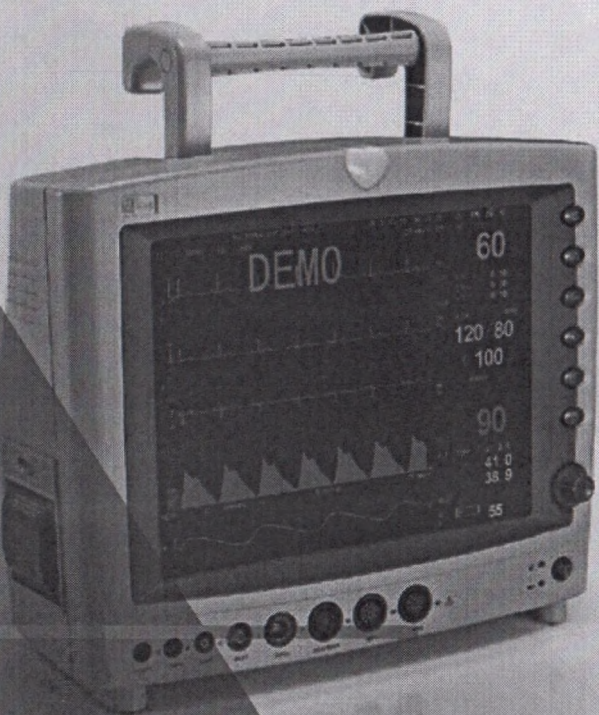

Handwritten signature and date: 2014
Circular stamp: JRAMUN
Other text in stamp: BOUCHI, DR. HIR

PARÂMETROS GERAIS

3

PARÂMETROS OPCIONAIS

4

CENTRAL DE MONITORAMENTO 2800

5




PARÂMETROS GERAIS

ANVISA: 80393910036

• Eletrocardiografia (ECG), 3, 5 vias com 7 derivações mostradas simultaneamente. Detecção do Segmento de ST e QRS. Analisador de arritmia (12 tipos), Histórico de arritmias gravadas com traçados de ECG, segundos antes e depois, detector de marca passo, detecção do segmento ST-QRS, filtro de banda DIA, MON, OPR.

- Indicação de frequência cardíaca por ECG, SPO2, ECG+SPO2, PNI e IBP.
- Oximetria (SPO2) com Curva Plestimográfica; Indicação numérica de Saturação e PULSO (PR); Tecnologia digital de medidas precisas em situações de baixa perfusão. Indicador de perfusão com barra gráfica.
- Temperatura O2 canais simultâneos (Cutâneos/ Superficiais - Esofágico/Retal); Sensor Imersível Circular ou Tubular. Cálculo das médias das temperaturas (Delta T).
- Pressão Arterial Não Invasiva (NIPB), tecnologia SUNTECH, manual e automática. Intervalo de medição programável para monitorização automático com medidas entre 01 minuto até 08 horas. Acionamento e interrupção por tecla dedicada. Proteção Sobre-Pressão por Hardware. Medição de pressão SYS, DIA, MAP. Pressurização controlada para função venosa.
- Taxa Respiração por Sonda Nasal (T-Resp) e/ou Bioimpedância Respiratória Transtorácica (Resp). Traçado com ganho automático. Detecção de Apnéia com tempo programado.
- Calculador de medicamentos Incorporado.
- Tela em TFT LCD (cristal líquido) colorido de 12.1". Opcional touch screen. Resolução 800x600 pixels. Formato de telas e tamanhos de números programáveis pelo usuário, velocidade de varredura ajustável. Congelamento e gravação da tela, apresentação dos últimos 15 seg antes do congelamento, histórico de alarmes (prioridade alta, média e baixa). Tela de Oxy-CRC, seleção de cores para cada parâmetro, apresentação de números extra grandes, identificação de paciente.
- Apresentação de 8 curvas de onda simultâneas, (configuração básica) de todos os valores numéricos medidos.
- Alarme visual e audível com limites programáveis para todos os parâmetros monitorados (indicação visual e sonora). Indicação sonora de QRS programada. Alarmes visuais segundo a NBR IEC 60601-1-2-49. • Armazenamento de tendências de 360 horas e 60 eventos. Alarmes programáveis para todos os parâmetros medidos. Apresentação de tendências por gráficos ou tabelas.

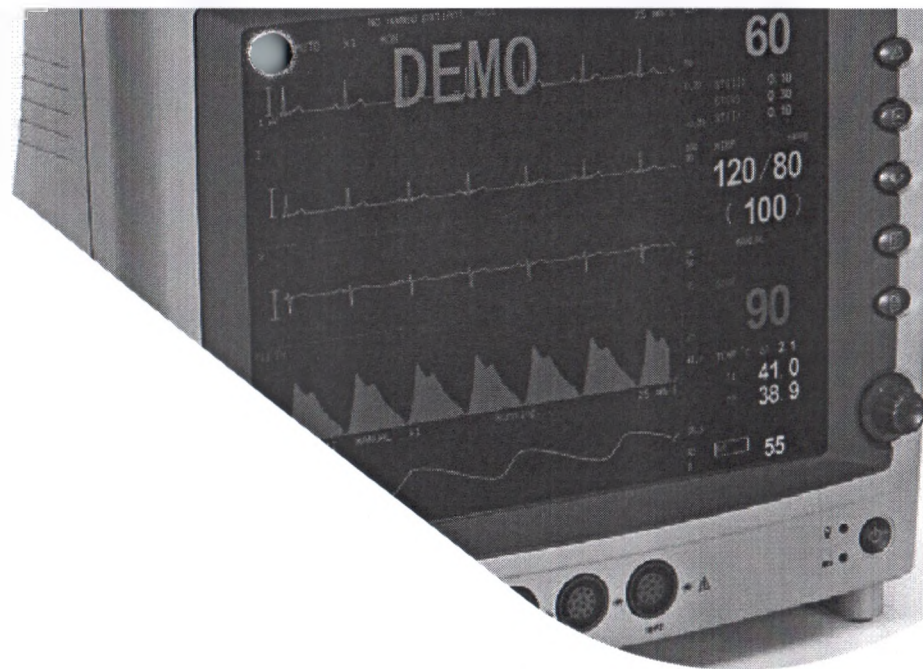

3

MONITOR MULTIPARÂMETRO 12.1"

- Bateria recarregável de alta energia incorporada (06 horas).
- Design para consumo de baixa energia com modo Stand by.
- Uso Adulto, pediátrico e neonatal (selecionável). Manguitos para obeso, adulto, pediátrico, neonatal, coxa (descartáveis ou reutilizáveis).
- Alça para transporte.
- Filtro contra interferências de ruído da rede elétrica, proteção para uso com desfibrilador.
- Tensão de rede elétrica de 90 ~ 240Vac. 50/60HZ. Bivolt automático.
- Idiomas disponíveis: Português, Inglês, Espanhol, Polonês, Francês, Chinês, Árabe, Russo, Italiano, Turco, etc.
- Brilho de tela e volume ajustável.
- Detecção de Marca Passo.
- Sistema de auto teste, possibilidade de manutenção remota, Upgrade de software via computador
- Proteção para uso simultâneo com desfibrilador.
- Dimensões e pesos: 352x365x146mm 4.8kg - tela 12.1".
- Led indicador de alarme, led indicador de energia, led indicador de carga, alto falante, botão.

Endobrax
EQUIPAMENTOS MÉDICOS

WWW.ENDOBRAx.COM.BR

PARÂMETROS OPCIONAIS

- Módulo Eletrocardiografia Indutiva (ECGI)*: Para Eletrodos Indutivos sem adesivo.
- Oximetria tecnologia GMI, BCI, digital nelcor Oximax e nelcor não Oximax, Maximo.
- Módulo Capnografia (EtCO2)*, Mainstream, Sidestream e Microstream: apresentação de curva em tempo real, acessórios descartáveis ou reutilizáveis. Indicação de gração inspirada de CO2 (FIO2). Indicação em %, KPA ou mmHg.
- Módulo Débito Cardíaco (CO)*: por Termodiluição. Indicação numérica e por curva. Indicações: L/min, l/min/m², m³, temp sangue, temp líquido injetável, cálculo hemodinâmico.
- Módulo Pressão Invasiva (IBP)*: venosa e arterial até 4 canais (ART, CVP, RVP, LAP, RAP, PAP, ICP e LVP), Delta PP.
- Módulo Nível de Consciência e Sedação (CSI)*: Incluindo Eletro Encefalograma (EEG)*. Supressão de Surto Isoelétrico (BS)*, Eletro Miografia (EMG/TNM)*, padrão de avaliação MMOS/CMS para monitorização de Anestesia Profunda (Depth of Anesthesia).
- Módulo de gás anestésico (Detecção de gás manual ou automático). Medição de CO2, FICO2, O2, FIO2, N2O, DES, ISO, ENF, SEV, HAL e MAC.
- Módulo Conversor CC/CA para uso em veículos 12V/24Vcc.
- Monitor TFT/LCD com Touch Screen*.

- Entrada de ECG com 10 vias para 12 derivações*.
- Conexões RS 232*, USB*, VGA (vídeo)*, RJ 45* e Memory Card, Interface HL7 - Protocolo TCP/IP.
- Visualizador de leito remoto, utilizando Central de Monitorização (Bed to Bed).
- Impressora térmica incorporada para impressão de dados, tabelas e diagramas de tendências, forma de onda com sua retícula milimetrada que dispensa papel térmico especial.
- Conexão para Central de Monitoramento por fio ou sem fio tipo wireless ou mista.
- Possibilidade de conexão externa.
- Sincronismo com o desfibrilador.
- Saída vídeo composto para monitor de vídeo.
- Impressora externa*.
- Suporte de parede com regulagem de inclinação e altura.
- Trolley tipo pedestal.






CENTRAL DE MONITORAMENTO 2800

- Suporta 2 telas de 32 polegadas simultaneamente. • Função de impressão para múltiplos diagramas.
- Apresentação de todas as derivações de ECG.
- Configurável para todos os parâmetros fisiológicos.
- Relatórios em tempo real.
- Comunicação bidirecional com monitores.
- Possibilidade de comunicação Bed to Bed.



*Com bateria de alta capacidade **Com bateria de alta capacidade

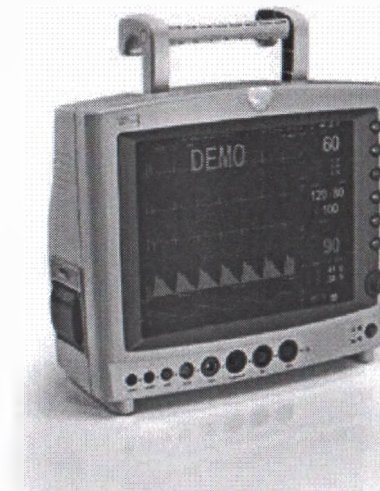

5
MONITOR MULTIPARÂMETRO 12.1"




Endobrax
EQUIPAMENTOS MÉDICOS

WWW.ENDOBRAX.COM.BR





Endobrax
EQUIPAMENTOS MÉDICOS



WWW.ENDOBRAX.COM.BR

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	ENDOBRIX COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ	07.427.470/0001-85
Autorização	8.03.939-1
Produto	MONITOR MULTIPARÂMETROS GENERAL MEDITECH - SERIE G3

Modelo Produto Médico
G3C
G3D
G3F
G3G
G3H
G3L
G3M
G3N
G3R
G3S
G6A
G6B

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MANUAL DO OPERADOR - MONITOR DE PACIENTE MULTIPARÂMETROS - SERIE G3.PDF	1395457212 - 12/04/2021 13:09:19
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MANUAL DO OPERADOR - MONITOR DE PACIENTE MULTIPARÂMETROS G3R.PDF	1395457212 - 12/04/2021 13:09:19

Nome Técnico	Monitor de Sinais Vitais
Registro	80393910036
Processo	25351682850202015
Fabricante Legal	GENERAL MEDITECH, INC.
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO
Vencimento do Registro	10/08/2030



MINISTÉRIO DA SAÚDE

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Considerando o disposto na Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999 e a publicação no Diário Oficial da União por meio da Resolução RE n.º 4.229 na data de 26/12/2022 certifico que a empresa, a seguir descrita, cumpre com a legislação sanitária vigente, quanto às Boas Práticas de Fabricação de produtos para saúde exigidas pela autoridade sanitária brasileira, estando sujeita a inspeções periódicas.

Fabricante: General Meditech, Inc.

Endereço: South Office 3/F, Building 23, Kezhi Rd. No.1st. West, Science Park, Nanshan, Shenzhen, Guangdong, 518057 - China

Solicitante: Endobrax Comércio Importação e Exportação de Equipamentos Médicos Ltda.
CNPJ: 07.427.470/0001-85

Autorização de Funcionamento: 8039391 Expediente: 4307334/22-1

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.

Equipamentos de uso médico da classe III.

Motivo: Subsidiado por relatório de inspeções anteriores e abordagem baseada em risco

Validade até: 26/12/2024



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina Moreira Marino Araujo**, Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, em 28/12/2022, às 12:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.anvisa.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **2195908** e o código CRC **DF8AB449**.

Nome do documento		Ação			
ITEM 10_Descritivo do Fabricante_Oxímetro VITA 200 Spo2.pdf					
Edital: 1406.01/2024SMS Lote: 10					
Marca	ALFA MED / VITA 200				
Data	01/07/2024 14:53:35.583				
Prazo de Validade da Proposta	60 dias				
Informações sobre preços e marcas					
Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
OXIMETRO DE MESA	2	Unidade	R\$ 3.223,00 (R\$ 6.446,00)	-	ALFA MED / VITA 200
TOTAL DO LOTE			R\$ 6.446,00	-	

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.



Descrição

Monitor de Oximetria VITA 200

Fabricante: ALFA MED

Procedência: Nacional

Registro Anvisa: 80629370009

O VITA 200 emprega alta tecnologia de monitoramento e possui um tamanho compacto que o torna extremamente adequado para verificações pontuais e ambulatoriais.

Parâmetros: Saturação do Oxigênio (SpO₂), Plestimografia, Frequência de Pulso (FP) e Intensidade do sinal da frequência de pulso (índice de perfusão).

Modo de operação: Contínuo

Características:

- Display de LCD 3,5" colorida de 320x240 LED;
- Medição e apresentação simultânea do valor de SpO₂, forma de onda plestimográfica, frequência de pulso e intensidade do sinal de frequência de pulso;
- Relógio;
- Alça de transporte;
- Ajuste de velocidade do traçado para 25 e 50 mm/seg;
- Leitura para pacientes com baixa perfusão e movimentação;
- Seleção de tipo de pacientes: ADU - Adulto/Pediátrico; NEO - Neonatal;
- Possui gráfico e tabela de tendência de SpO₂ e FP de no mínimo 72 horas;
- Alarme visual e sonoro com ajuste de tom e ajuste de máximo e mínimo para todos parâmetros;
- Ajuste digital para volume sonoro bip de pulso e alarmes;
- Desligamento automático no caso de baixa carga de bateria;
- Comunicação com computador e central de monitoramento;
- Bateria com autonomia para pelo menos 10 horas de funcionamento;
- Carregador interno bivolt automático 100 a 240Vac 50/60hz;
- Memória interna.

Indicadores áudio visuais

- Sensor desconectado e solto;
- Status da bateria e carregando bateria;
- Sinal fraco e bateria fraca;
- Exibe a amplitude de pulso;
- Memória insuficiente;
- Alarme desligado;
- Armazenamento de dados;
- Identificação do paciente;
- Tipo de paciente;

SpO₂

Faixa de Medida: 0 a 100%.

Faixa de alarme: 0 a 100%.

Resolução: 1%.

Exatidão: 70 a 100%: ±2%

Frequência de Pulso (FP)

Faixa de Medida: 25 a 300 bpm.

Faixa de alarme: 30 a 300 bpm

Resolução: 1 bpm.

Exatidão: ±2 bpm

Acessórios:

- 01 (um) Sensor SpO2 tipo clip adulto reutilizável
- 01 (uma) Bateria interna Recarregável Lithium-Ion
- 01 (um) Manual do Usuário em Português
- 01 (um) Cabo de Alimentação (2P +T) padrão ABNT

Garantia:

12 meses.



Three handwritten signatures in blue ink, arranged vertically. The top signature is a simple vertical line with a loop at the bottom. The middle signature is a stylized 'A' shape. The bottom signature is a more complex, cursive signature.

Nome do documento	G18.pdf	Ação			
Edital: 1406.01/2024SMS Lote: 10					
Marca Data Prazo de Validade da Proposta	GENERAL MEDITECH 01/07/2024 11:58:13.384 60 dias				
Informações sobre preços e marcas					
Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
OXIMETRO DE MESA	2	Unidade	R\$ 4.913,00 (R\$ 9.826,00)	-	GENERAL MEDITECH
TOTAL DO LOTE			R\$ 9.826,00	-	

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.
- Declaramos que estamos enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

OXÍMETRO
DE PULSO
G1B


Endobrax
EQUIPAMENTOS MÉDICOS



Handwritten signature: *[Signature]*
Stamp: SPA MUNICIPAL DE ORKIN
Fiscal No: 301



PARÂMETROS GERAIS

- Oxímetro de Pulso com Monitorização de batimentos cardíacos.
- Portátil (quando fora da base).
- De mesa (quando alojado na base).
- Carrega as baterias durante o uso (quando alojado na base).
- Tecnologia de Medição Digital.
- Alarmes de parâmetros programáveis (todos).
- Medições precisas em perfusões baixas.
- Anti-Movement System: Permite medições mesmo em pacientes agitados ou em movimento, sem perda de pulso.
- Sensor Digital SPO2 que permite medições em pacientes de pele escura ou com esmalte.
- Baterias recarregáveis tipo AA, (De fácil reposição). Com autonomia de até 16 horas* de uso contínuo ou 72 horas em Standby.
- Memória interna para armazenamento de até 24 horas de monitoramento.
- Comunicação com o computador para recuperação da monitoração armazenada na memória interna das últimas 24 horas.
- Software de gerenciamento de informações capaz de apresentar curva de tendência das informações armazenadas na memória**.
- Display de LCD colorido com tela rotacional Curva Plestimográfica, indicação numérica e barra gráfica ou com números grandes e barra gráfica. Retro iluminado que facilita a visualização mesmo em ambientes com pouca ou nenhuma luz. Ajuste da retro iluminação conforme a necessidade do ambiente.
- Monitoração assistida por interface sonora com nível ajustável. -SensorSpO2paraAdulto, Pediátrico, Neonatal e Lingual.
- Dimensões: 13,5x6,5x3,0cm • Peso: 118g

[Handwritten mark]



Endobrax


EQUIPAMENTOS MÉDICOS

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Circular stamp with handwritten signature and date]
2022
JRA MOUT

WWW.ENDOBRIX.COM.BR

Nome do documento		catálogos Fortim_compressed.pdf		Ação	
Edital: 1406.01/2024SMS Lote: 10					
Marca	lepu/pc66b				
Data	01/07/2024 14:54:20.734				
Prazo de Validade da Proposta	60 dias				
					
Informações sobre preços e marcas					
Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
OXIMETRO DE MESA	2	Unidade	R\$ 4.913,00 (R\$ 9.826,00)	-	lepu/pc66b
TOTAL DO LOTE					

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.
- Declaramos que estamos organizados em cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
- Declaramos que estamos enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.






Nome do documento	Ação
10-VT2008-RONSEDA - JUNTADO.pdf	

Edital: 1406.01/2024SMS Lote: 10	
------------------------------------	--

Marca	RONSEDA
Data	01/07/2024 19:13:20.157
Prazo de Validade da Proposta	60 dias



Informações sobre preços e marcas					
Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
OXIMETRO DE MESA	2	Unidade	R\$ 4.913,00 (R\$ 9.826,00)	-	RONSEDA
TOTAL DO LOTE			R\$ 9.826,00	-	


DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.
- Declaramos que estamos organizados em cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
- Declaramos que estamos enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Participante 6

Nome do documento	Ação
CATALOGO OXIMETRO DE MESA.pdf	
Edital: 1406.01/2024SMS Lote: 10	
Marca	MD
Data	01/07/2024 16:06:22.144
Prazo de Validade da Proposta	60 dias



Informações sobre preços e marcas					
Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
OXIMETRO DE MESA	2	Unidade	R\$ 10.000,00 (R\$ 20.000,00)	-	MD
TOTAL DO LOTE			R\$ 20.000,00	-	

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.
- Declaramos que estamos organizados em cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
- Declaramos que estamos enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

Oxímetro de Mesa

VS2000E

Descubra a precisão e o desempenho do Oxímetro de Mesa VS2000E



O VS2000E MD é um equipamento avançado e versátil, projetado para a verificação, monitoramento e gravação contínua não invasiva.

Monitoramento Preciso e Confiável

Com o uso de sensores especializados, o Oxímetro de Mesa VS2000E MD oferece leituras precisas em pacientes de todas as faixas etárias, desde recém-nascidos até adultos. Ele permite o monitoramento contínuo dos pacientes, com parâmetros de alarme ajustáveis e alarmes visuais e sonoros para garantir a segurança do paciente.

Tela LCD Colorida de Alta Resolução

Com a tela LCD-TFT de alta resolução. Resolução de 800 x 480 pixels e um tamanho de tela de 7 polegadas diagonal, todas as informações essenciais são exibidas com clareza e legibilidade.

Monitoramento Avançado


Além das leituras de SpO2 e frequência cardíaca, o Oxímetro de Mesa VS2000E MD apresenta um gráfico de barras que indica a força de pulso. Um pletismograma, ou onda de saturação de oxigênio, pode ser continuamente exibido, fornecendo informações adicionais sobre a condição do paciente. Uma ampla variedade de sensores descartáveis e reutilizáveis está disponível para atender às necessidades específicas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Dimensões: 300mm x 180mm x 129mm
- Tela: LCD-TFT de alta resolução
- Resolução: 800 x 480 pixels
- Tamanho do visor: 7 polegadas diagonal
- Peso: 2,05 Kg

ESPECIFICAÇÕES DA SPO2

- Faixa de leitura: 0-100% (funcional)
- Precisão: 70-100%: ± 2 ; abaixo de 70%: Indefinida
- Ciclo médio: 8 batimentos
- Resolução: 1%
- Visor: A barra gráfica da força de pulsação não é proporcional ao volume de pulsação.
- Calibração: Calibração de fábrica entre 70% a 100%.
- Comprimento de onda: Luz vermelha: 660nm; Luz infravermelha: 905nm
- Potência máxima de saída: <90mW
- Índice de perfusão (PI%): 0% a 20%

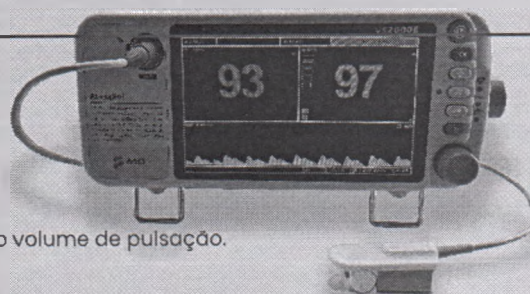

FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA


- Limites: 30 - 250 bpm
- Precisão: $\pm 2\%$ ou 1 bpm
- Ciclo médio: 8 pulsações
- Resolução: 1 bpm

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

- Corrente AC: Entrada de 100-240 VAC, 50/60Hz, 60VA
- Bateria: Bateria de Lítio, 11,1 VDC 2200mAh
- Autonomia: 5 horas com carga completa
- Tempo de Carregamento: 3 horas

Licitante
Participante 4

Nome do documento	Ação
ficha.pdf	
ANVISA POLTRONA LEVITA.pdf	
POLTRONA RECLINAVEL A GAS LEVITA LV91GAS.pdf	



Edital: 1406.01/2024SMS Lote: 11	
Marca	levita gas
Data	01/07/2024 16:04:54.808
Prazo de Validade da Proposta	60 dias


Informações sobre preços e marcas					
Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
POLTRONA HOSPITA	10	Unidade	R\$ 1.600,00 (R\$ 16.000,00)	-	levita gas
TOTAL DO LOTE					

- DECLARAÇÕES:**
- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
 - Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
 - Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
 - Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
 - Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.
 - Declaramos que estamos enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP
CNPJ	11.192.559/0001-87
Autorização	8.09.702-9
Produto	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE



Modelo Produto Médico
LV 29 – CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE
LV 50 – CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE ESTOFADA
LV 50 OB – CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE ESTOFADA OBESO
LV 91 – POLTRONA RECLINÁVEL
LV 93 – POLTRONA RECLINÁVEL PARA COLETA DE SANGUE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	FAMILIA DE CADEIRA DE COLETA - INSTRUÇÕES DE USO.pdf	4302969211 - 30/10/2021 19:34:18

Nome Técnico	Cadeira Para Doador
Registro	80970290002
Processo	25351656266201405
Fabricante Legal	HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]



LV 91 GÁS **POLTRONA RECLINÁVEL A GÁS**

Pés em tubo retangular 50mm x 20mm x 1,20mm, estrutura em tubo 31,75mm x 1,20mm e 25,40mm x 1,20mm. Assento, encosto, pernas e braços estofados em espuma com 05cm de altura D-26 revestido em couvin. Reclinável em várias posições através de alavanca lateral com retorno automático à posição inicial de sentado através de amortecedor a gás, movimento simultâneo de encosto e do descanso das pernas, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso. Pés com ponteiros de PVC antiderrapante.

 **Dimensões Externas**
C 0,46 x L 0,70 x A 1,20 / Pos. Deitada C 1,70 (m)

 **Anvisa**
 **Dispensado**



Nome do documento	Ação
POLTRONA.pdf	

Edital: 1406.01/2024SMS Lote: 11	
Marca	prprio
Data	01/07/2024 17:03:30.868
Prazo de Validade da Proposta	60 dias

Informações sobre preços e marcas					
Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
POLTRONA HOSPITA	10	Unidade	R\$ 1.613,00 (R\$ 16.130,00)	-	prprio
TOTAL DO LOTE			R\$ 16.130,00	-	

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.
- Declaramos que estamos enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.




Imagem meramente
ilustrativa


POLTRONA RECLINÁVEL

Especificações

- Com 04 posições.
- Estrutura em tubo de aço redondo de 1" x 1.20mm e 1"1/4 x 1.20 mm.
- Encosto, assento e descansa pés estofados em espuma D23R com 70mm de espessura, revestidos em courvim.
- Movimentos simultâneos do encosto e descansa pés comandados por meio de alavanca lateral com molas.
- Tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática à pó. Secagem em estufa.
- Ponteira/base: com 4 sapatas fixas
- Dimensão deitada: 1,62 x 0,75 x 0,55 (CxLxA)/Sentada 0,95 x 0,75 x 1,20 (CxLxA).
- Assento: 55 cm x 45 cm (LxP) Encosto 78 x 52 (AxL).
- Capacidade aproximada: até 130 kg.
- Largura do assento (interno): 0,53 cm

Opcionais

- Dimensões personalizáveis
- Opções de cores
- Variações nas densidades (D23, D26, D28, D33)
- Com ou sem rodízios;
- Acionado por pistão

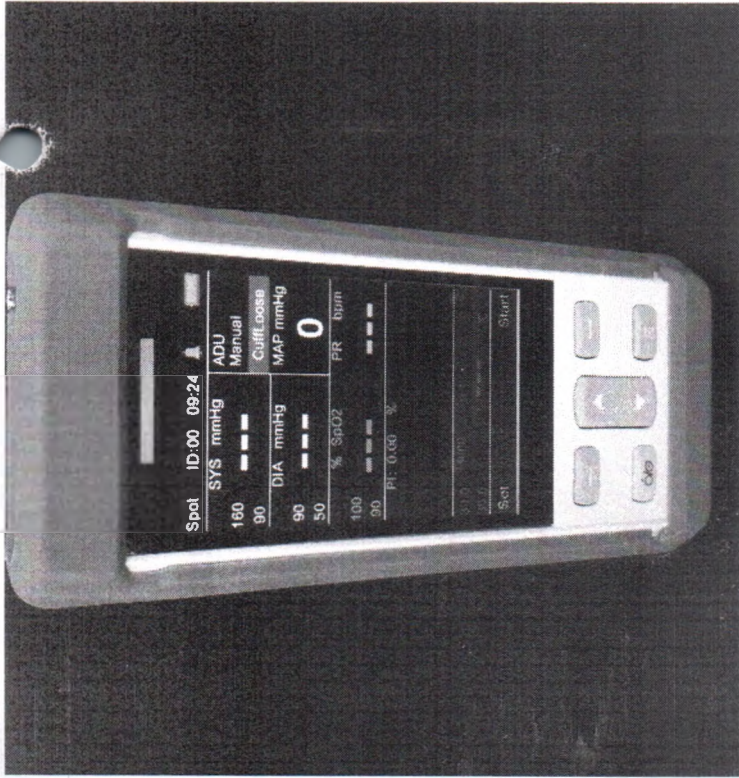

VT200B
ROSEDA
OXÍMETRO DE
PULSO PORTÁTIL E
MESA COM VISOR
DE 3,5"



Recursos

- Memória integrada com capacidade para 200 leituras de dados de oxigenação.
- Atualiza o conteúdo da memória de dados automaticamente a 100%. O produto só irá gravar no momento de necessidade.
- Memória para 1000 leituras de dados de oxigenação em tempo real.
- Memória para 1000 leituras de dados de oxigenação em tempo real.
- Memória para 1000 leituras de dados de oxigenação em tempo real.
- Memória para 1000 leituras de dados de oxigenação em tempo real.
- Memória para 1000 leituras de dados de oxigenação em tempo real.
- Memória para 1000 leituras de dados de oxigenação em tempo real.
- Memória para 1000 leituras de dados de oxigenação em tempo real.
- Memória para 1000 leituras de dados de oxigenação em tempo real.

Handwritten signature

Handwritten signature



VT200B | OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL E MESA COM VISOR DE 3,5"

Especificações

- Visor TFT colorido de 3,5 polegadas (resolução: 220x160).
- Interface: Visor de 3,5 polegadas (resolução: 220x160).
- Memória para 1000 leituras de dados de oxigenação em tempo real.
- Memória para 1000 leituras de dados de oxigenação em tempo real.
- Memória para 1000 leituras de dados de oxigenação em tempo real.
- Memória para 1000 leituras de dados de oxigenação em tempo real.
- Memória para 1000 leituras de dados de oxigenação em tempo real.
- Memória para 1000 leituras de dados de oxigenação em tempo real.
- Memória para 1000 leituras de dados de oxigenação em tempo real.
- Memória para 1000 leituras de dados de oxigenação em tempo real.

Opcionais

- Pacote Não Invasivo (NII)
- Pacote Não Invasivo (NII)
- Pacote Não Invasivo (NII)
- Pacote Não Invasivo (NII)
- Pacote Não Invasivo (NII)
- Pacote Não Invasivo (NII)
- Pacote Não Invasivo (NII)
- Pacote Não Invasivo (NII)
- Pacote Não Invasivo (NII)
- Pacote Não Invasivo (NII)

